CHEMTECH
284 Sheffield Street,
Mountainside, NJ 07092
Reviewed by : AS Instrument ID : Konelab

4/29/2019 12:09

Test: Phenolics- mg/L

Sample Id	Result	Dil. 1 +	Response	Errors
ICV1	1.046	0.0	0.126	
ICB1	0.004	0.0	0.015	
CCV1	0.989	0.0	0.120	
CCB1	0.003	0.0	0.014	
PB119265BL	0.000	0.0	0.014	
PB119265BS	1.038	0.0	0.125	
K2550-01	0.011	0.0	0.015	
K2550-01DUP	0.012	0.0	0.015	
K2550-01MS	0.979	0.0	0.119	
K2550-01MSD	0.980	0.0	0.119	
K2572-01	0.006	0.0	0.015	
CCV2	0.978	0.0	0.119	
CCB2	0.003	0.0	0.014	

N	13
Mean	0.465
SD	0.5172
CV%	111.15

AS

Aquakem v. 7.2AQ1
Results from time period:
Mon Apr 29 11:24:20 2019
Mon Apr 29 11:56:14 2019

Sample Id	Sam/Ctr/c	Test short nam	Test type	Result	Result unit	Result date and time	Stat
0.05PPM	A	Phenolics-	P	0.0431	mg/l	4/29/2019 11:24:20	
0.1PPM	A	Phenolics-	P	0.1021	mg/l	4/29/2019 11:24:21	
0.25PPM	A	Phenolics-	P	0.2519	mg/l	4/29/2019 11:24:22	
0.50PPM	A	Phenolics-	P	0.5062	mg/l	4/29/2019 11:24:23	
1.0PPM	A	Phenolics-	P	0.9968	mg/l	4/29/2019 11:24:24	
2.0PPM	A	Phenolics-	P	1.9999	mg/l	4/29/2019 11:24:25	
ICV1	S	Phenolics-	P	1.0465	mg/l	4/29/2019 11:51:46	
ICB1	S	Phenolics-	P	0.0037	mg/l	4/29/2019 11:51:47	
CCV1	S	Phenolics-	P	0.9893	mg/l	4/29/2019 11:51:48	
CCB1	S	Phenolics-	P	0.0032	mg/l	4/29/2019 11:51:49	
PB119265BL	S	Phenolics-	P	0.0003	mg/l	4/29/2019 11:51:50	
PB119265BS	S	Phenolics-	P	1.0379	mg/l	4/29/2019 11:51:51	
K2550-01	S	Phenolics-	P	0.0113	mg/l	4/29/2019 11:51:52	
K2550-01DUP	S	Phenolics-	P	0.0119	mg/l	4/29/2019 11:51:53	
K2550-01MS	S	Phenolics-	P	0.9786	mg/l	4/29/2019 11:51:54	
K2550-01MSD	S	Phenolics-	P	0.9802	mg/l	4/29/2019 11:51:55	
K2572-01	S	Phenolics-	P	0.0061	mg/l	4/29/2019 11:51:56	
CCV2	S	Phenolics-	P	0.9776	mg/l	4/29/2019 11:56:13	
CCB2	S	Phenolics-	P	0.0027	mg/l	4/29/2019 11:56:14	

Calibration results — Aquakem 7.2AQ1 — Page: 1

CHEMTECH
284 Sheffield Street,
Mountainside, NJ 07092
Reviewed by : AB

4/29/2019 11:28 — Instrument ID : Konelab

Test Phenolics-

Accepted	4/29/2019	11:28
Factor	9.347	
Bias	0.014	
Coeff. of det.	0.999963	

Errors

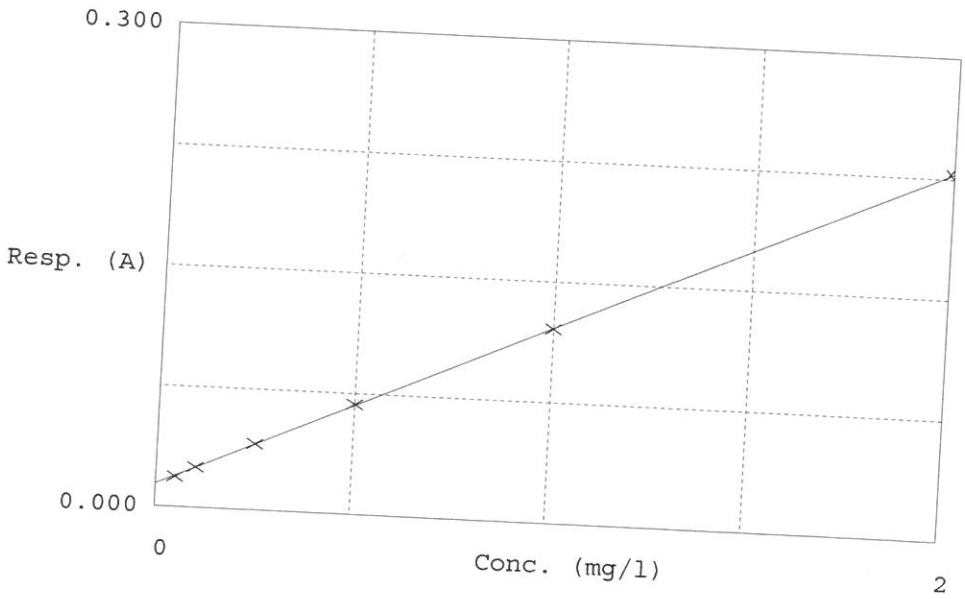

	Calibrator	Response	Calc. con.	Conc.	Errors
1	Phenol-2	0.019	0.0431	0.0500	
2	Phenol-2	0.025	0.1021	0.1000	
3	Phenol-2	0.041	0.2519	0.2500	
4	Phenol-2	0.068	0.5062	0.5000	
5	Phenol-2	0.121	0.9968	1.0000	
6	Phenol-2	0.228	1.9999	2.0000	