DFTPP

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE021916\
Data File : BE091412.D
Acq On : 19 Feb 2016 12:40
Operator : UM/IZ
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE020216.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Wed Feb 03 00:27:53 2016

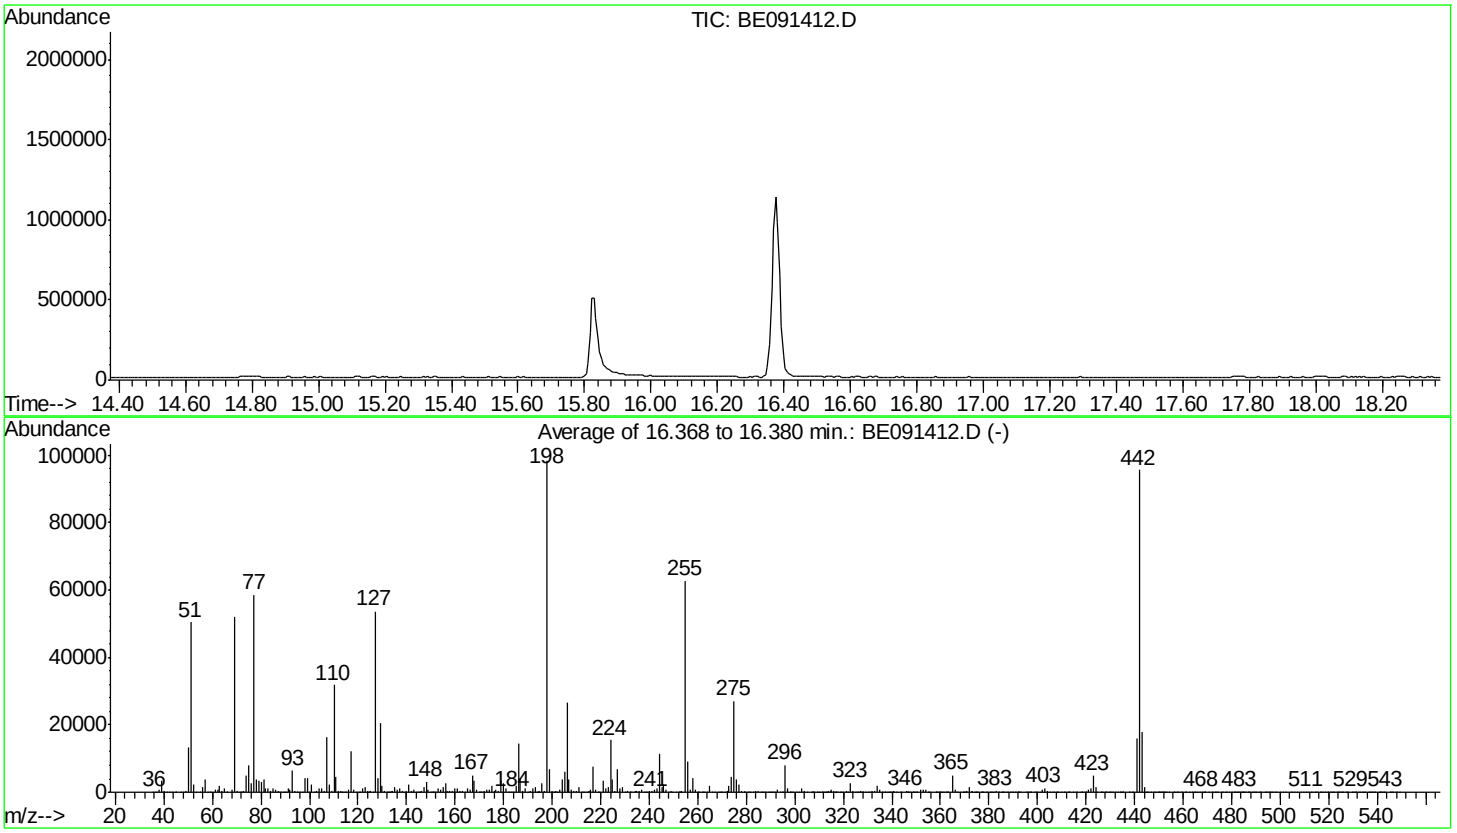

AutoFind: Scans 2345, 2346, 2347; Background Corrected with Scan 2336

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	51.3	50494	PASS
68	69	0.00	2	1.4	704	PASS
69	198	0.00	100	53.0	52129	PASS
70	69	0.00	2	0.5	253	PASS
127	198	10	80	54.5	53620	PASS
197	198	0.00	2	0.4	383	PASS
198	198	100	100	100.0	98432	PASS
199	198	5	9	7.1	6989	PASS
275	198	10	60	27.5	27072	PASS
365	198	1	100	5.1	5025	PASS
441	442	0.01	24	16.5	15810	PASS
442	198	50	100	97.1	95615	PASS
443	442	15	24	18.7	17854	PASS