Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE043019\
Data File : BE099434.D
Acq On : 30 Apr 2019 20:23
Operator : JU/SJ
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE042919.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Mon Apr 29 18:36:43 2019

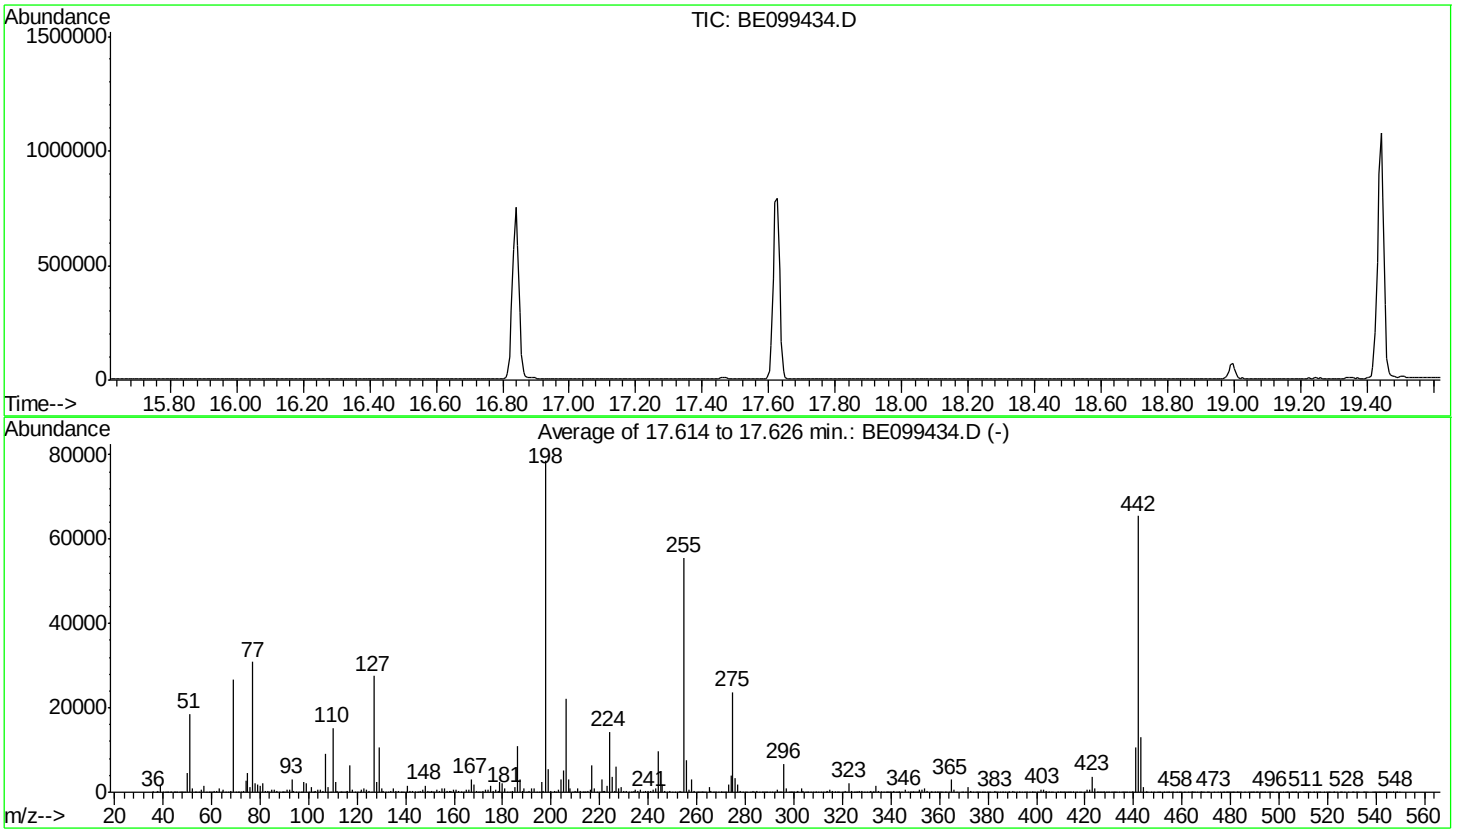

AutoFind: Scans 2557, 2558, 2559; Background Corrected with Scan 2548

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	23.6	18540	PASS
68	69	0.00	2	1.6	434	PASS
69	198	0.00	100	34.0	26698	PASS
70	69	0.00	2	0.4	119	PASS
127	198	10	80	35.0	27541	PASS
197	198	0.00	2	0.0	0	PASS
198	198	100	100	100.0	78635	PASS
199	198	5	9	6.9	5449	PASS
275	198	10	60	30.1	23684	PASS
365	198	1	100	3.8	2994	PASS
441	198	0.01	100	13.4	10519	PASS
442	198	50	100	83.3	65540	PASS
443	442	15	24	20.1	13141	PASS