DFTPP

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF061318\
Data File : BF106413.D
Acq On : 14 Jun 2018 1:41
Operator : JU/SJ
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF061118.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Thu Jun 14 11:27:54 2018

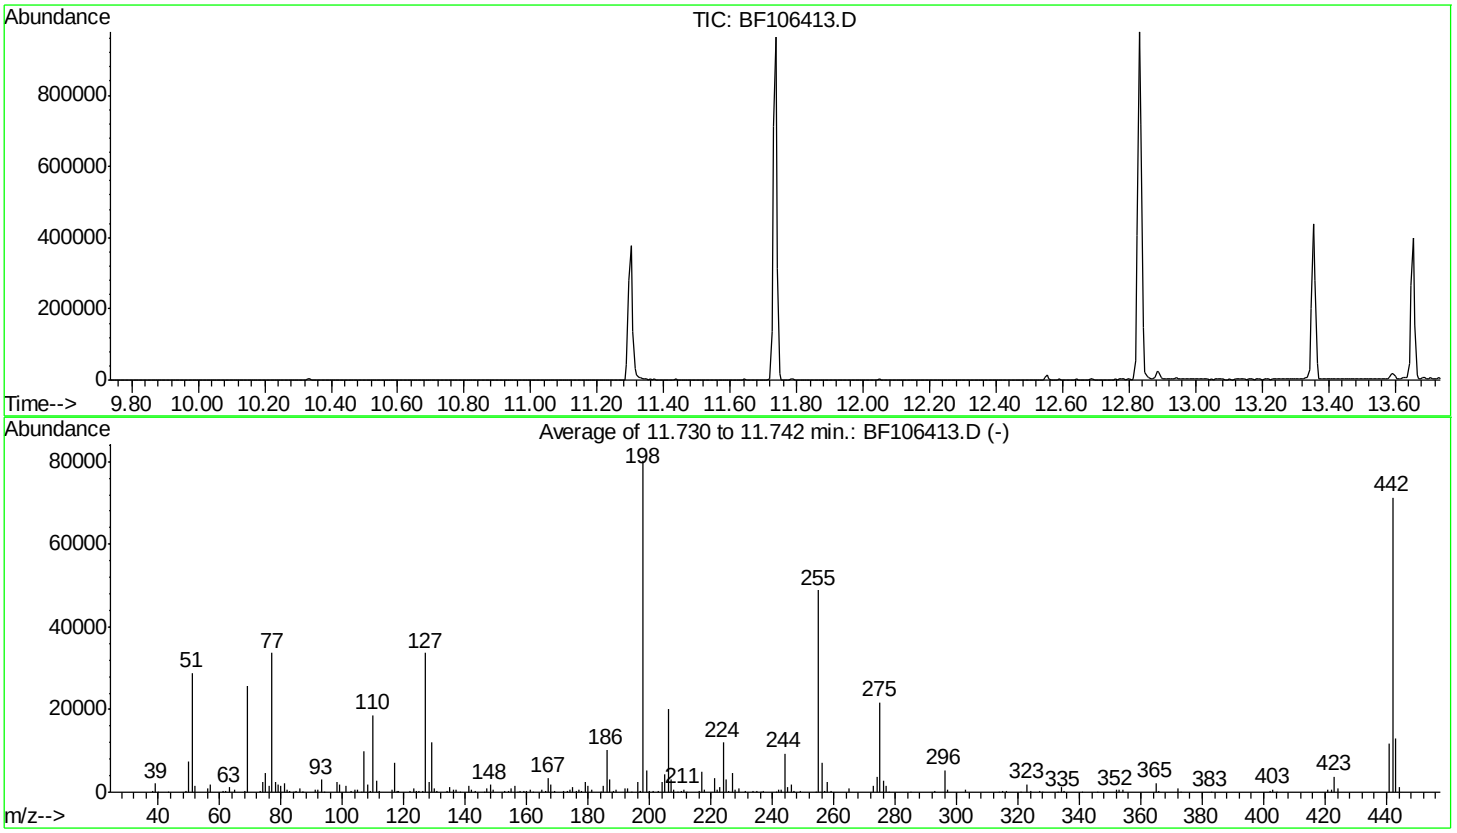

AutoFind: Scans 1597, 1598, 1599; Background Corrected with Scan 1592

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	35.9	28804	PASS
68	69	0.00	2	1.4	368	PASS
69	198	0.00	100	32.1	25720	PASS
70	69	0.00	2	0.0	0	PASS
127	198	10	80	41.9	33621	PASS
197	198	0.00	2	0.4	292	PASS
198	198	100	100	100.0	80226	PASS
199	198	5	9	6.5	5222	PASS
275	198	10	60	27.1	21761	PASS
365	198	1	100	2.9	2330	PASS
441	443	0.01	100	89.7	11711	PASS
442	198	50	100	88.9	71346	PASS
443	442	15	24	18.3	13054	PASS