DFTPP

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF011316\
Data File : BF084465.D
Acq On : 14 Jan 2016 2:15
Operator : SJ/UM
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF123115.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Thu Jan 14 14:15:52 2016

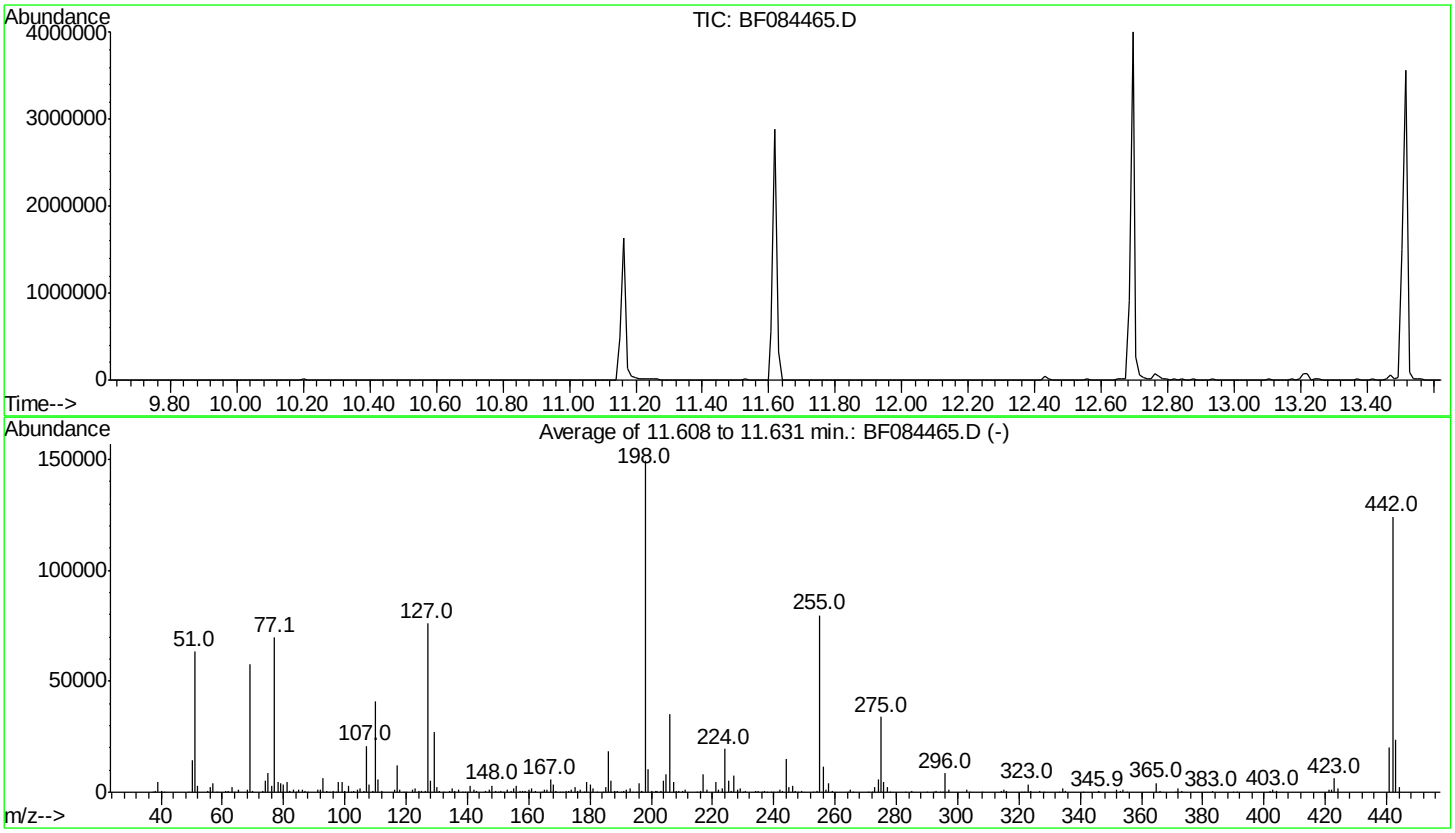

AutoFind: Scans 833, 834, 835; Background Corrected with Scan 830

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	42.4	63428	PASS
68	69	0.00	2	1.6	941	PASS
69	198	0.00	100	38.6	57767	PASS
70	69	0.00	2	0.6	331	PASS
127	198	10	80	50.8	75920	PASS
197	198	0.00	2	0.5	689	PASS
198	198	100	100	100.0	149522	PASS
199	198	5	9	7.1	10600	PASS
275	198	10	60	22.7	34012	PASS
365	198	1	100	2.9	4349	PASS
441	442	0.01	24	16.1	20043	PASS
442	198	50	100	83.1	124186	PASS
443	442	15	24	18.8	23409	PASS