DFTPP

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF011323\
Data File : BF132055.D
Acq On : 13 Jan 2023 11:29
Operator : CG\JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF010923.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Thu Jan 12 23:59:08 2023

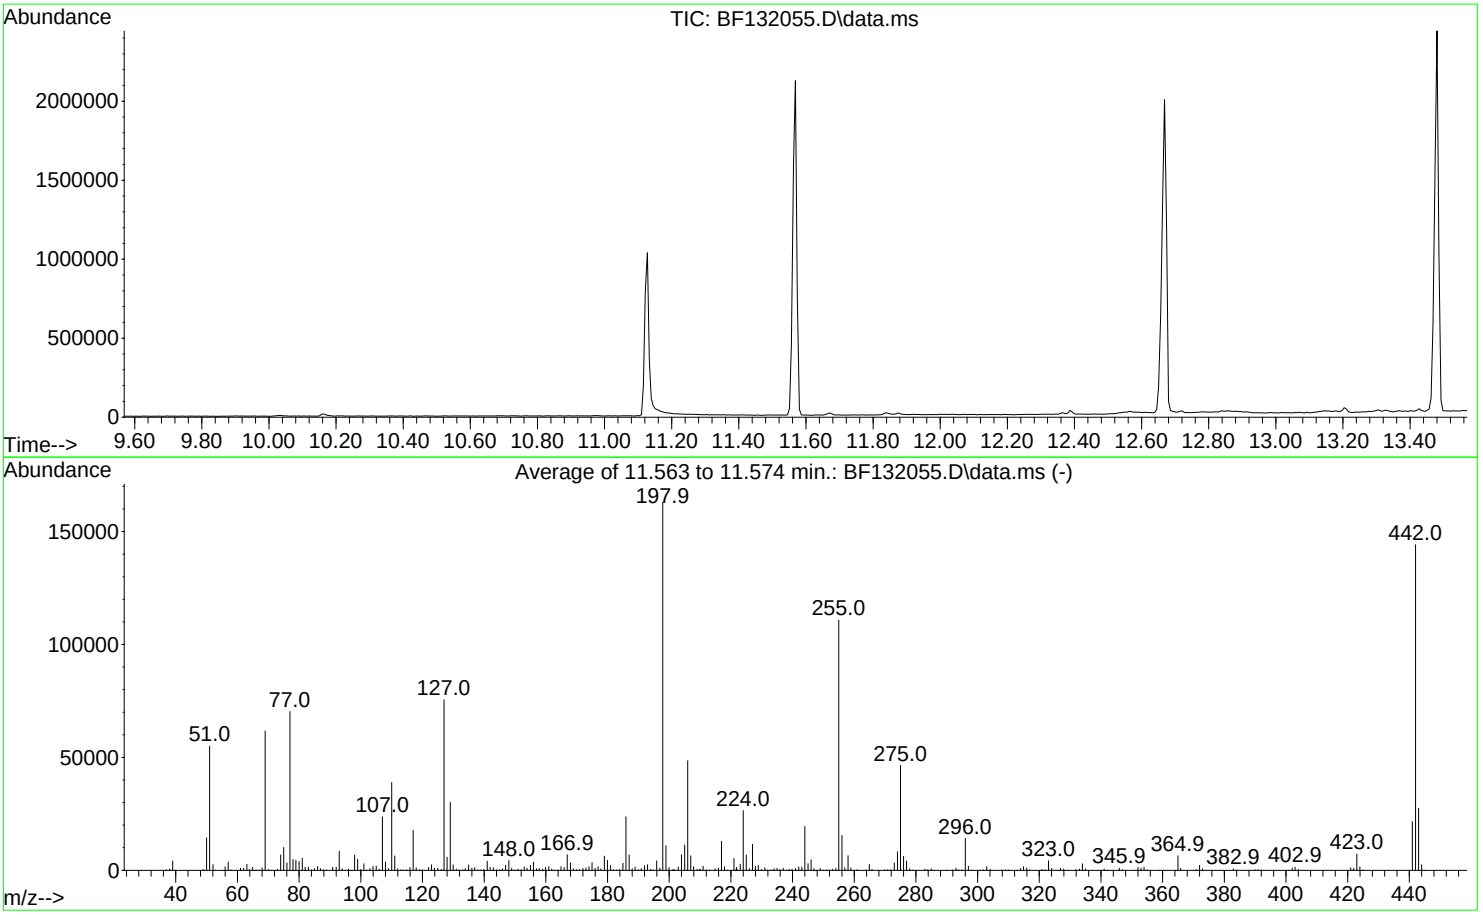

AutoFind: Scans 1611, 1612, 1613; Background Corrected with Scan 1606

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	33.7	54948	PASS
68	69	0.00	2	1.8	1109	PASS
69	198	0.00	100	37.9	61712	PASS
70	69	0.00	2	0.6	341	PASS
127	198	10	80	46.3	75475	PASS
197	198	0.00	2	0.6	970	PASS
198	198	100	100	100.0	162901	PASS
199	198	5	9	6.7	10898	PASS
275	198	10	60	28.5	46416	PASS
365	198	1	100	3.9	6421	PASS
441	198	0.01	100	13.2	21511	PASS
442	442	50	100	100.0	144131	PASS
443	442	15	24	19.0	27373	PASS

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF011323\
Data File : BF132055.D
Acq On : 13 Jan 2023 11:29
Operator : CG\JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
DFTPP

Quant Time: Jan 16 03:19:56 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF010923.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 12 23:59:08 2023
Response via : Initial Calibration

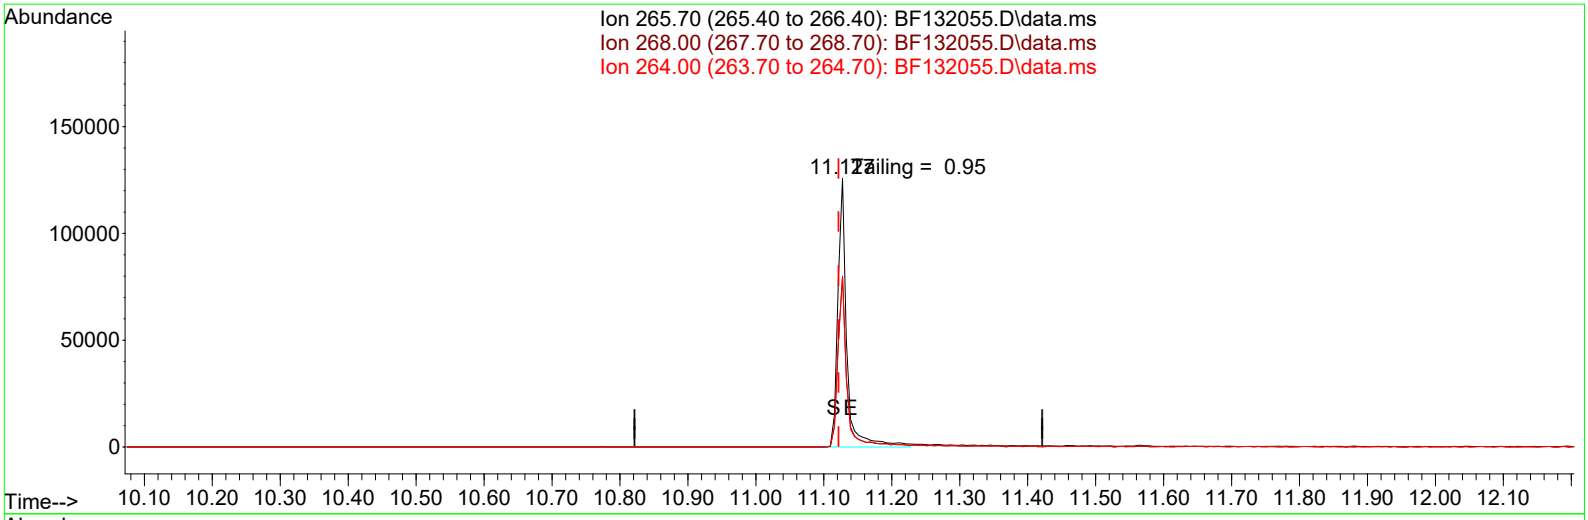

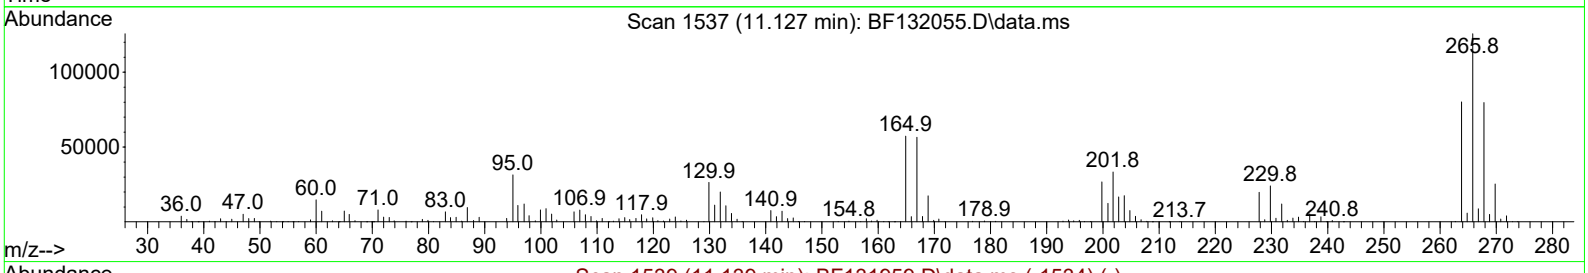

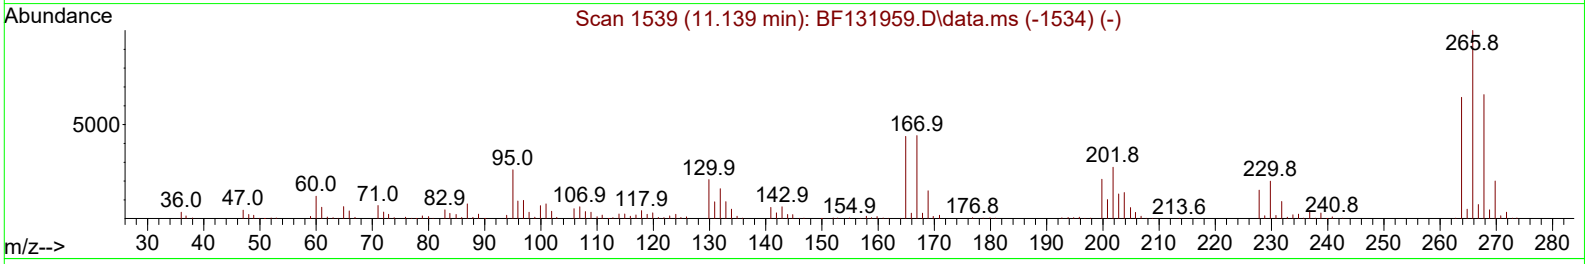

TIC: BF132055.D\data.ms

(70) Pentachlorophenol (C)

11.127min (+ 0.006) 21076.81 ng

response 114002

Ion	Exp%	Act%
265.70	100.00	100.00
268.00	65.90	63.47
264.00	64.50	63.76
0.00	0.00	0.00

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF011323\
Data File : BF132055.D
Acq On : 13 Jan 2023 11:29
Operator : CG\JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
DFTPP

Quant Time: Jan 16 03:19:56 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF010923.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jan 12 23:59:08 2023
Response via : Initial Calibration

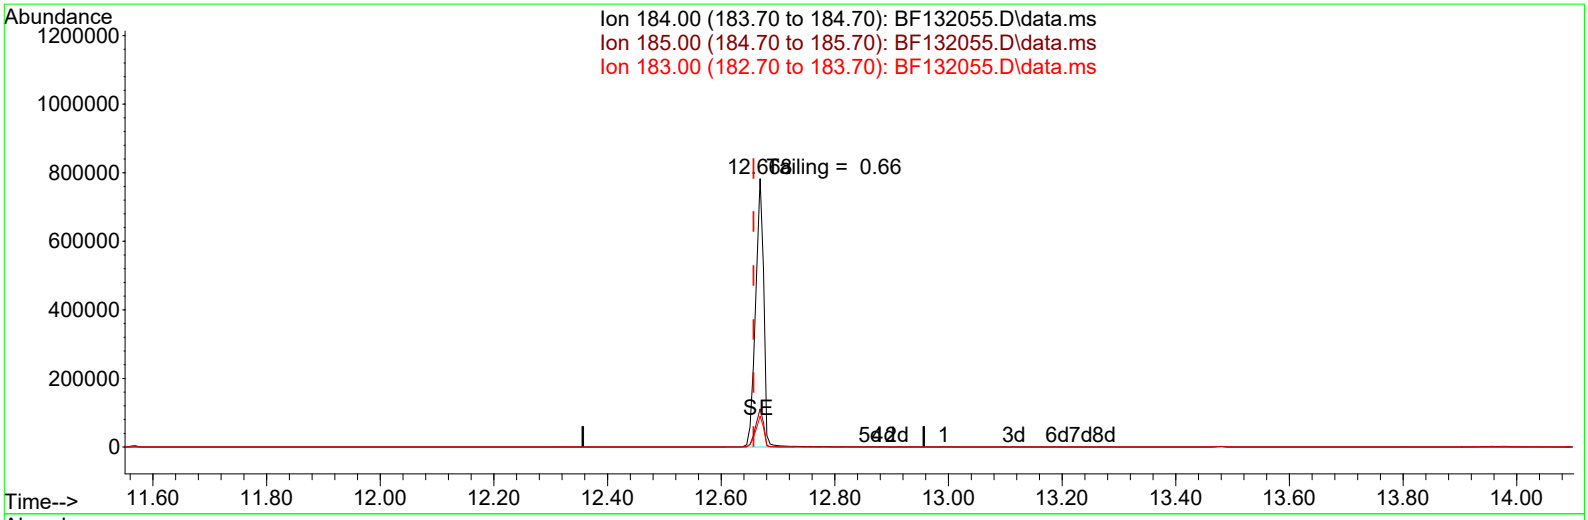

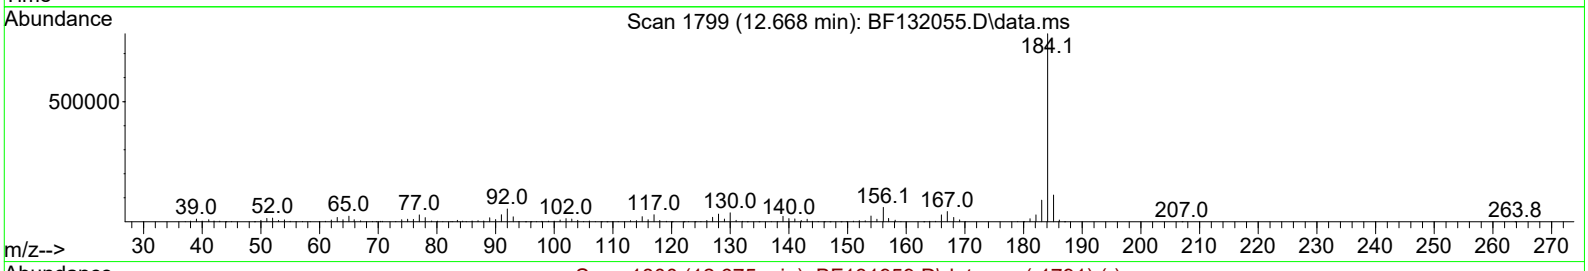

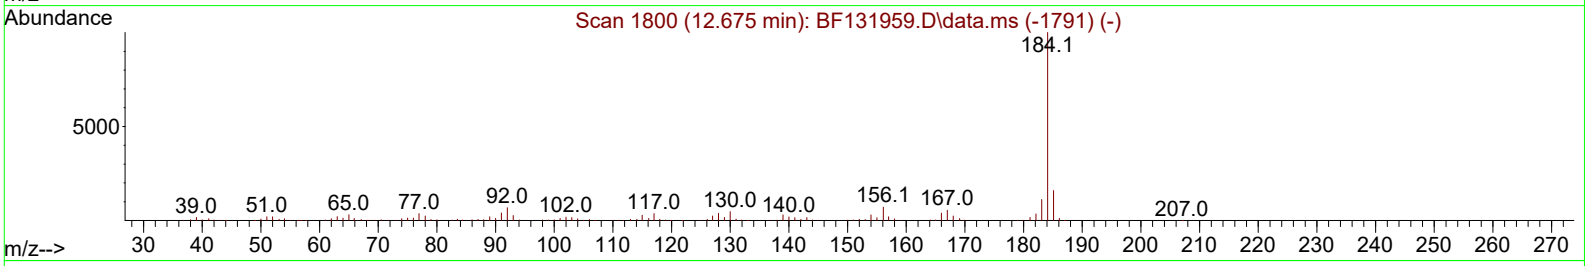

TIC: BF132055.D\data.ms

(77) Benzidine

12.668min (+ 0.012) 446396.20 ng m

response 786003

Ion	Exp%	Act%
184.00	100.00	100.00
185.00	16.00	14.22
183.00	11.20	11.53
0.00	0.00	0.00

DDT Breakdown

Date	Instrument Name	DFTPP Data File
1/13/2023	BNA_F	BF132055.D
Compound Name	**Response**	**Retention Time**
DDT	387799	13.48
DDD	6040	13.204
DDE	815	12.39
SUM(DDD+DDE)	**SUM(DDT+DDD+DDE)**	**% Breakdown Of DDT**
6855	394654	1.74

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
DFTPP