DFTPP

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF020618\
Data File : BF102771.D
Acq On : 6 Feb 2018 9:22
Operator : SJ/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF020318.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Mon Feb 05 12:44:16 2018

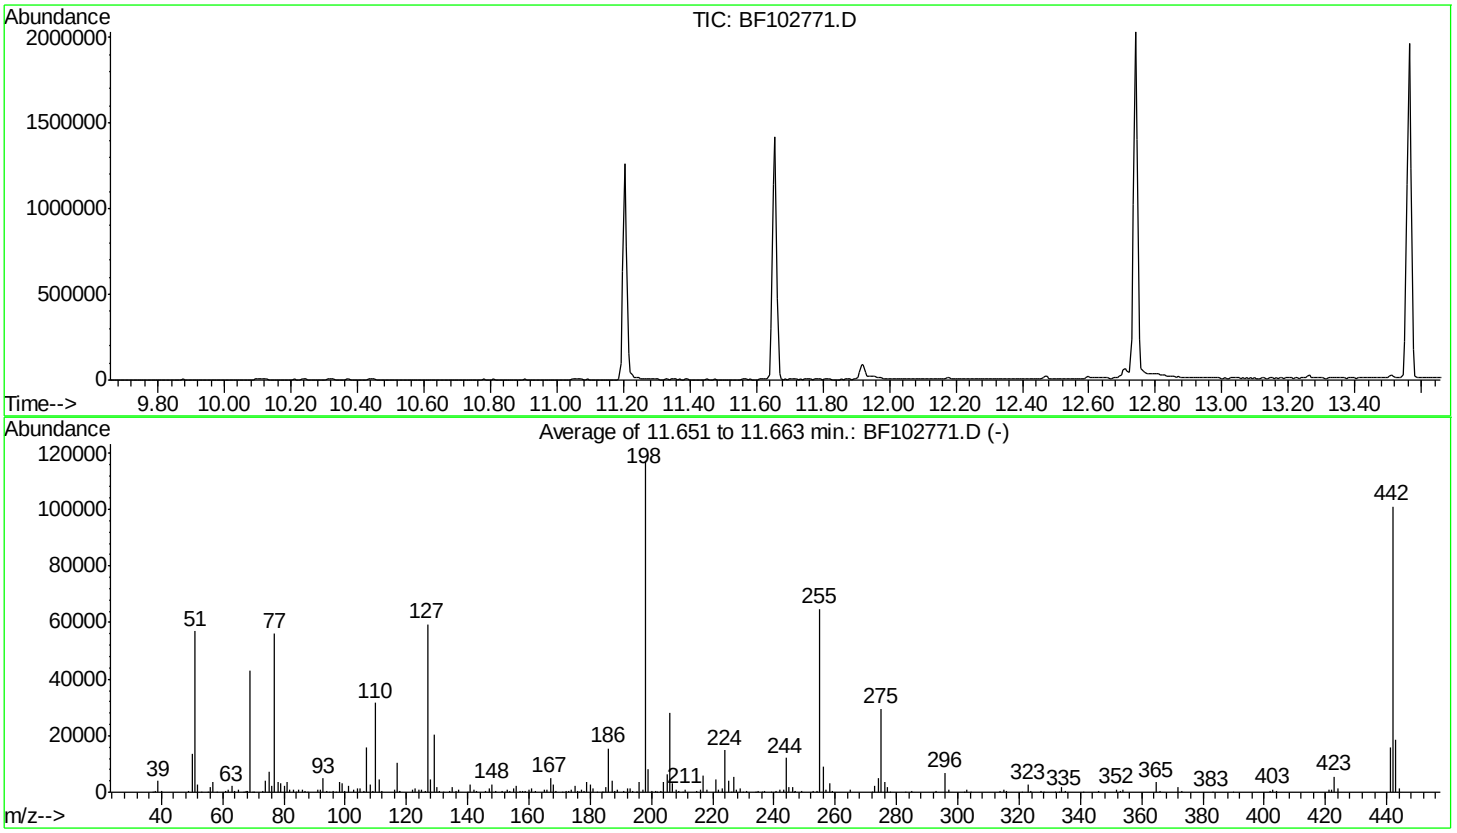

AutoFind: Scans 1626, 1627, 1628; Background Corrected with Scan 1620

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	48.6	56945	PASS
68	69	0.00	2	1.0	445	PASS
69	198	0.00	100	36.8	43102	PASS
70	69	0.00	2	0.3	132	PASS
127	198	10	80	50.7	59445	PASS
197	198	0.00	2	1.0	1130	PASS
198	198	100	100	100.0	117274	PASS
199	198	5	9	7.0	8179	PASS
275	198	10	60	25.2	29528	PASS
365	198	1	100	3.0	3530	PASS
441	443	0.01	100	84.8	15911	PASS
442	198	50	100	86.1	100997	PASS
443	442	15	24	18.6	18753	PASS