DFTPP

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_F\DATA\BF032116\
Data File : BF085641.D
Acq On : 22 Mar 2016 2:03
Operator : UM/SJ
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF031816.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Fri Mar 18 23:31:39 2016

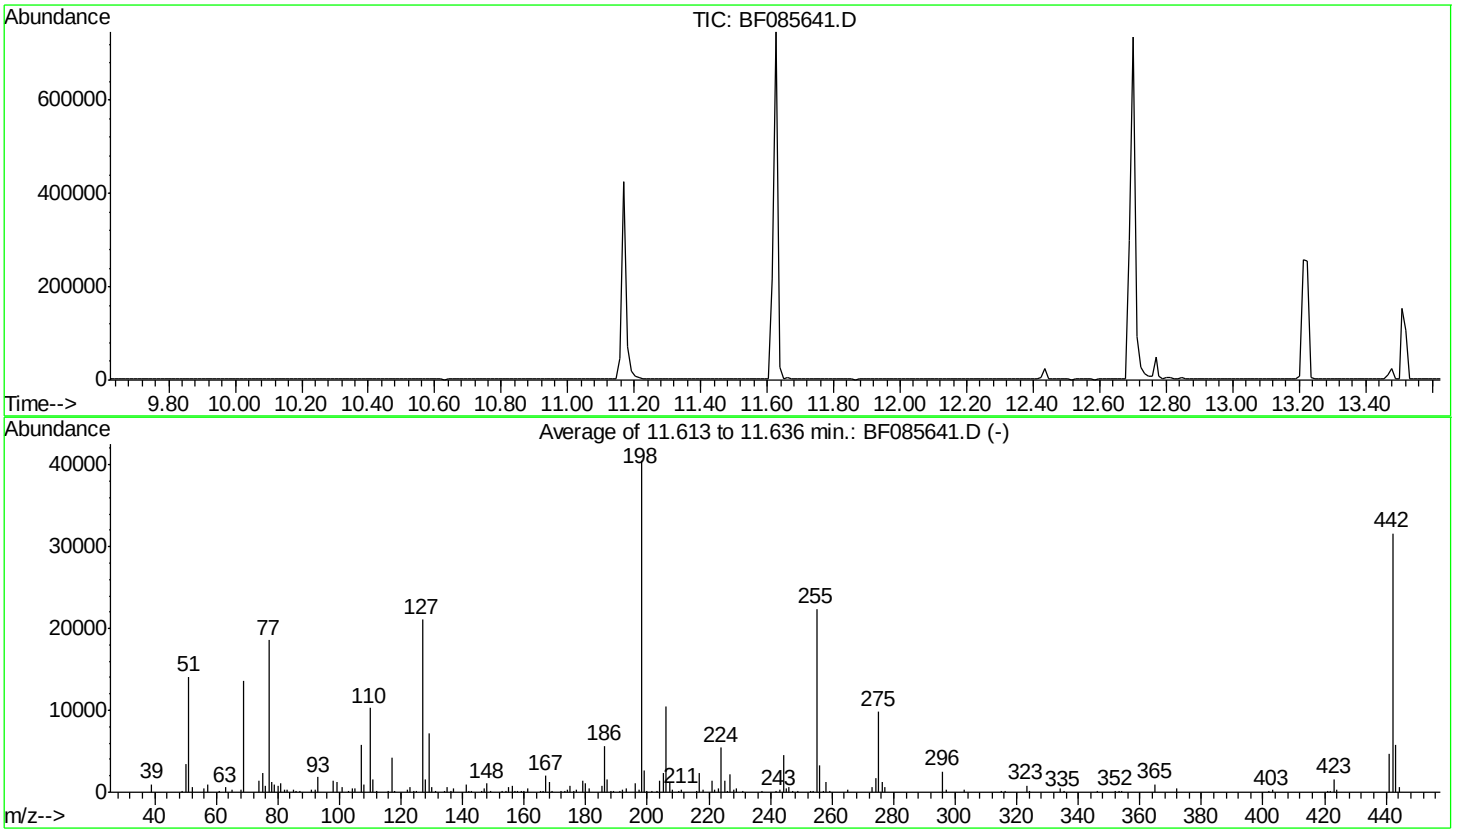

AutoFind: Scans 816, 817, 818; Background Corrected with Scan 813

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	34.9	14126	PASS
68	69	0.00	2	1.8	241	PASS
69	198	0.00	100	33.6	13624	PASS
70	69	0.00	2	0.0	0	PASS
127	198	10	80	52.1	21087	PASS
197	198	0.00	2	0.6	256	PASS
198	198	100	100	100.0	40500	PASS
199	198	5	9	6.7	2715	PASS
275	198	10	60	24.2	9783	PASS
365	198	1	100	2.4	988	PASS
441	442	0.01	24	15.0	4755	PASS
442	198	50	100	78.2	31654	PASS
443	442	15	24	18.5	5845	PASS