DFTPP

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF053116\
Data File : BF087601.D
Acq On : 1 Jun 2016 2:36
Operator : UM/SJ
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF052316.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Wed May 25 16:26:52 2016

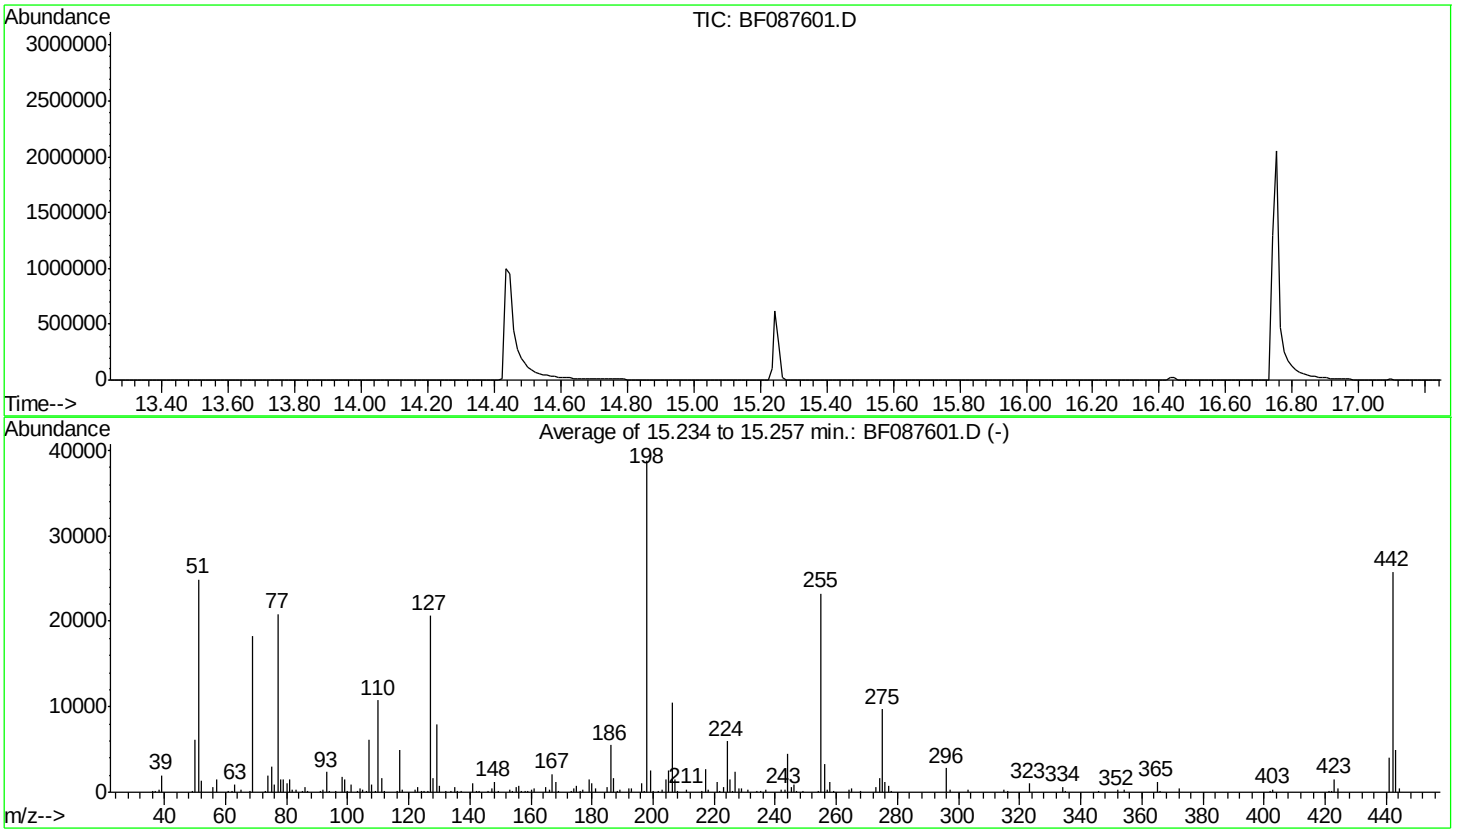

AutoFind: Scans 1194, 1195, 1196; Background Corrected with Scan 1191

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	64.2	24912	PASS
68	69	0.00	2	1.2	224	PASS
69	198	0.00	100	47.0	18224	PASS
70	69	0.00	2	0.0	0	PASS
127	198	10	80	53.2	20633	PASS
197	198	0.00	2	0.3	133	PASS
198	198	100	100	100.0	38778	PASS
199	198	5	9	6.6	2542	PASS
275	198	10	60	25.1	9720	PASS
365	198	1	100	3.2	1259	PASS
441	442	0.01	24	15.8	4063	PASS
442	198	50	100	66.4	25748	PASS
443	442	15	24	19.0	4896	PASS