DFTPP

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF061317\
Data File : BF095917.D
Acq On : 14 Jun 2017 5:09
Operator : SJ/MA
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF060517.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Mon Jun 05 16:15:31 2017

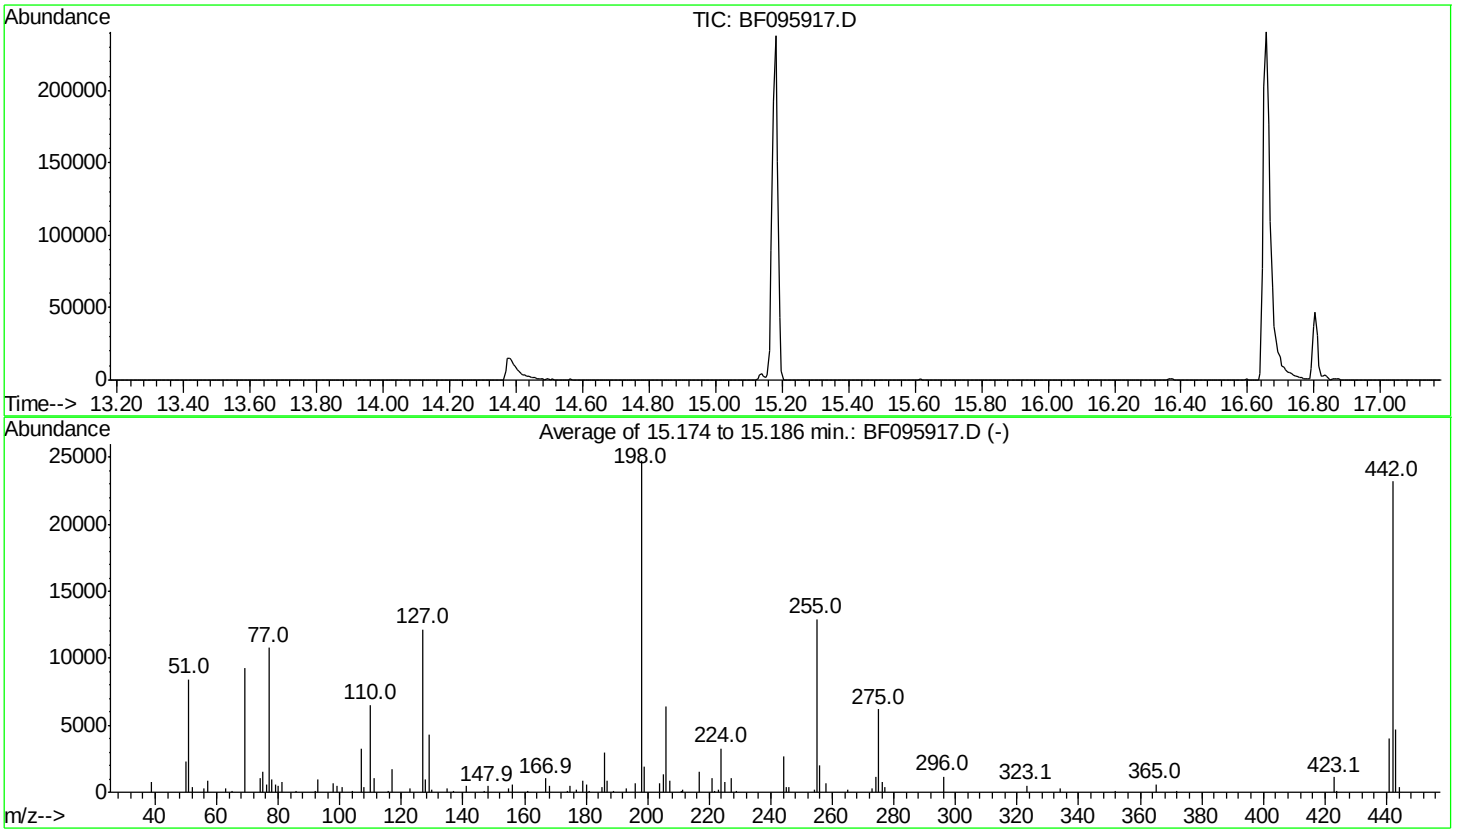

AutoFind: Scans 2310, 2311, 2312; Background Corrected with Scan 2304

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	34.0	8421	PASS
68	69	0.00	2	0.0	0	PASS
69	198	0.00	100	37.3	9240	PASS
70	69	0.00	2	0.0	0	PASS
127	198	10	80	49.1	12168	PASS
197	198	0.00	2	0.0	0	PASS
198	198	100	100	100.0	24757	PASS
199	198	5	9	7.7	1901	PASS
275	198	10	60	25.0	6196	PASS
365	198	1	100	2.5	612	PASS
441	442	0.01	24	17.5	4063	PASS
442	198	50	100	93.7	23202	PASS
443	442	15	24	20.1	4663	PASS