DFTPP

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF061915\
Data File : BF080051.D
Acq On : 19 Jun 2015 9:12
Operator : TP/IZ
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF061715.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Wed Jun 17 16:41:53 2015

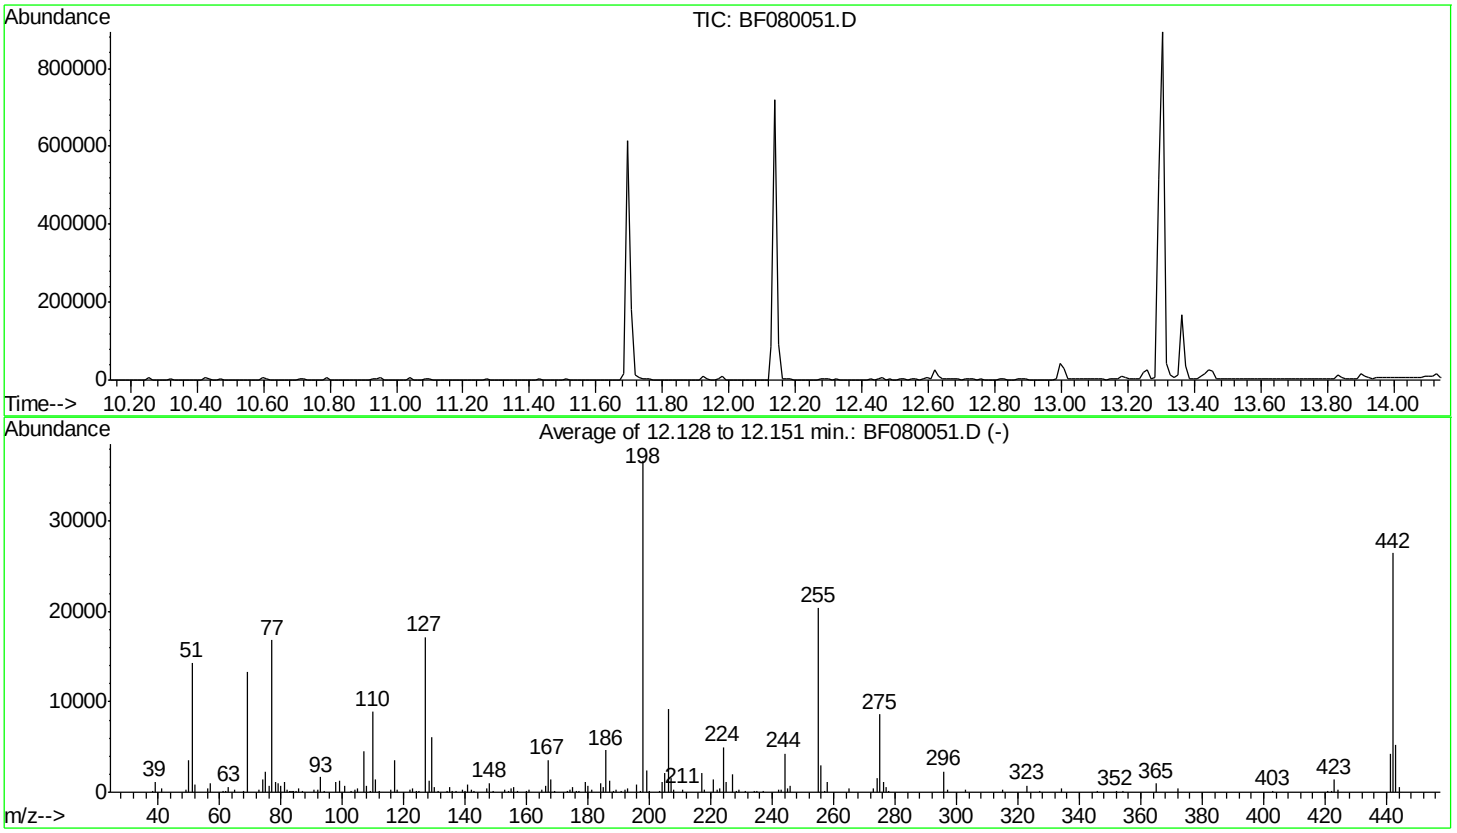

AutoFind: Scans 791, 792, 793; Background Corrected with Scan 788

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	39.1	14334	PASS
68	69	0.00	2	1.4	193	PASS
69	198	0.00	100	36.4	13364	PASS
70	69	0.00	2	0.0	0	PASS
127	198	10	80	46.8	17160	PASS
197	198	0.00	2	0.4	150	PASS
198	198	100	100	100.0	36672	PASS
199	198	5	9	6.7	2468	PASS
275	198	10	60	23.4	8575	PASS
365	198	1	100	2.6	966	PASS
441	442	0.01	24	16.0	4236	PASS
442	198	50	100	72.0	26410	PASS
443	442	15	24	19.8	5233	PASS