DFTPP

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF081622\
Data File : BF129800.D
Acq On : 16 Aug 2022 08:50
Operator : CG\JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF081422.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Mon Aug 15 02:28:31 2022

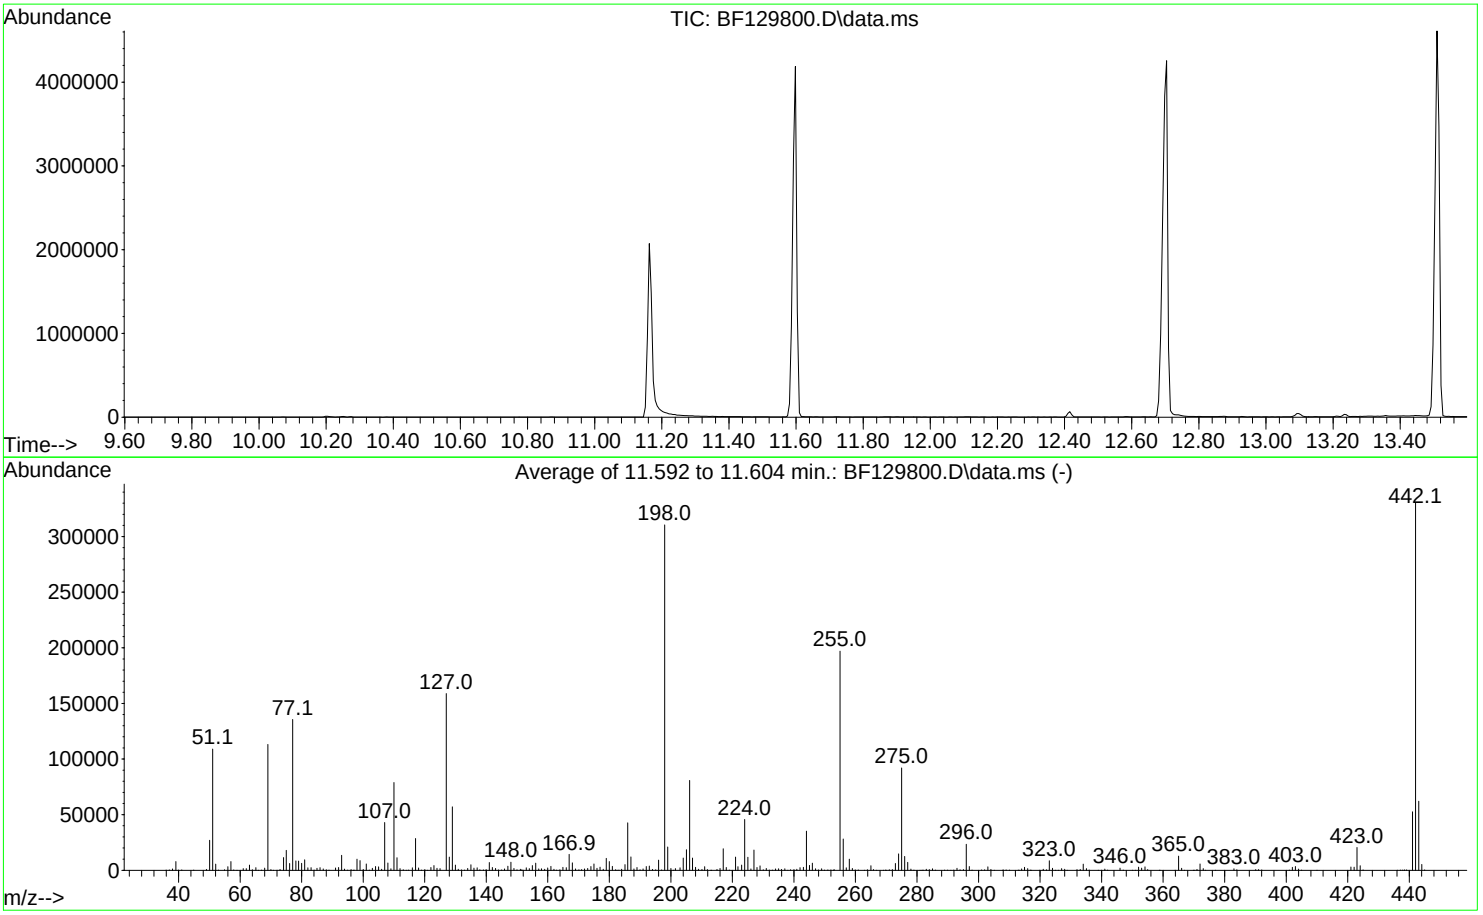

AutoFind: Scans 1582, 1583, 1584; Background Corrected with Scan 1576

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	35.1	108984	PASS
68	69	0.00	2	1.7	1916	PASS
69	198	0.00	100	36.5	113195	PASS
70	69	0.00	2	0.6	662	PASS
127	198	10	80	51.2	158888	PASS
197	198	0.00	2	0.1	359	PASS
198	198	100	100	100.0	310469	PASS
199	198	5	9	6.7	20933	PASS
275	198	10	60	29.6	91992	PASS
365	198	1	100	4.1	12688	PASS
441	198	0.01	100	16.9	52619	PASS
442	442	50	100	100.0	330667	PASS
443	442	15	24	18.8	62091	PASS

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF081622\
Data File : BF129800.D
Acq On : 16 Aug 2022 08:50
Operator : CG\JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
DFTPP

Quant Time: Aug 17 07:30:51 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF081422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Aug 15 02:28:31 2022
Response via : Initial Calibration

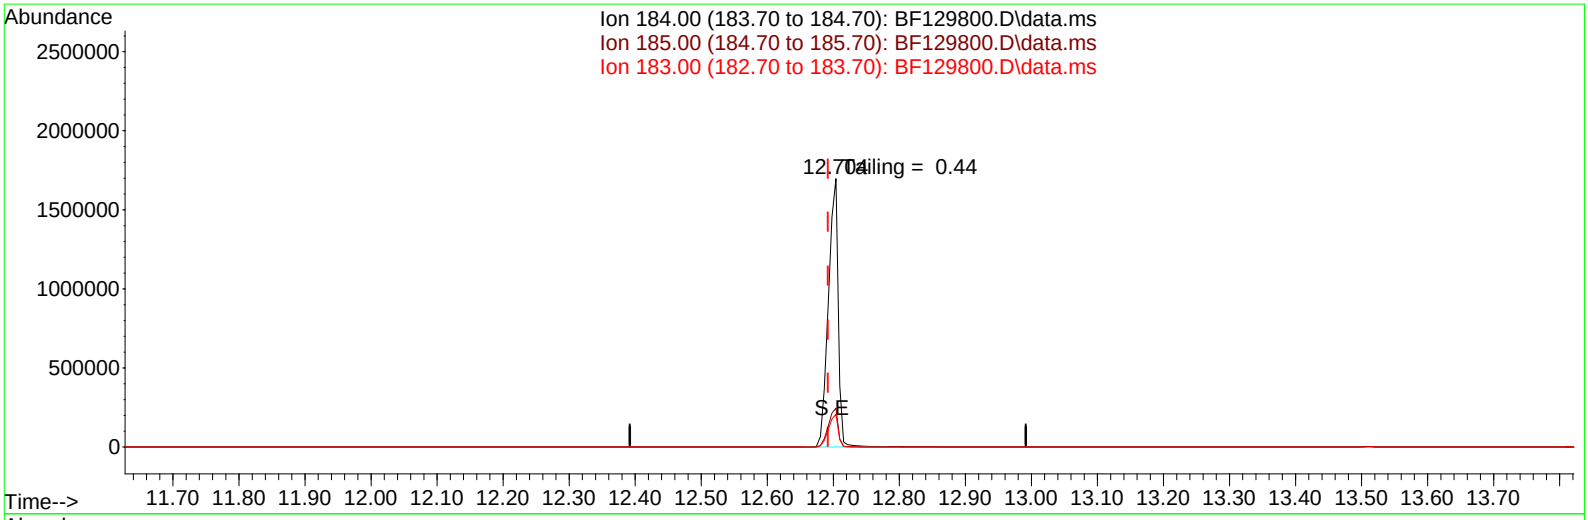

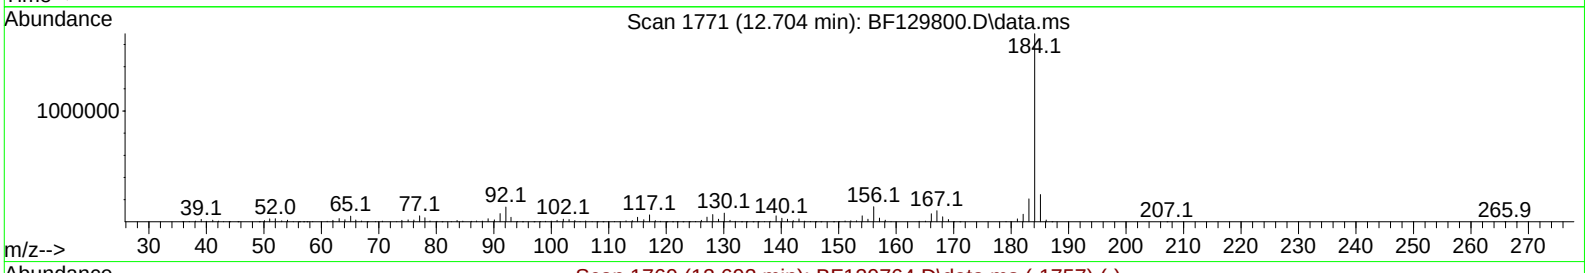

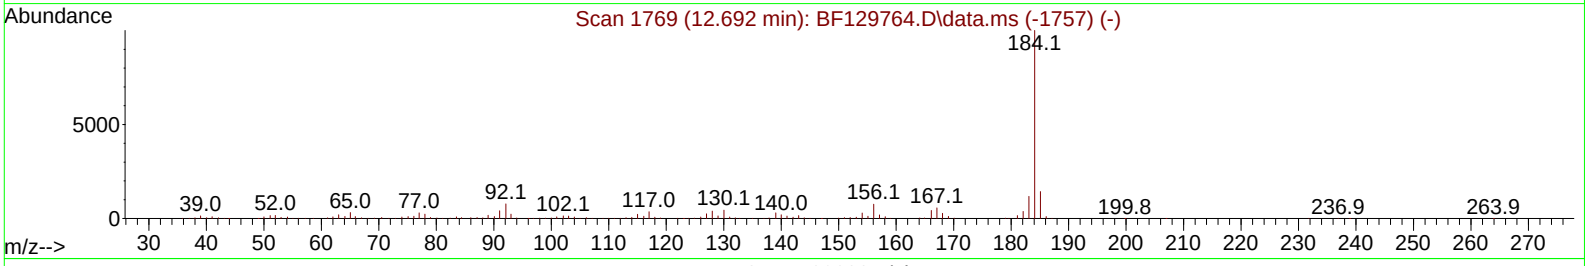

TIC: BF129800.D\data.ms

(77) Benzidine

12.704min (+ 0.012) 77377.39 ng

response 1755724

Ion	Exp%	Act%
184.00	100.00	100.00
185.00	14.30	14.48
183.00	11.80	12.18
0.00	0.00	0.00

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF081622\
Data File : BF129800.D
Acq On : 16 Aug 2022 08:50
Operator : CG\JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
DFTPP

Quant Time: Aug 17 07:30:51 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF081422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Aug 15 02:28:31 2022
Response via : Initial Calibration

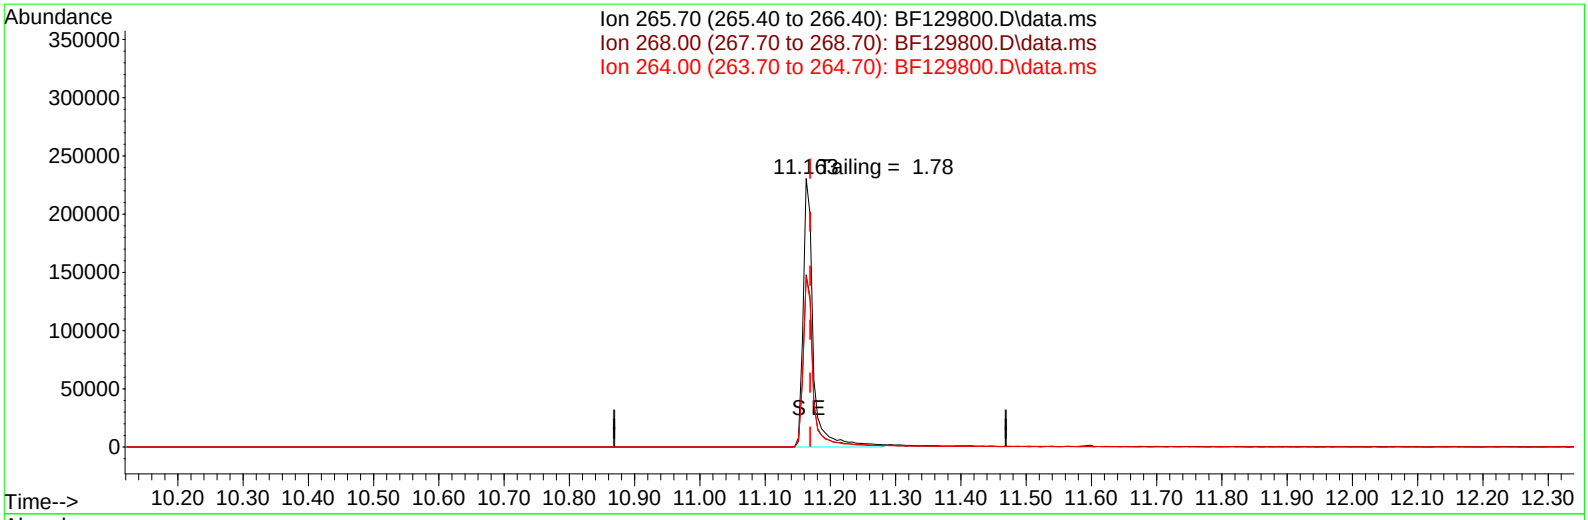

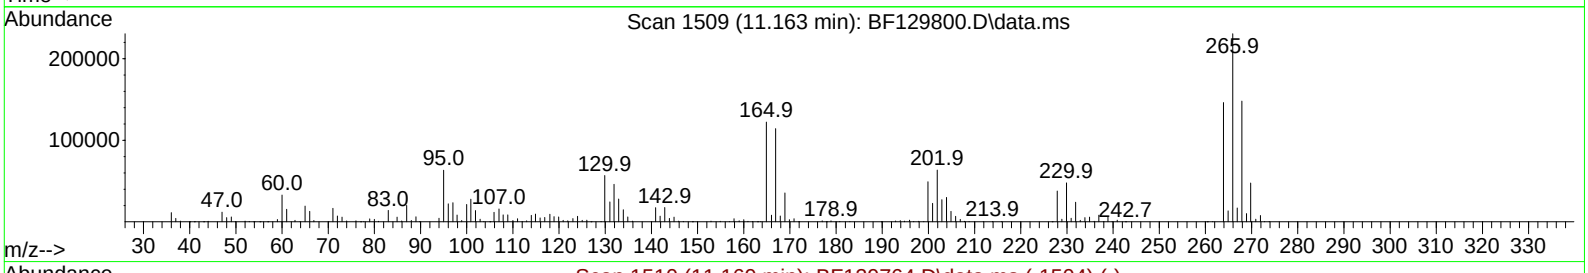

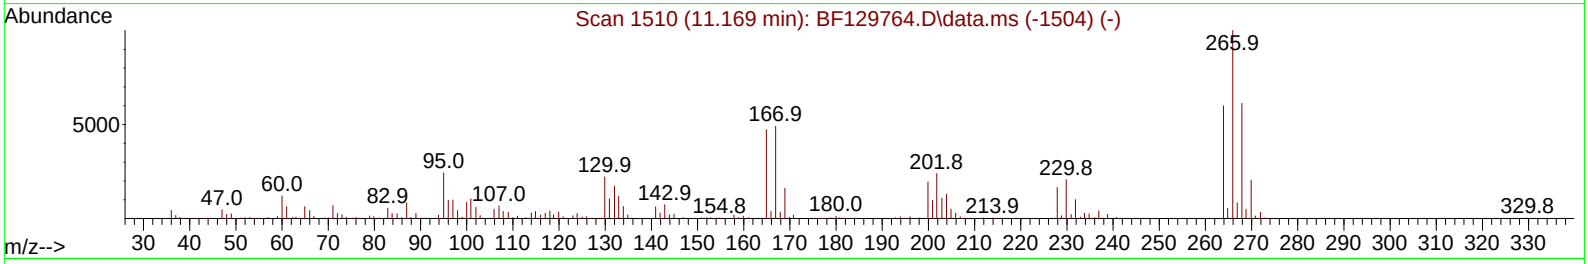

TIC: BF129800.D\data.ms

(70) Pentachlorophenol (C)

11.163min (-0.006) 90056.04 ng

response 253038

Ion	Exp%	Act%
265.70	100.00	100.00
268.00	61.20	64.16
264.00	59.90	63.46
0.00	0.00	0.00

DDT Breakdown

Date	Instrument Name	DFTPP Data File
8/16/2022	BNA_F	BF129800.D
Compound Name	**Response**	**Retention Time**
DDT	823529	13.51
DDD	7281	13.239
DDE	1041	12.874
SUM(DDD+DDE)	**SUM(DDT+DDD+DDE)**	**% Breakdown Of DDT**
8322	831851	1.00

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
DFTPP