DFTPP

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA M\Data\BM090518\
Data File : BM016667.D
Acq On : 05 Sep 2018 11:52
Operator : SJ/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_M
ClientSampleId : DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_M\METHODS\8270-BM082118.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Mon Aug 27 13:01:22 2018

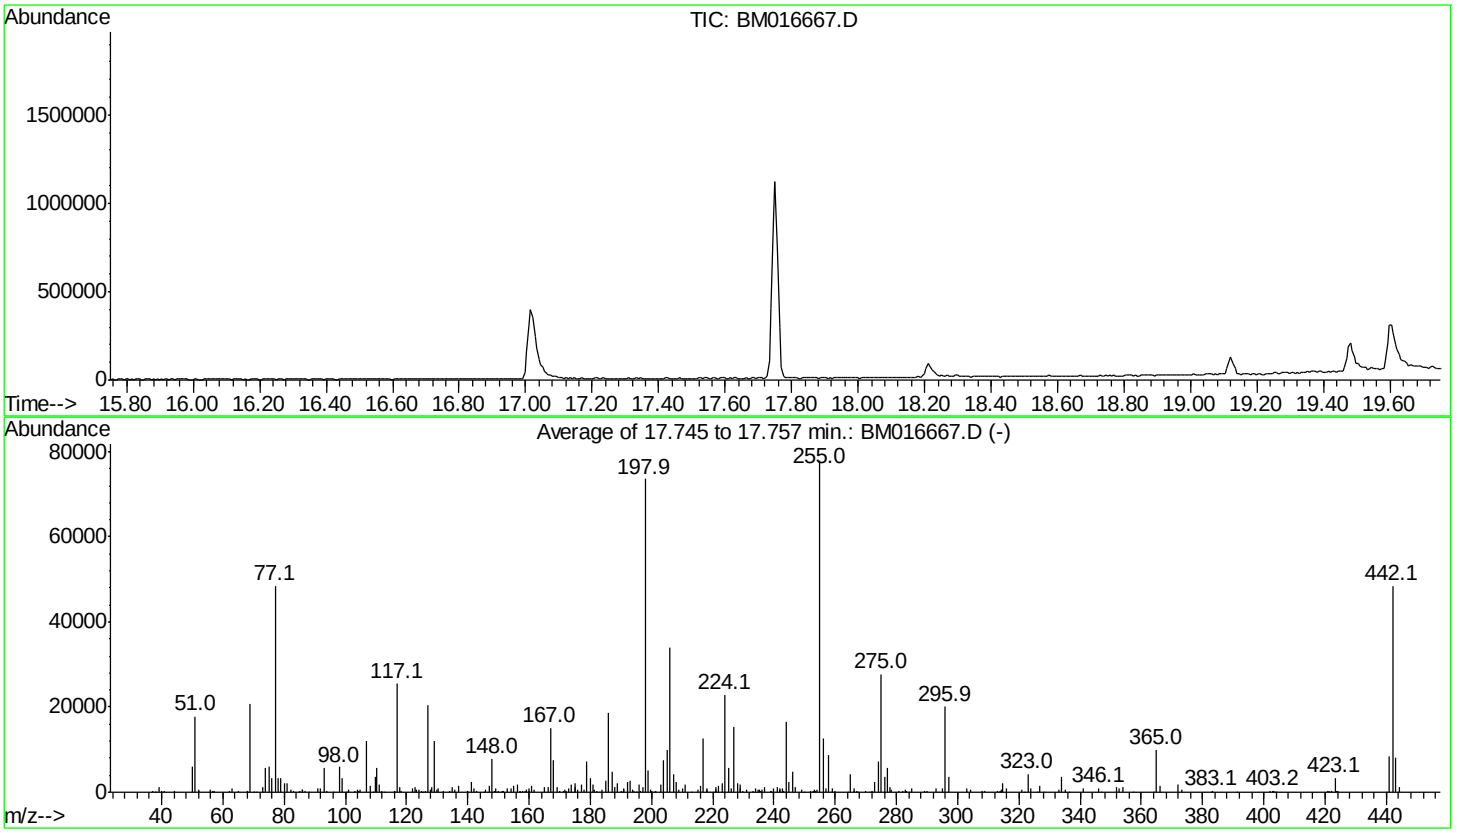

AutoFind: Scans 2458, 2459, 2460; Background Corrected with Scan 2452

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	24.3	17866	PASS
68	69	0.00	2	1.4	295	PASS
69	198	0.00	100	28.3	20799	PASS
70	69	0.00	2	0.6	124	PASS
127	198	10	80	27.7	20410	PASS
197	198	0.00	2	1.5	1087	PASS
198	198	100	100	100.0	73618	PASS
199	198	5	9	7.1	5251	PASS
275	198	10	60	37.6	27696	PASS
365	198	1	100	13.7	10071	PASS
441	198	0.01	100	11.5	8439	PASS
442	198	50	100	65.9	48501	PASS
443	442	15	24	17.0	8258	PASS