DFTPP

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM081324\
Data File : BM047166.D
Acq On : 13 Aug 2024 08:03
Operator : RC/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM081024.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Sun Aug 11 23:47:58 2024

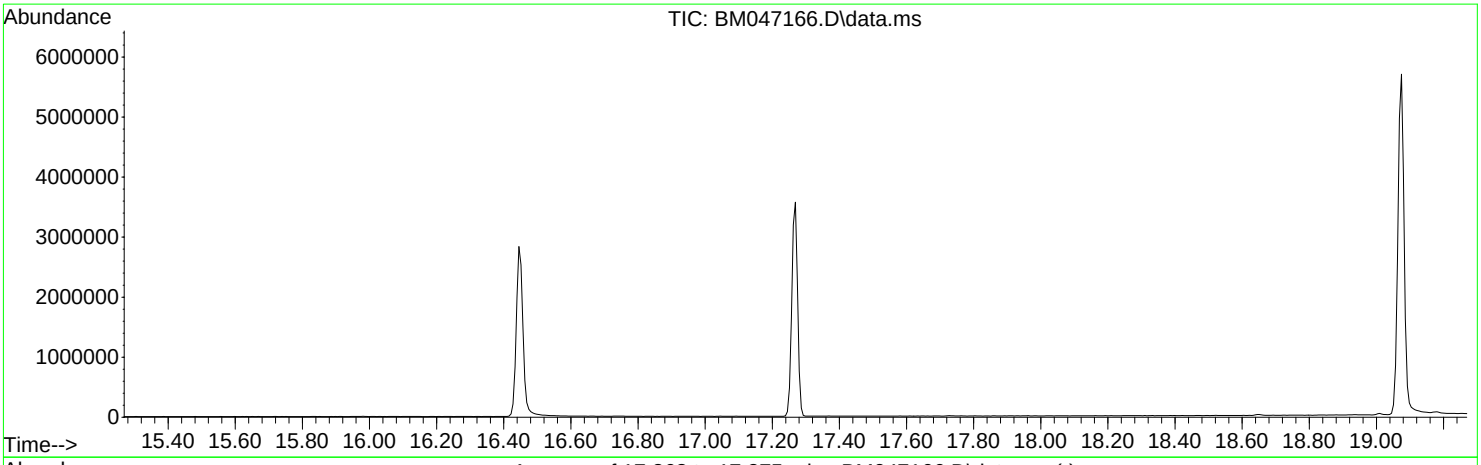

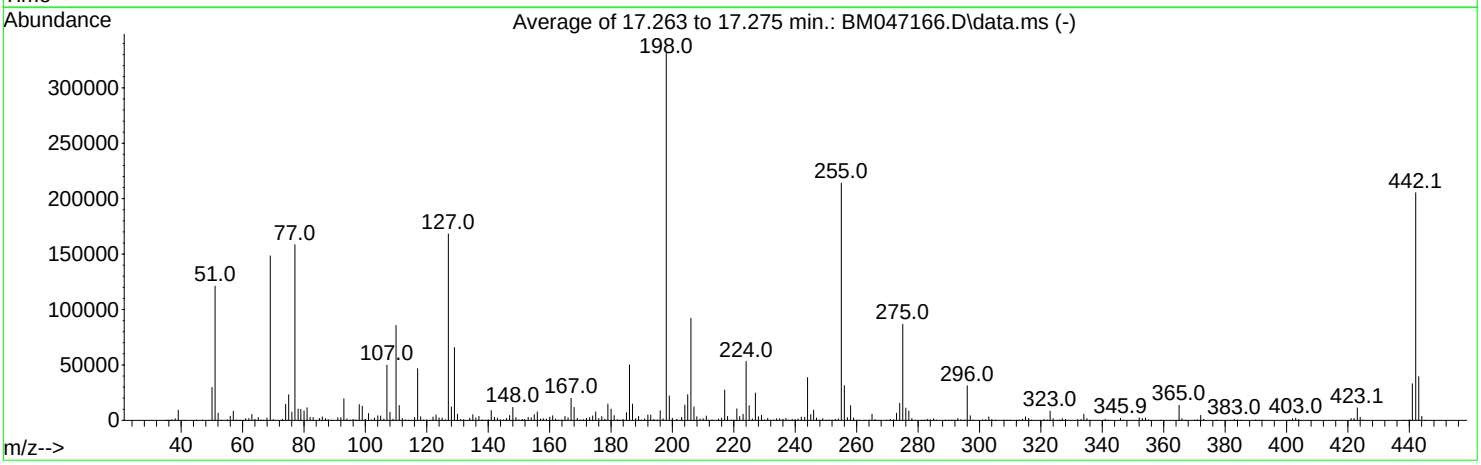

AutoFind: Scans 2444, 2445, 2446; Background Corrected with Scan 2437

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	36.5	121059	PASS
68	69	0.00	2	1.4	2135	PASS
69	198	0.00	100	44.7	148440	PASS
70	69	0.00	2	0.5	783	PASS
127	198	10	80	50.7	168099	PASS
197	198	0.00	2	0.4	1472	PASS
198	198	100	100	100.0	331861	PASS
199	198	5	9	6.7	22111	PASS
275	198	10	60	26.1	86653	PASS
365	198	1	100	4.1	13633	PASS
441	198	0.01	100	9.9	32995	PASS
442	442	50	100	100.0	205397	PASS
443	442	15	24	19.2	39435	PASS

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM081324\
Data File : BM047166.D
Acq On : 13 Aug 2024 08:03
Operator : RC/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
DFTPP

Quant Time: Aug 13 13:30:38 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM081024.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Aug 11 23:47:58 2024
Response via : Initial Calibration

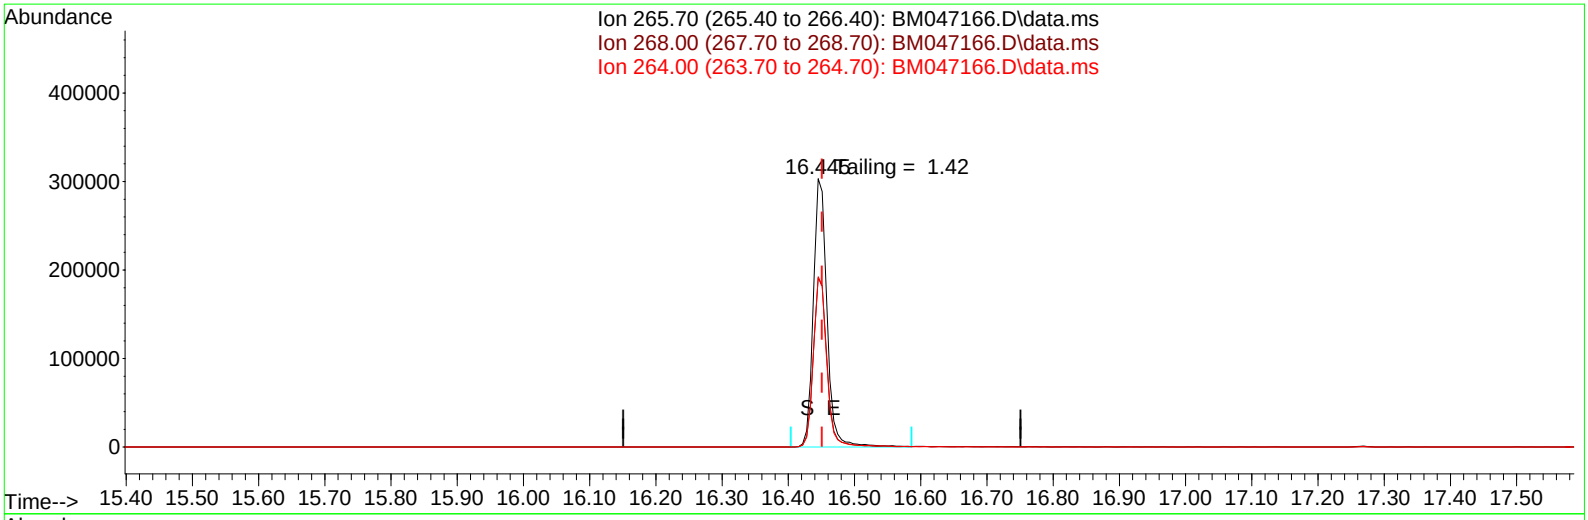

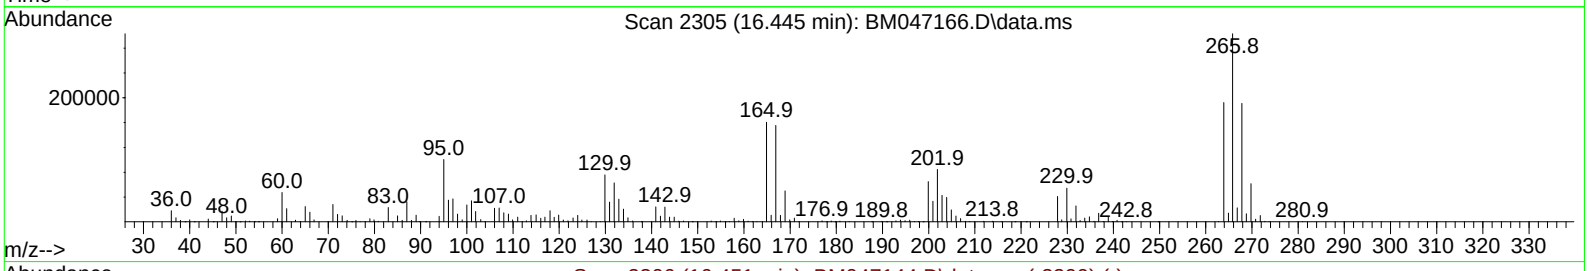

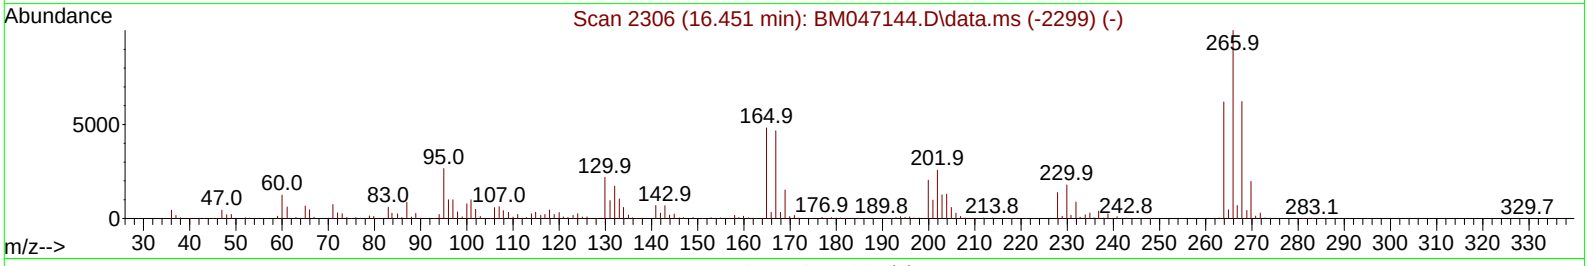

TIC: BM047166.D\data.ms

(70) Pentachlorophenol (C)

16.445min (-0.006) 0.00 ng

response 437248

Ion	Exp%	Act%
265.70	100.00	100.00
268.00	62.20	63.03
264.00	62.00	63.45
0.00	0.00	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM081324\
Data File : BM047166.D
Acq On : 13 Aug 2024 08:03
Operator : RC/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
DFTPP

Quant Time: Aug 13 13:30:38 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270-BM081024.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Aug 11 23:47:58 2024
Response via : Initial Calibration

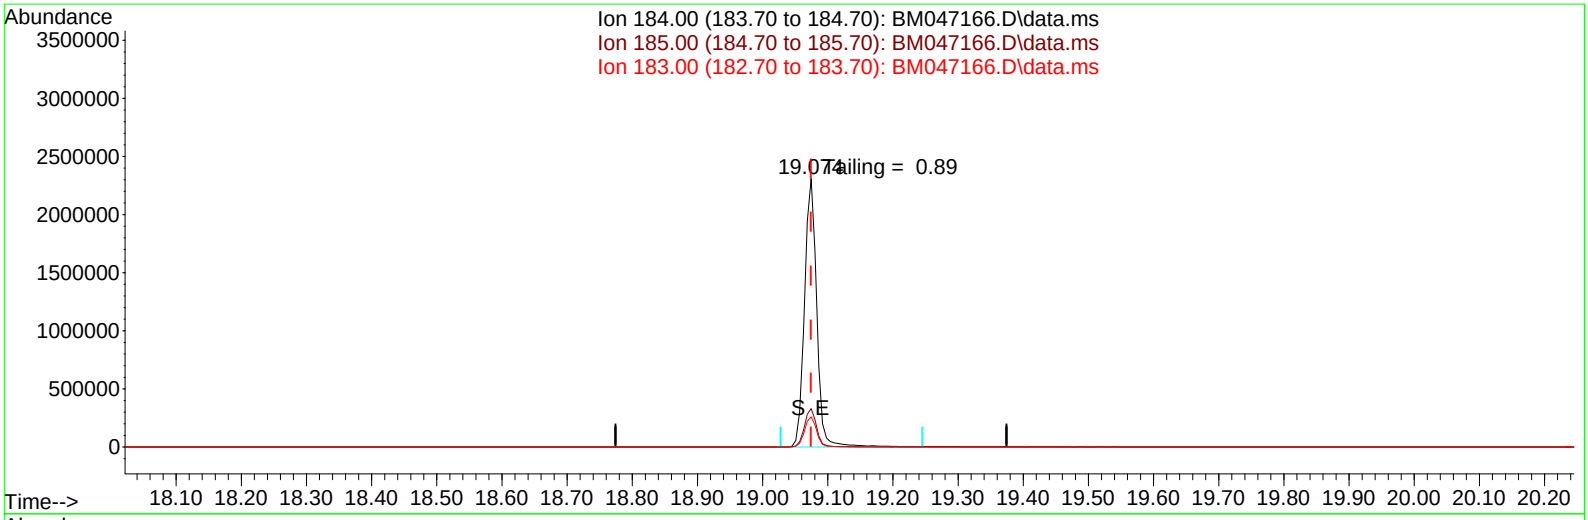

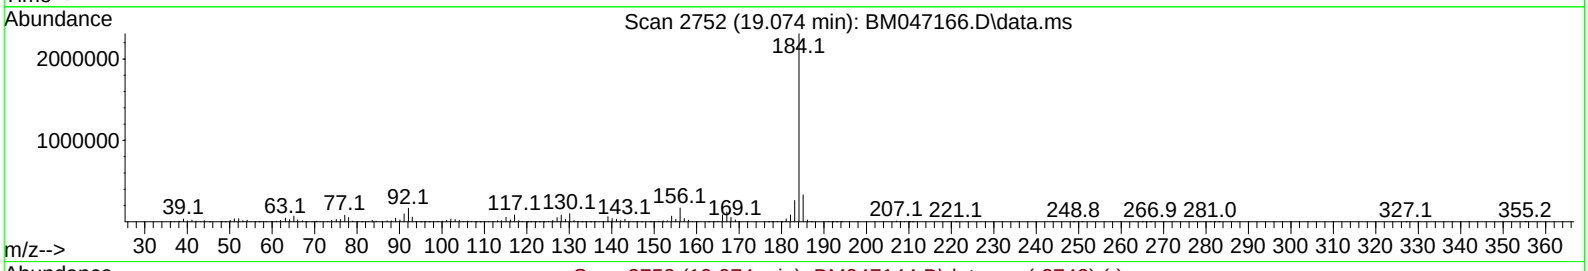

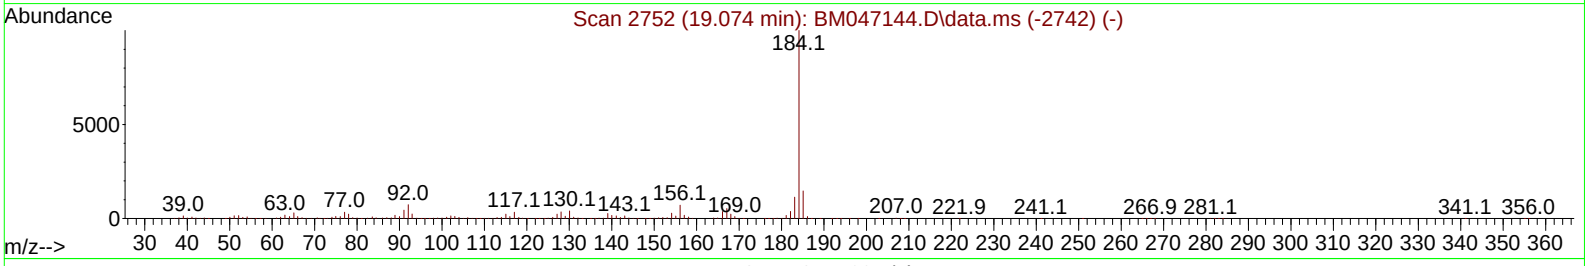

TIC: BM047166.D\data.ms

(77) Benzidine

19.074min (+ 0.000) 299117.76 ng m

response 3028328

Ion	Exp%	Act%
184.00	100.00	100.00
185.00	14.70	14.31
183.00	11.30	11.31
0.00	0.00	0.00

DDT Breakdown

Date	Instrument Name	DFTPP Data File
8/13/2024	BNA_M	BM047166.D
Compound Name	**Response**	**Retention Time**
DDT	1347111	20.321
DDD	17543	19.927
DDE	942	19.357
SUM(DDD+DDE)	**SUM(DDT+DDD+DDE)**	**% Breakdown Of DDT**
18485	1365596	1.35

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
DFTPP