DFTPP

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP033022\
Data File : BP009616.D
Acq On : 30 Mar 2022 12:58
Operator : CG/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP031722.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Thu Mar 31 04:36:51 2022

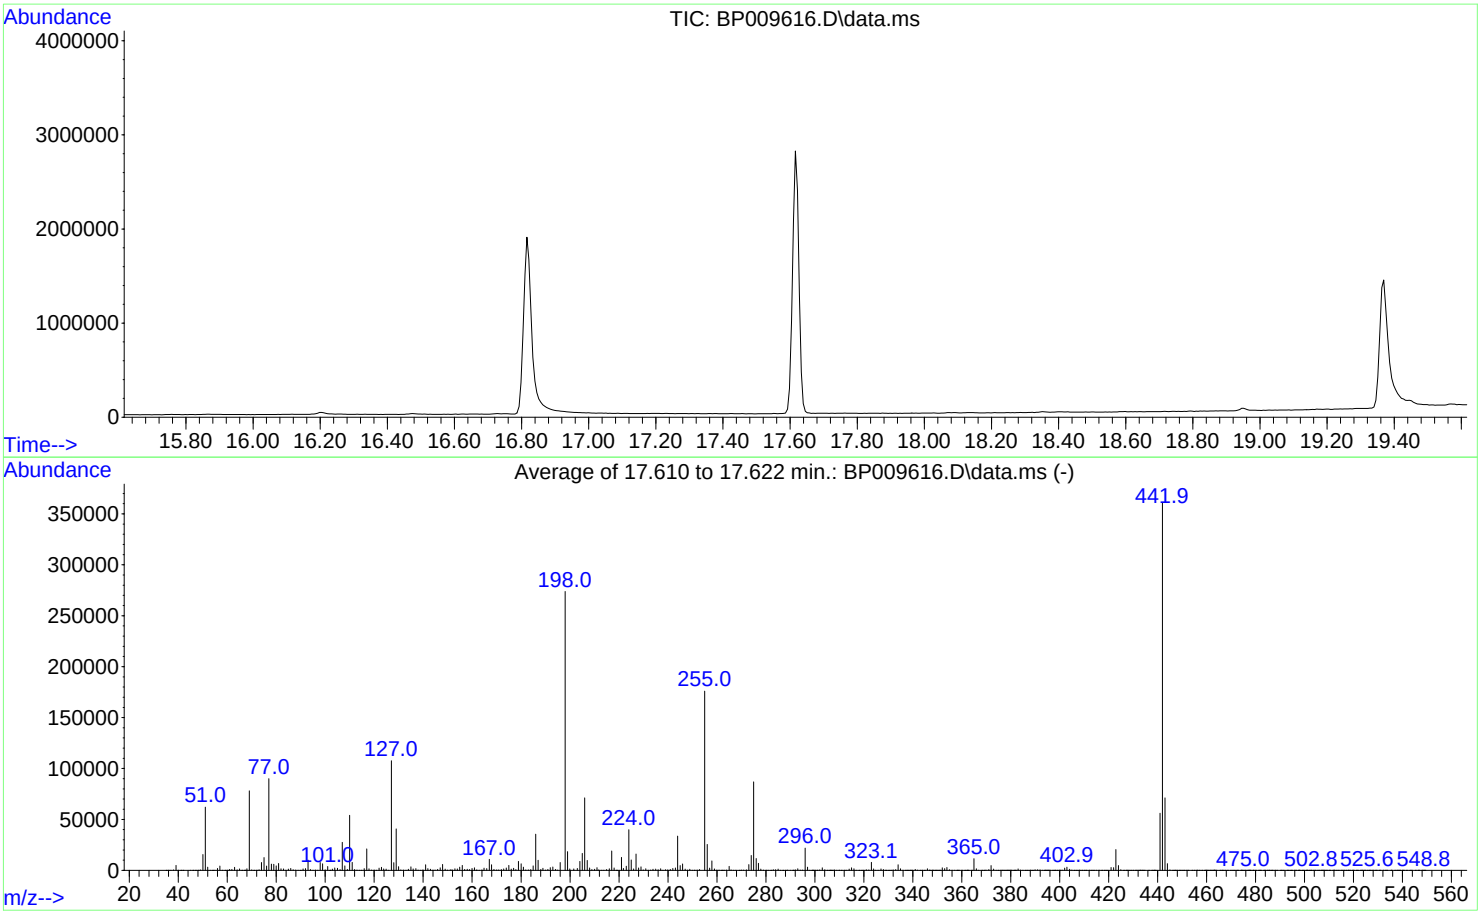

AutoFind: Scans 2486, 2487, 2488; Background Corrected with Scan 2478

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	22.6	62027	PASS
68	69	0.00	2	1.9	1504	PASS
69	198	0.00	100	28.5	78114	PASS
70	69	0.00	2	0.6	470	PASS
127	198	10	80	39.3	107545	PASS
197	198	0.00	2	0.0	0	PASS
198	198	100	100	100.0	273850	PASS
199	198	5	9	6.7	18420	PASS
275	198	10	60	31.7	86926	PASS
365	198	1	100	4.2	11492	PASS
441	198	0.01	100	20.5	56136	PASS
442	442	100	100	100.0	361160	PASS
443	442	15	24	19.7	71165	PASS

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP033022\
Data File : BP009616.D
Acq On : 30 Mar 2022 12:58
Operator : CG/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
DFTPP

Quant Time: Mar 31 05:51:23 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP031722.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 31 04:36:51 2022
Response via : Initial Calibration

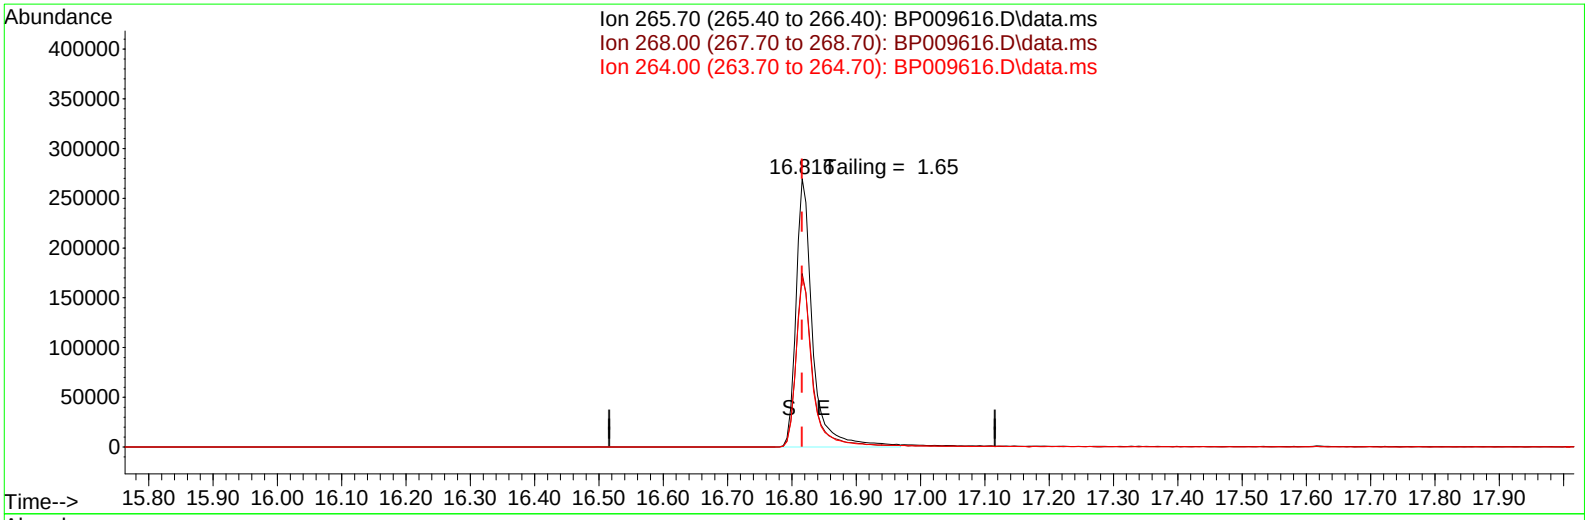

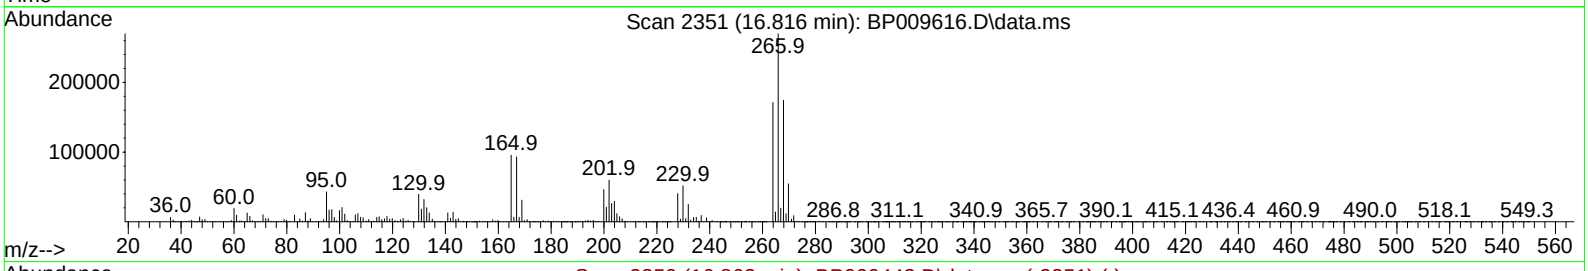

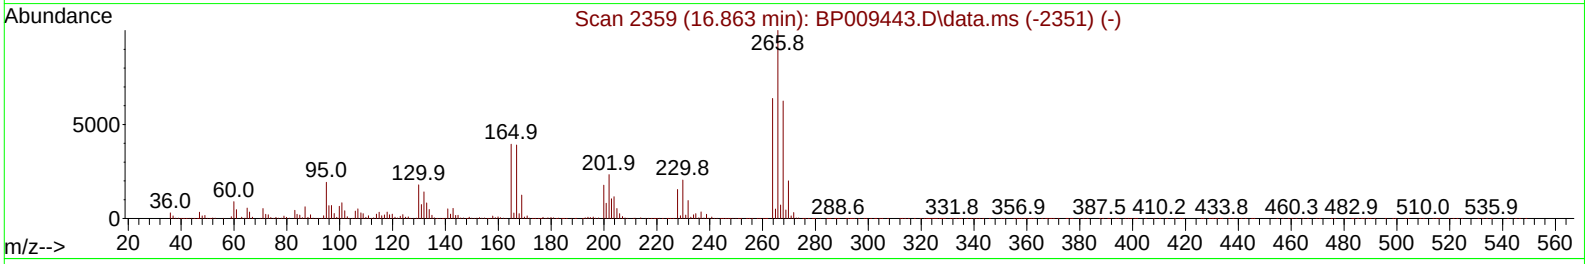

TIC: BP009616.D\data.ms

(70) Pentachlorophenol (C)

16.816min (+ 0.000) 3263319.14 ng

response 491340

Ion	Exp%	Act%
265.70	100.00	100.00
268.00	62.30	64.58
264.00	63.60	63.44
0.00	0.00	0.00

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP033022\
Data File : BP009616.D
Acq On : 30 Mar 2022 12:58
Operator : CG/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
DFTPP

Quant Time: Mar 31 05:51:23 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP031722.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 31 04:36:51 2022
Response via : Initial Calibration

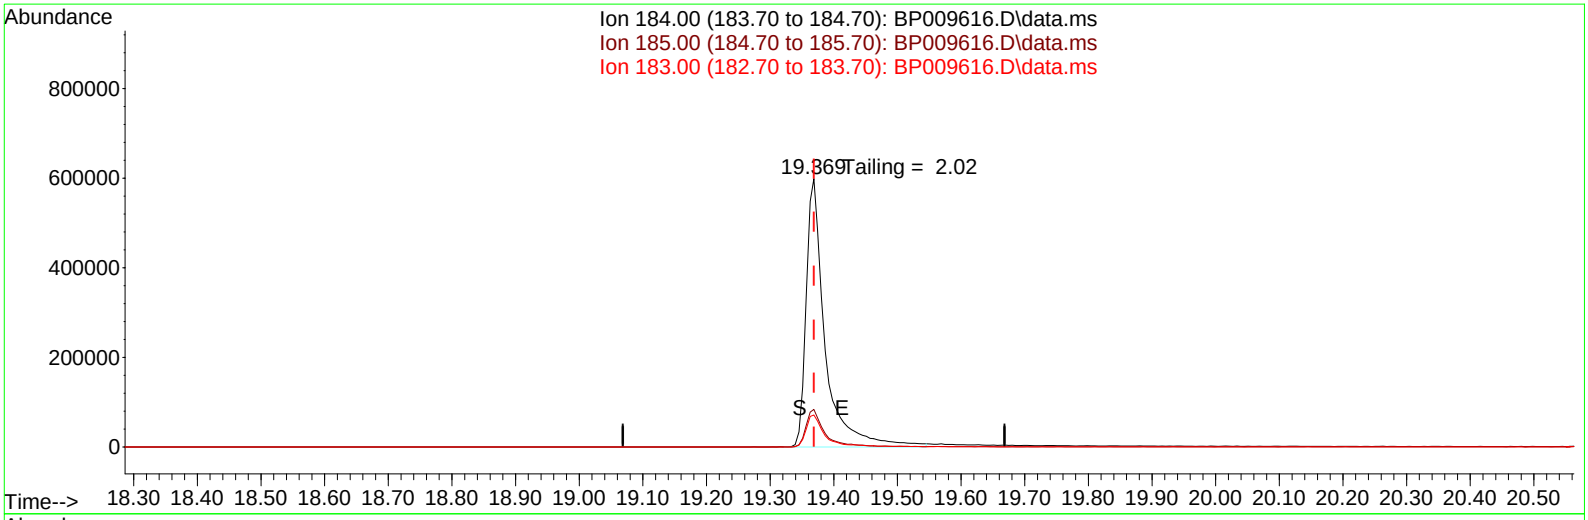

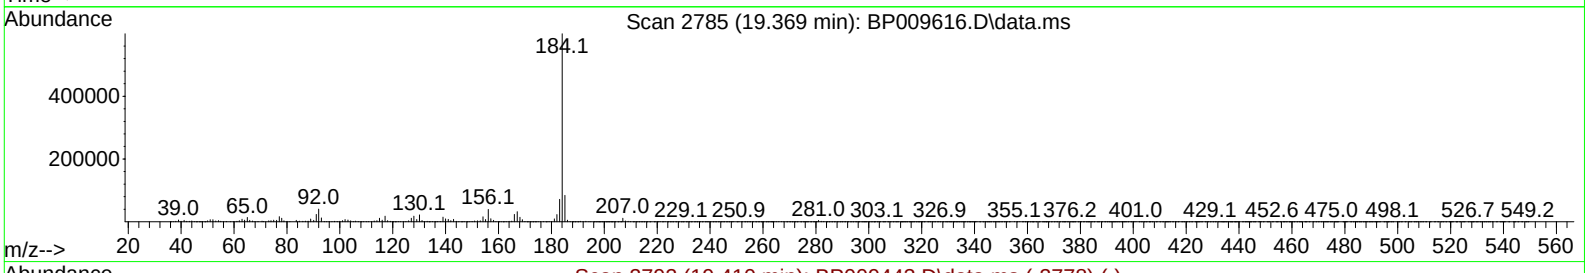

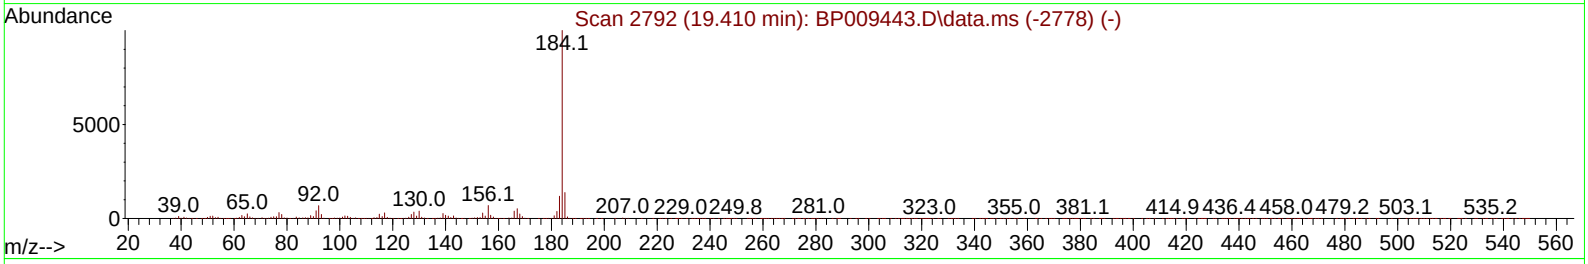

TIC: BP009616.D\data.ms

(77) Benzidine

19.369min (+ 0.000) 107110.57 ng

response 1252326

Ion	Exp%	Act%
184.00	100.00	100.00
185.00	14.40	14.02
183.00	11.70	11.92
0.00	0.00	0.00

DDT Breakdown

Date	Instrument Name	DFTPP Data File
3/31/2022	BNA_P	BP009616.D
Compound Name	**Response**	**Retention Time**
DDT	1047279	20.575
DDD	19786	20.151
DDE	2599	19.651
SUM(DDD+DDE)	**SUM(DDT+DDD+DDE)**	**% Breakdown Of DDT**
22385	1069664	2.09

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
DFTPP