DFTPP

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP061725\
Data File : BP024970.D
Acq On : 17 Jun 2025 10:33
Operator : RC/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-Tune.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Tue Mar 29 08:52:24 2022

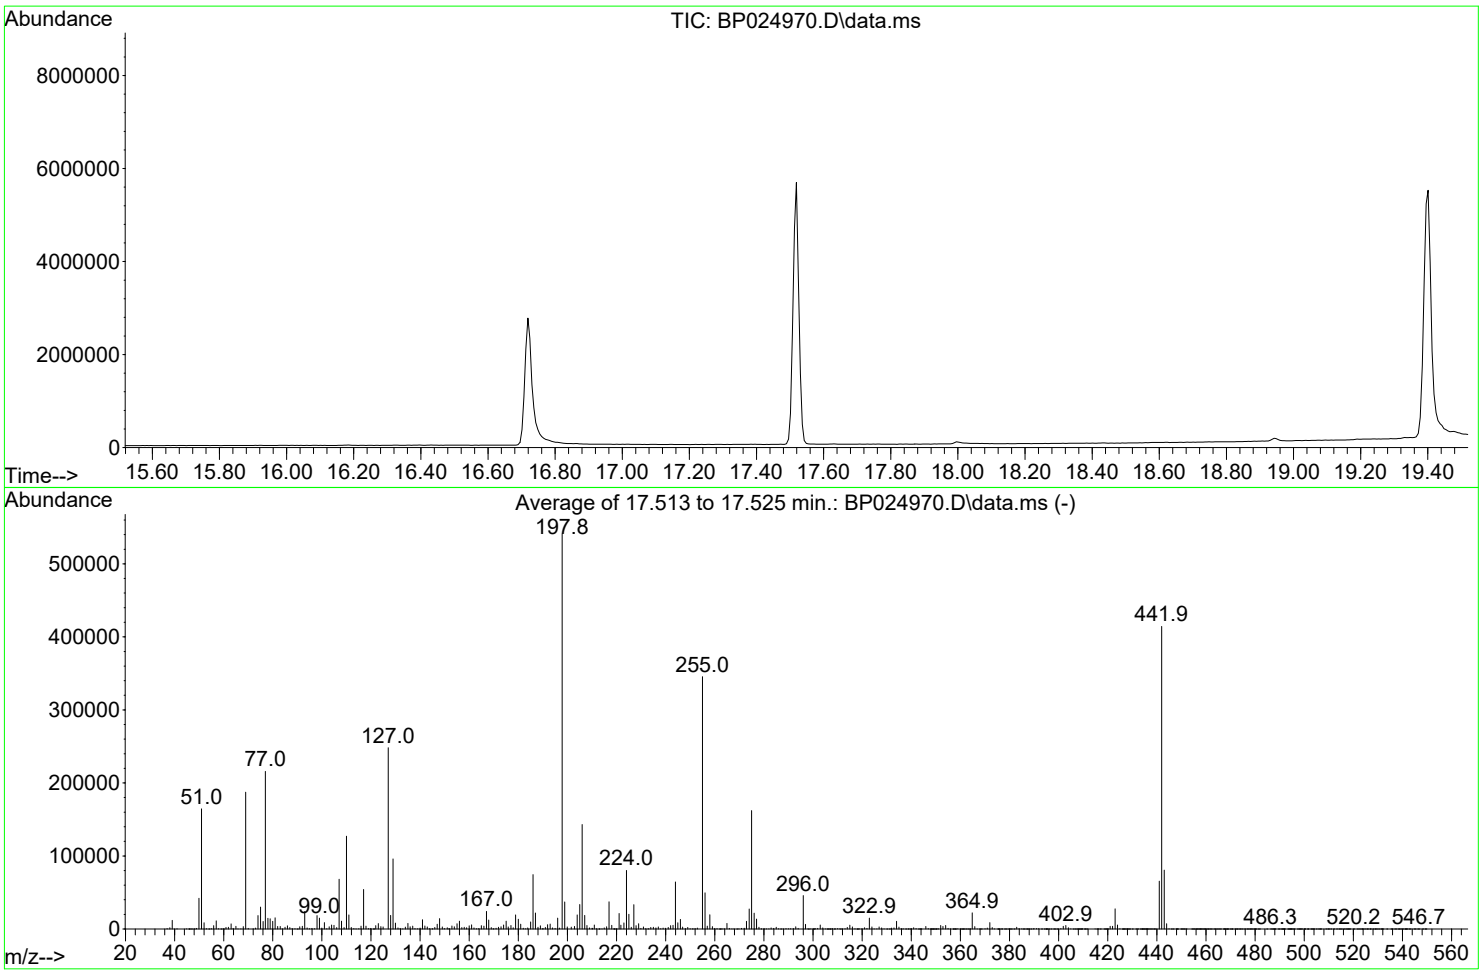

AutoFind: Scans 2478, 2479, 2480; Background Corrected with Scan 2470

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
68	69	0.00	2	1.8	3295	PASS
69	69	100	100	100.0	187411	PASS
70	69	0.00	2	0.5	893	PASS
197	198	0.00	2	0.2	1297	PASS
198	198	100	100	100.0	540631	PASS
199	198	5	9	6.9	37051	PASS
365	198	1	100	4.1	22100	PASS
441	443	0.01	150	81.2	65565	PASS
442	442	100	100	100.0	414312	PASS
443	442	15	24	19.5	80731	PASS

DDT Breakdown

Date	Instrument Name	DFTPP Data File
4/17/2025	BNA_P	BP024370.D
Compound Name	**Response**	**Retention Time**
DDT	1878735	20.677
DDD	44764	20.225
DDE	5557	19.689
SUM(DDD+DDE)	**SUM(DDT+DDD+DDE)**	**% Breakdown Of DDT**
50321	1929056	2.61

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
DFTPP

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP061725\
Data File : BP024970.D
Acq On : 17 Jun 2025 10:33
Operator : RC/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
DFTPP

Quant Time: Jun 17 19:06:36 2025
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP060625.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 06 16:20:27 2025
Response via : Initial Calibration

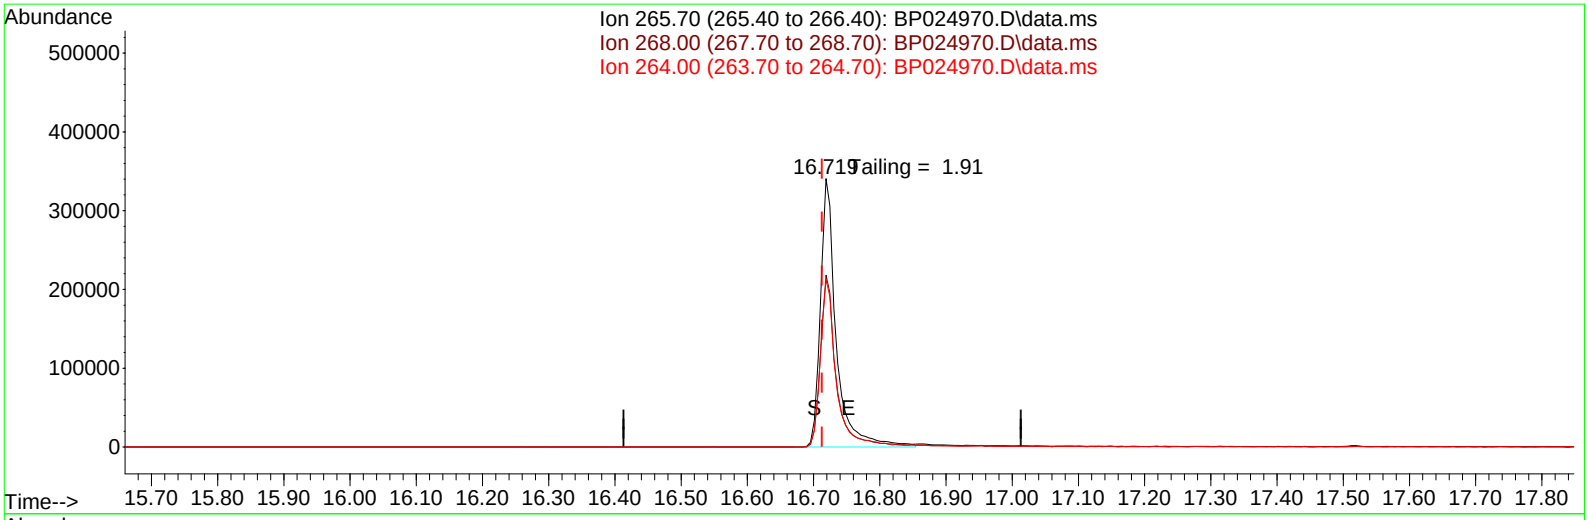

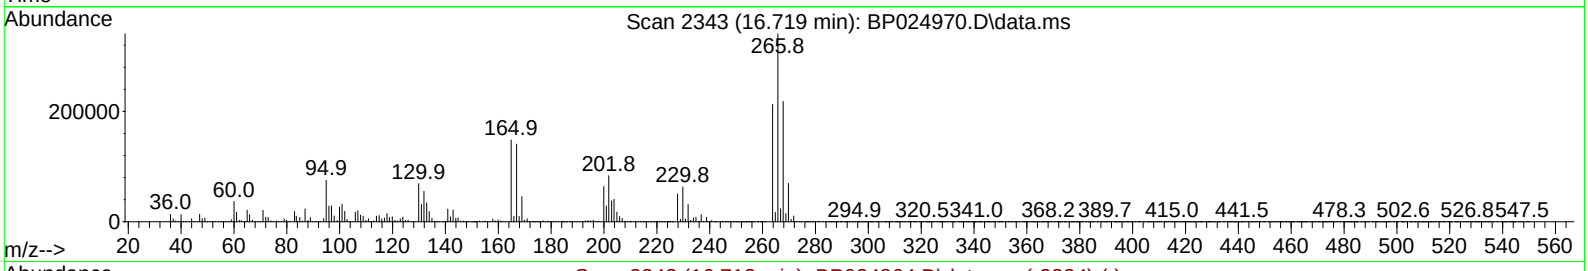

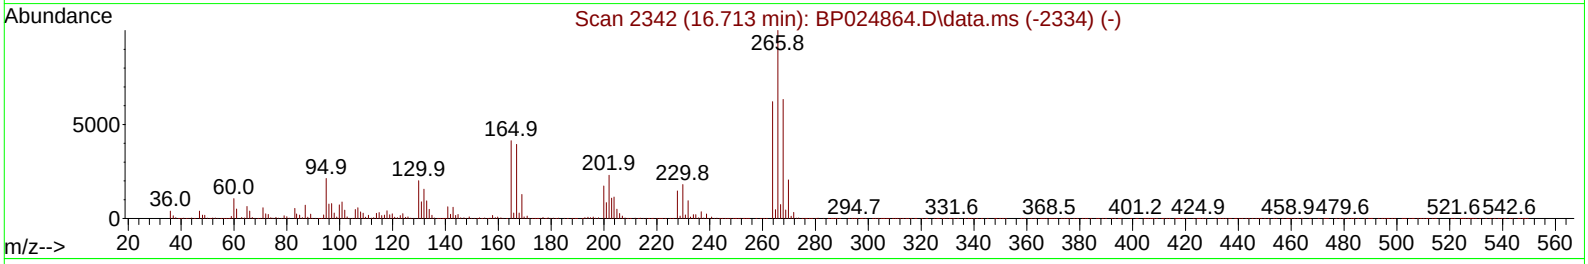

TIC: BP024970.D\data.ms

(70) Pentachlorophenol (C)

16.719min (+ 0.006) 144164.25 ng

response 565406

Ion	Exp%	Act%
265.70	100.00	100.00
268.00	63.30	64.02
264.00	62.10	62.41
0.00	0.00	0.00

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP061725\
Data File : BP024970.D
Acq On : 17 Jun 2025 10:33
Operator : RC/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
DFTPP

Quant Time: Jun 17 19:06:36 2025
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP060625.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 06 16:20:27 2025
Response via : Initial Calibration

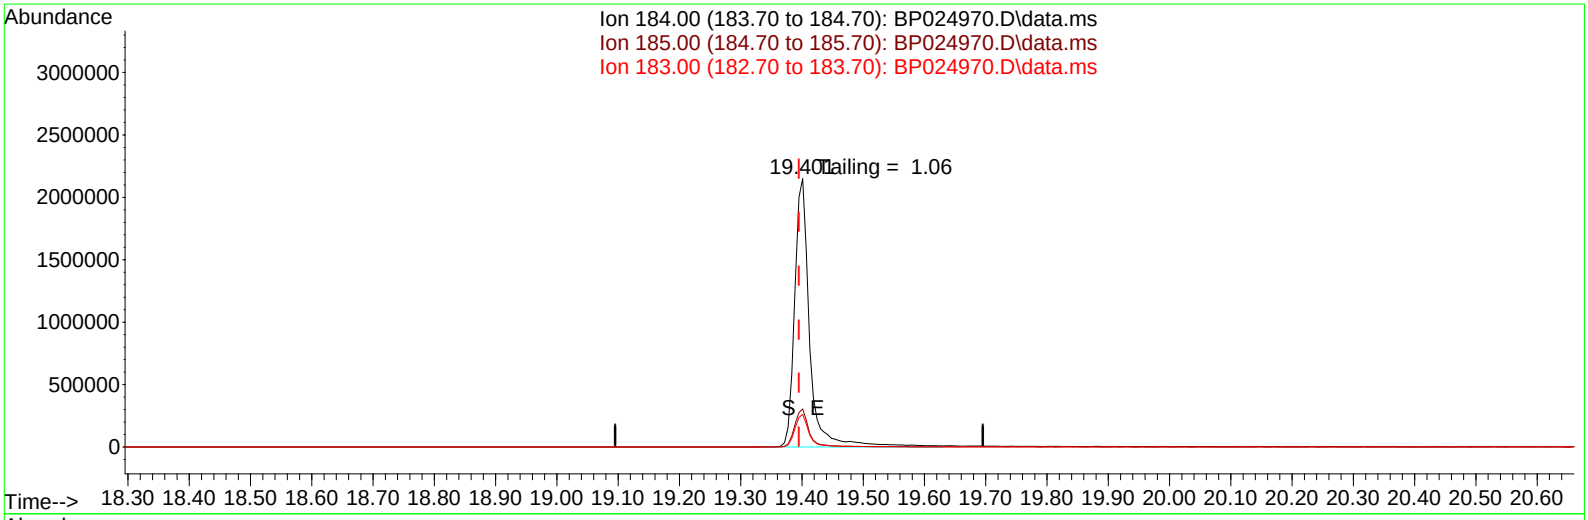

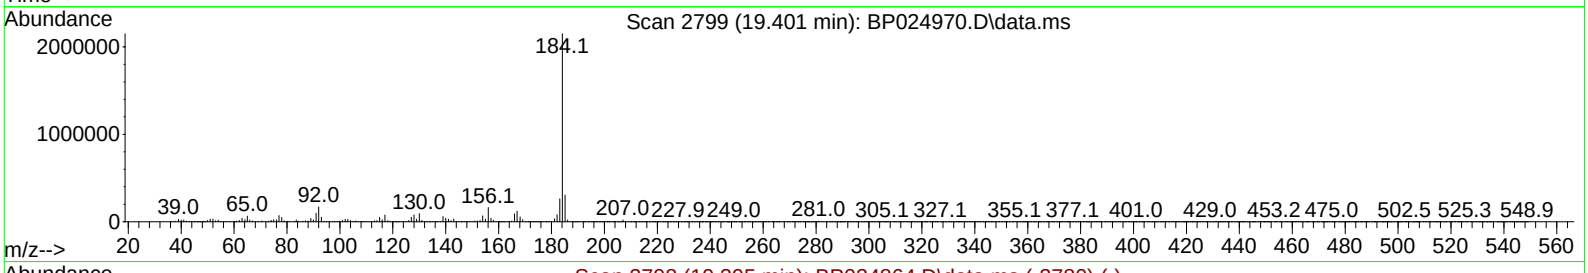

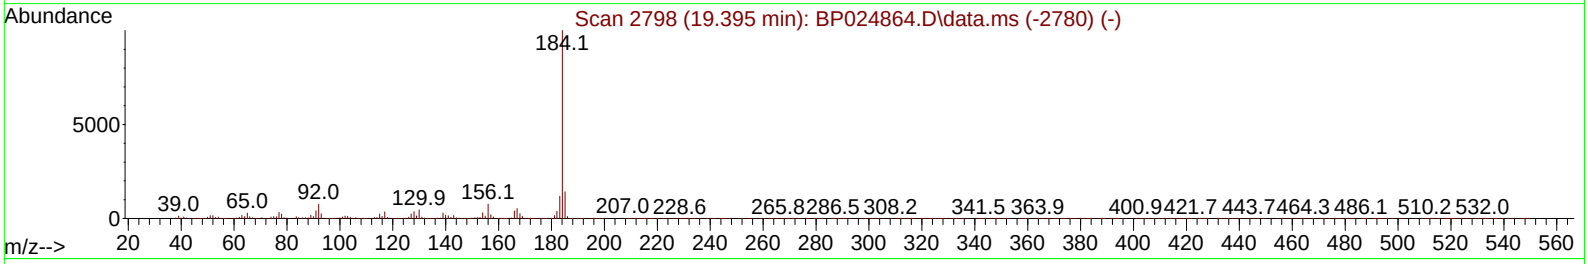

TIC: BP024970.D\data.ms

(77) Benzidine

19.401min (+ 0.006) 60269.07 ng

response 3690309

Ion	Exp%	Act%
184.00	100.00	100.00
185.00	14.20	14.19
183.00	11.90	12.18
0.00	0.00	0.00