DFTPP

Data Path : U:\HPCHEM1\BNA G\Data\BG011018\
Data File : BG031977.D
Acq On : 10 Jan 2018 14:39
Operator : SJ/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** BNA_G
**ClientSampleId :** DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG122117.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Fri Jan 05 15:31:34 2018

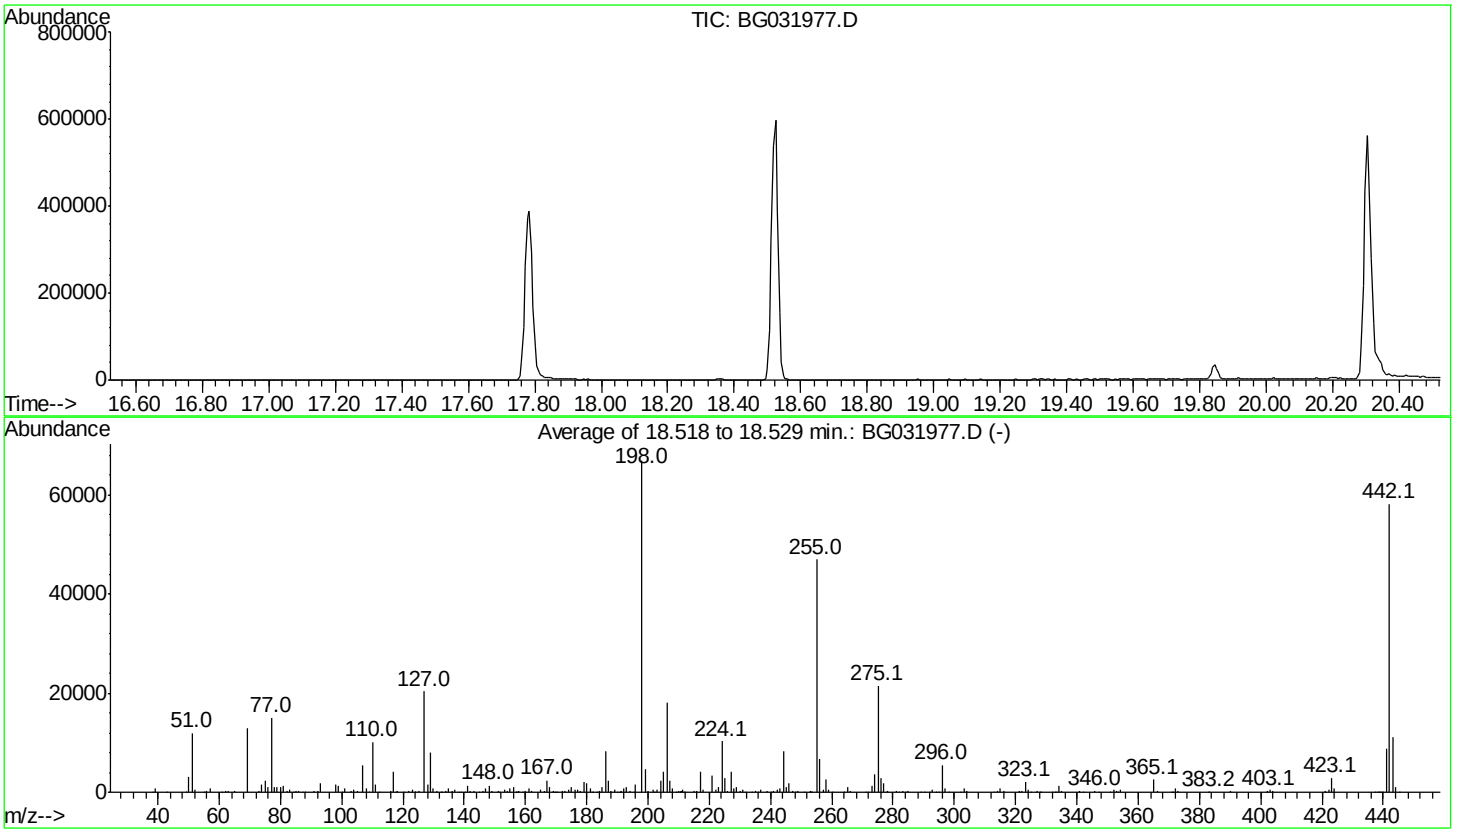


AutoFind: Scans 2592, 2593, 2594; Background Corrected with Scan 2585

| Target Mass | Rel. to Mass | Lower Limit% | Upper Limit% | Rel. Abn% | Raw Abn | Result Pass/Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 198 | 10 | 80 | 17.8 | 11951 | PASS |
| 68 | 69 | 0.00 | 2 | 0.0 | 0 | PASS |
| 69 | 198 | 0.00 | 100 | 19.2 | 12876 | PASS |
| 70 | 69 | 0.00 | 2 | 0.0 | 0 | PASS |
| 127 | 198 | 10 | 80 | 30.3 | 20305 | PASS |
| 197 | 198 | 0.00 | 2 | 0.0 | 0 | PASS |
| 198 | 198 | 100 | 100 | 100.0 | 66968 | PASS |
| 199 | 198 | 5 | 9 | 6.8 | 4537 | PASS |
| 275 | 198 | 10 | 60 | 32.1 | 21485 | PASS |
| 365 | 198 | 1 | 100 | 3.8 | 2576 | PASS |
| 441 | 442 | 0.01 | 24 | 15.3 | 8920 | PASS |
| 442 | 198 | 50 | 100 | 87.0 | 58250 | PASS |
| 443 | 442 | 15 | 24 | 19.1 | 11149 | PASS |