DFTPP

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG020317\
Data File : BG025763.D
Acq On : 2 Feb 2017 18:22
Operator : SJ/MA
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG013017.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Mon Jan 30 18:29:38 2017

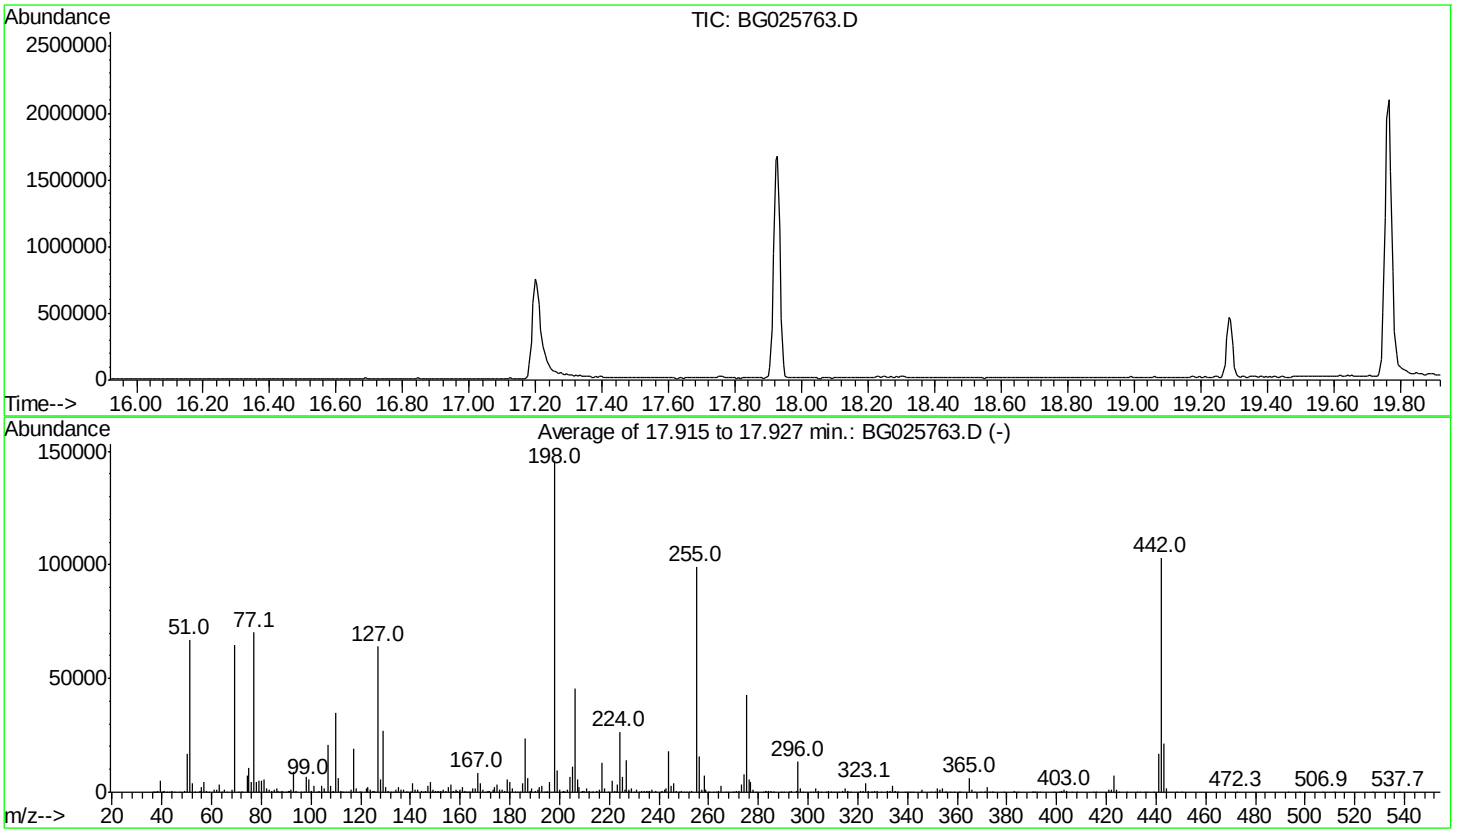

AutoFind: Scans 2566, 2567, 2568; Background Corrected with Scan 2560

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	46.0	67068	PASS
68	69	0.00	2	1.6	1012	PASS
69	198	0.00	100	44.4	64760	PASS
70	69	0.00	2	0.0	0	PASS
127	198	10	80	44.0	64120	PASS
197	198	0.00	2	0.0	0	PASS
198	198	100	100	100.0	145818	PASS
199	198	5	9	6.7	9818	PASS
275	198	10	60	29.5	43005	PASS
365	198	1	100	4.3	6314	PASS
441	442	0.01	24	16.6	17115	PASS
442	198	50	100	70.7	103096	PASS
443	442	15	24	20.9	21528	PASS