DFTPP

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG042116\
Data File : BG021777.D
Acq On : 20 Apr 2016 9:49
Operator : UM/SJ
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG041316.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Wed Apr 13 15:48:13 2016

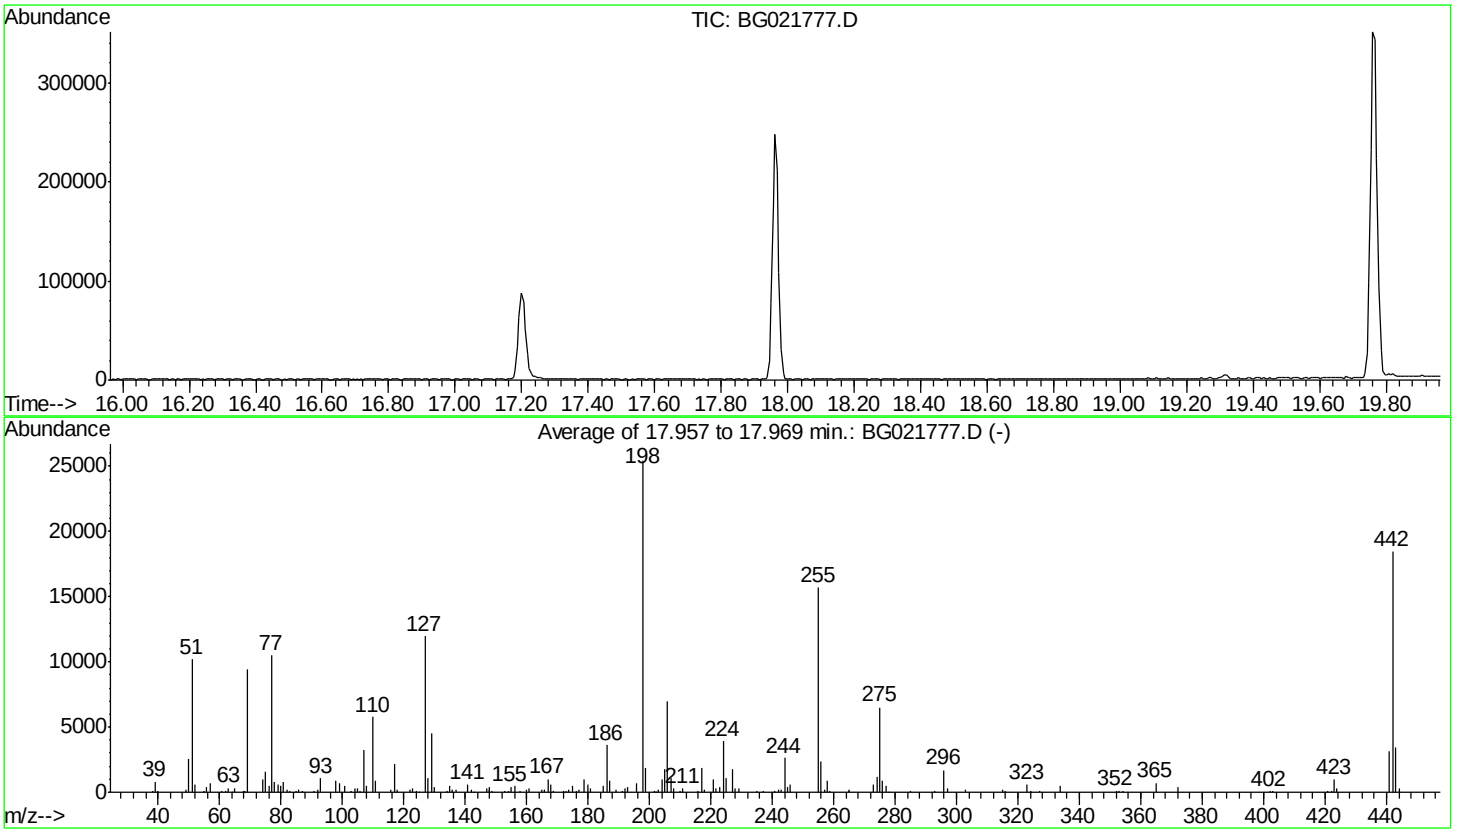

AutoFind: Scans 2573, 2574, 2575; Background Corrected with Scan 2567

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	40.0	10184	PASS
68	69	0.00	2	1.0	91	PASS
69	198	0.00	100	37.3	9475	PASS
70	69	0.00	2	0.0	0	PASS
127	198	10	80	46.9	11939	PASS
197	198	0.00	2	0.0	0	PASS
198	198	100	100	100.0	25434	PASS
199	198	5	9	7.4	1893	PASS
275	198	10	60	25.6	6506	PASS
365	198	1	100	2.9	732	PASS
441	442	0.01	24	16.9	3120	PASS
442	198	50	100	72.4	18423	PASS
443	442	15	24	18.9	3476	PASS