DFTPP

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG091616\
Data File : BG024009.D
Acq On : 17 Sep 2016 1:05
Operator : UM/SJ
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG083116.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Fri Sep 09 16:24:09 2016

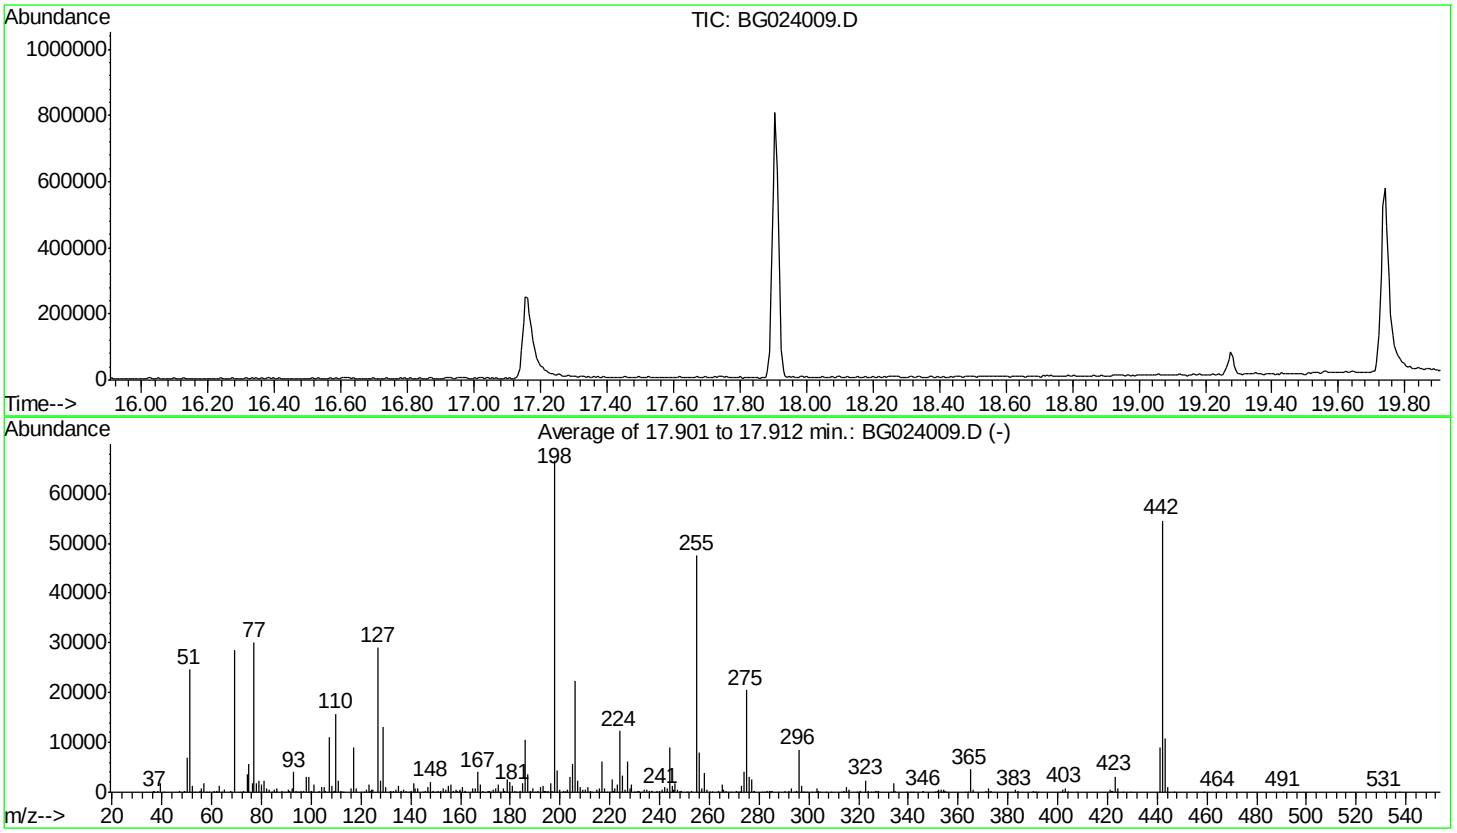

AutoFind: Scans 2564, 2565, 2566; Background Corrected with Scan 2557

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
51	198	10	80	36.9	24610	PASS
68	69	0.00	2	0.8	228	PASS
69	198	0.00	100	42.9	28552	PASS
70	69	0.00	2	0.0	0	PASS
127	198	10	80	43.5	28965	PASS
197	198	0.00	2	0.3	205	PASS
198	198	100	100	100.0	66616	PASS
199	198	5	9	6.7	4431	PASS
275	198	10	60	30.8	20514	PASS
365	198	1	100	6.9	4613	PASS
441	442	0.01	24	16.6	9070	PASS
442	198	50	100	82.0	54605	PASS
443	442	15	24	19.6	10719	PASS