Quantitation Report (Not Reviewed)

Data File : Z:\HPCHEM1\HPLC_B\DATA\HB011013\HB001029.D Vial: 22
Acq On : 10-Jan-2013, 12:40 Operator: QM
Sample : E1002-01RE Inst : G1315A
Misc : Multiplr: 1.00
IntFile : autoint1.e
Quant Time: Jan 10 14:19 2013 Quant Results File: HB010913.RES

Quant Method : Z:\HPCHEM1\HPLC_B\METHOD\HB010913.M
Title :
Last Update : Wed Jan 09 14:12:24 2013
Response via : Initial Calibration
DataAcq Meth : 8330AGIP.M

Volume Inj. : 50 ul
Signal Phase : ZORBAX Extend-C18
Signal Info : 4.6 X 100mm 3.5-Micron 80A

	Compound	R.T.	Response	Conc	Units
	System Monitoring Compounds				
	Target Compounds				
2) T	HMX	0.83	842172	1037.324	ug/L
3) T	RDX	1.64	998471	1588.963	ug/L
4) T	1,3,5-Trinitrobenzene	2.58	3255116	2246.945	ug/L
5) T	1,3-Dinitrobenzene	3.41	3780264	2741.398	ug/L
6) T	Nitrobenzene	4.56	834840	780.359	ug/L

Quantitation Report

Data File : Z:\HPCHEM1\HPLC_B\DATA\HB011013\HB001029.D Vial: 22
Acq On : 10-Jan-2013, 12:40 Operator: QM
Sample : E1002-01RE Inst : G1315A
Misc : Multiplr: 1.00
IntFile : autoint1.e
Quant Time: Jan 10 14:19 2013 Quant Results File: HB010913.RES

Quant Method : Z:\HPCHEM1\HPLC_B\METHOD\HB010913.M
Title :
Last Update : Wed Jan 09 14:12:24 2013
Response via : Multiple Level Calibration
DataAcq Meth : 8330AGIP.M

Volume Inj. : 50 ul
Signal Phase : ZORBAX Extend-C18
Signal Info : 4.6 X 100mm 3.5-Micron 80A

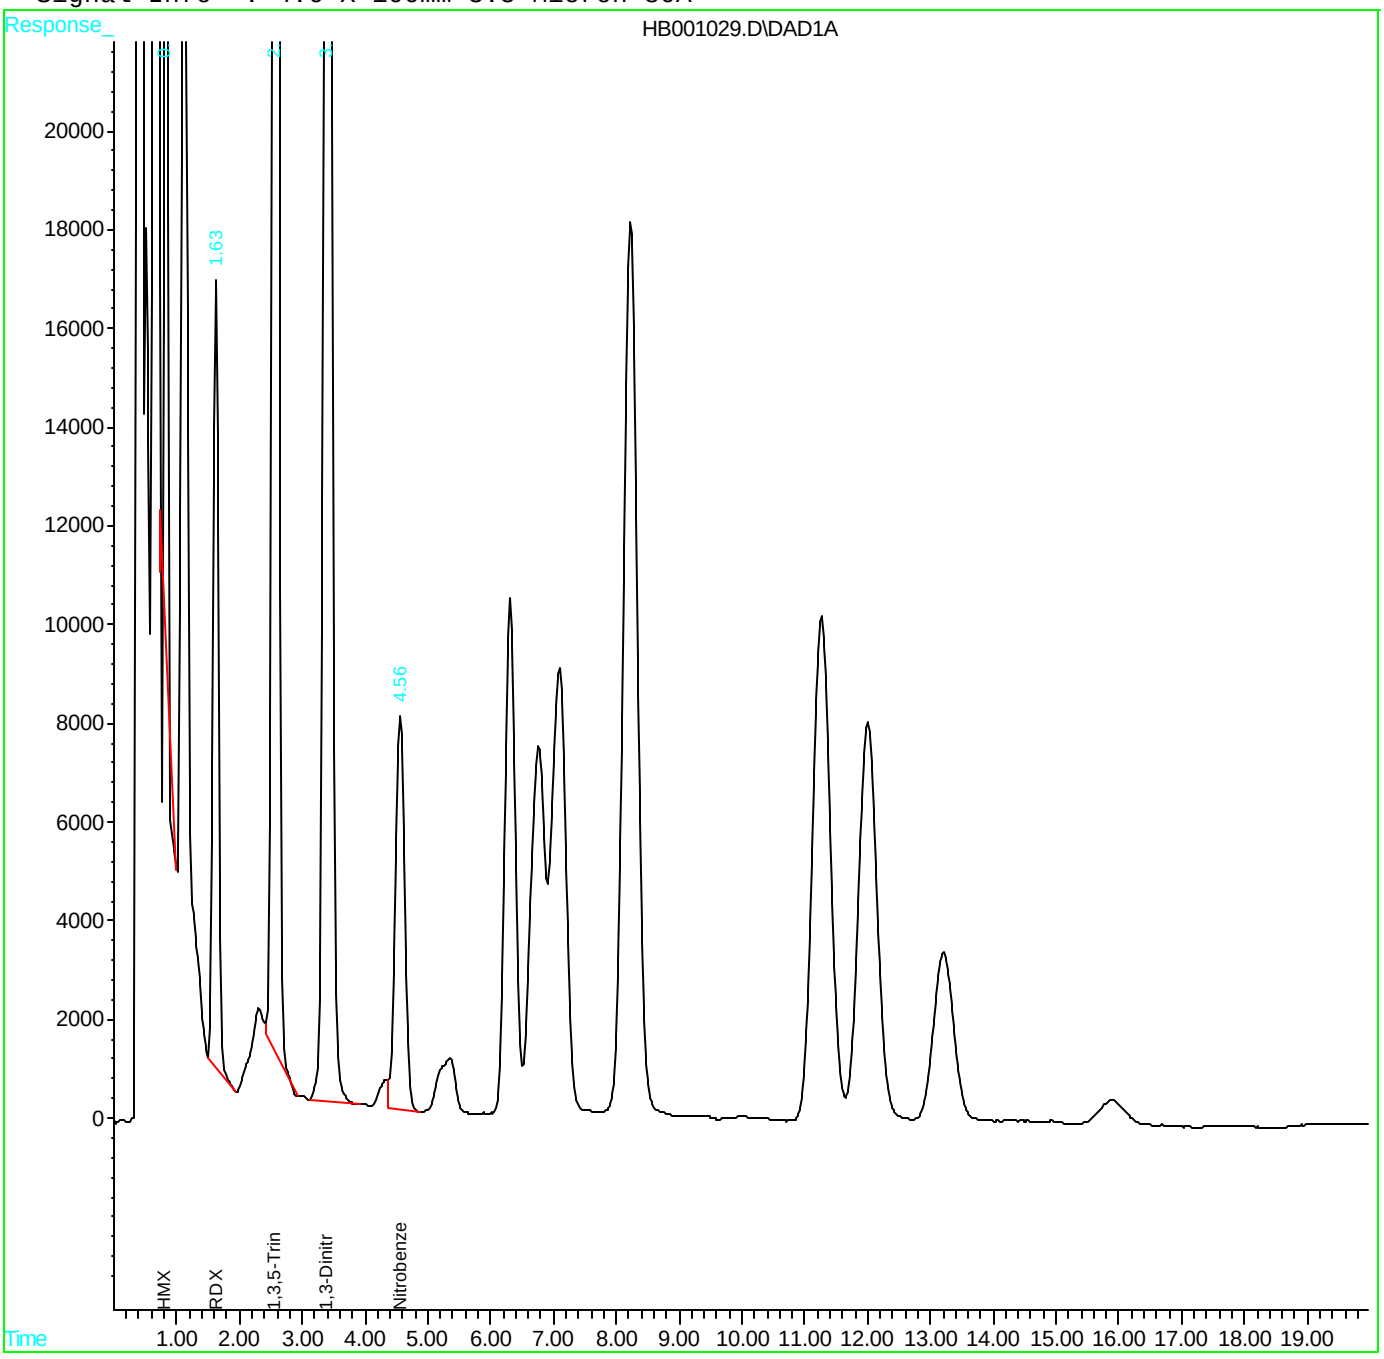

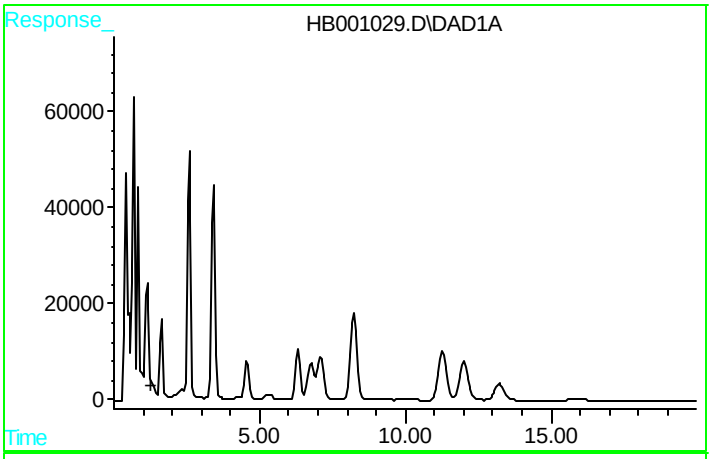

#1 4-Nitroaniline

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 1.276 min
Response: 0
Conc: N.D.

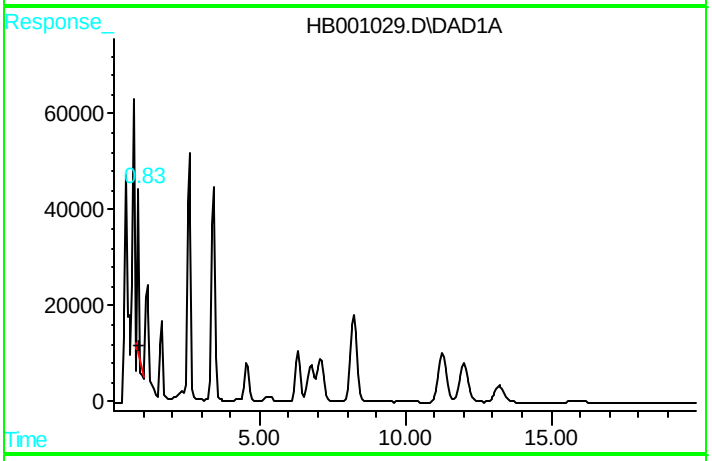

#2 HMX

R.T.: 0.834 min
Delta R.T.: -0.006 min
Response: 842172
Conc: 1037.32 ug/L

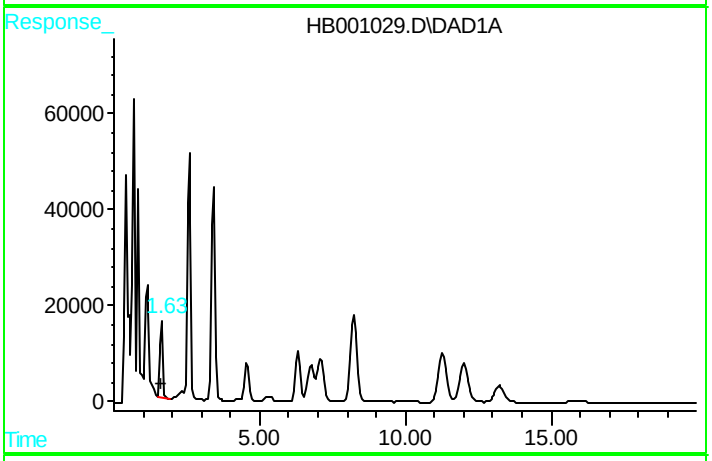

#3 RDX

R.T.: 1.635 min
Delta R.T.: -0.011 min
Response: 998471
Conc: 1588.96 ug/L

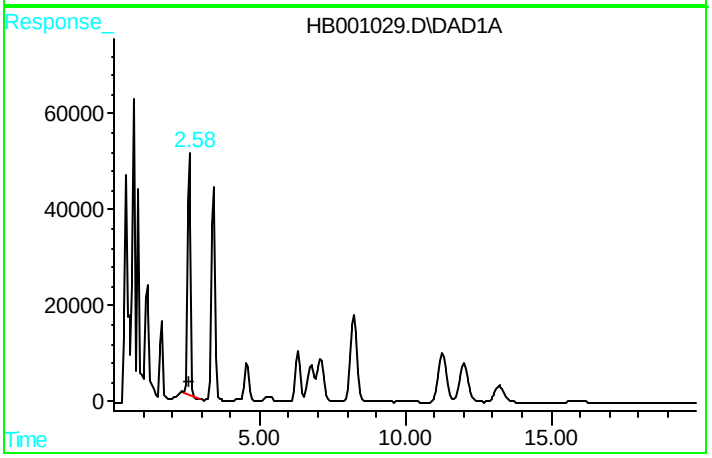

#4 1,3,5-Trinitrobenzene

R.T.: 2.578 min
Delta R.T.: -0.023 min
Response: 3255116
Conc: 2246.94 ug/L

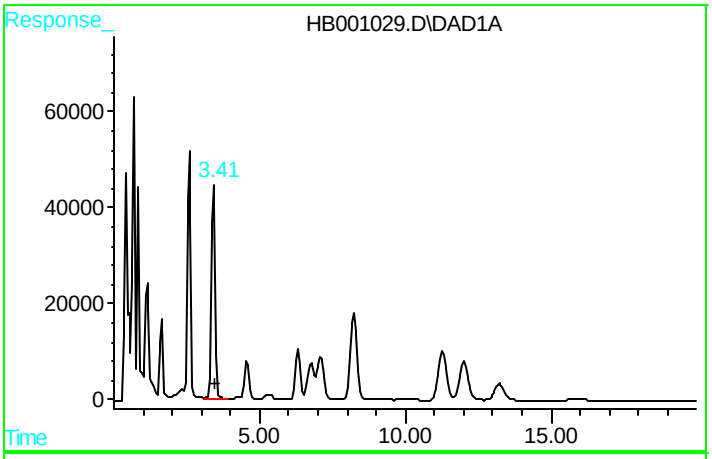

#5 1,3-Dinitrobenzene

R.T.: 3.413 min
Delta R.T.: -0.032 min
Response: 3780264
Conc: 2741.40 ug/L

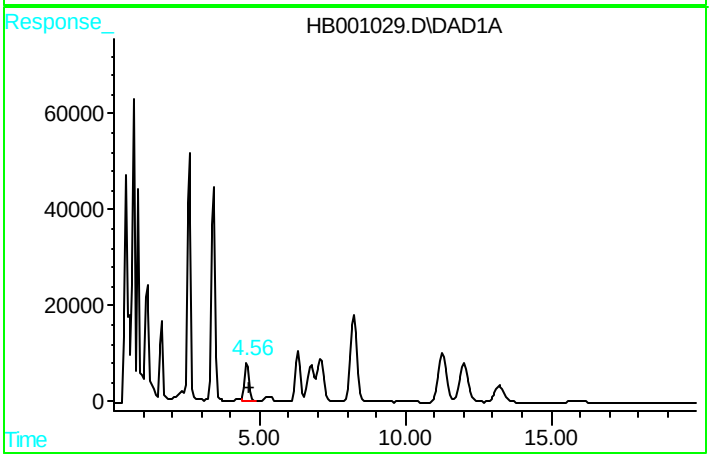

#6 Nitrobenzene

R.T.: 4.564 min
Delta R.T.: -0.045 min
Response: 834840
Conc: 780.36 ug/L