BFB

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Data\VU013123\
Data File : VU052871.D
Acq On : 31 Jan 2023 09:42
Operator : JC/MD
Sample : BFB155
Misc : 5.0mL/MSVOA_U/WATER
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_U
ClientSampleId :
BFB155

Integration File: LSCINT.P

Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Method\SFAMULM012623WMA.M
Title : VOC Analysis
Last Update : Fri Feb 03 00:24:34 2023

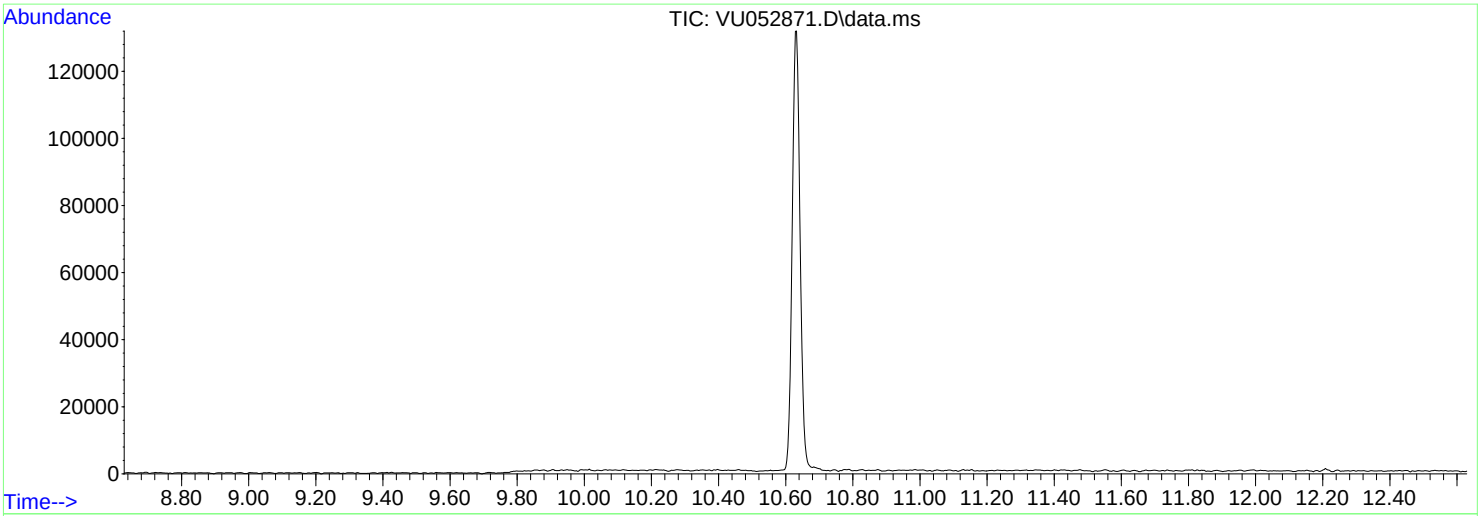

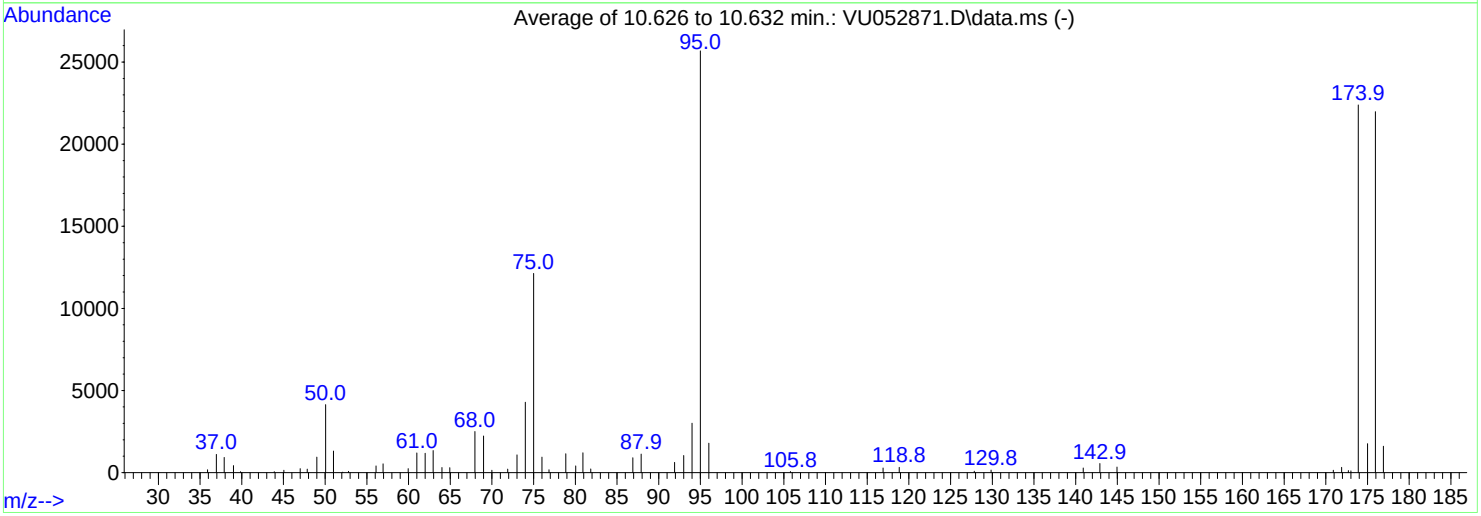

AutoFind: Scans 2888, 2889, 2890; Background Corrected with Scan 2877

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
50	95	15	40	16.1	4137	PASS
75	95	30	80	47.2	12127	PASS
95	95	100	100	100.0	25683	PASS
96	95	5	9	7.0	1795	PASS
173	174	0.00	2	0.6	126	PASS
174	95	50	120	87.2	22387	PASS
175	174	5	9	7.9	1765	PASS
176	174	95	101	98.2	21979	PASS
177	176	5	9	7.3	1610	PASS

Scan 2877 (10.590 min): VU052871.D\data.ms
BFB155

m/z	Abundance
35.90	610.0
37.90	160.0
39.90	152.0
43.90	248.0

Instrument :
MSVOA_U
ClientSampleId :
BFB155

Scan 2888 (10.626 min): VU052871.D\data.ms
BFB155

Instrument :
MSVOA_U
ClientSampleId :
BFB155

m/z	Abundance
36.00	776.0
36.90	1167.0
37.90	1131.0
39.00	430.0
39.90	234.0
43.90	307.0
45.10	152.0
47.00	313.0
47.80	189.0
49.00	864.0
50.00	3952.0
51.00	1265.0
52.10	103.0
56.10	339.0
57.00	476.0
59.90	239.0
61.00	1096.0
62.00	1092.0
63.00	1271.0
64.00	277.0
64.90	266.0
67.90	2298.0
69.00	2138.0
70.00	123.0
71.90	185.0
73.00	997.0
74.00	4167.0
75.00	11743.0
76.00	1027.0
76.90	119.0
78.80	1015.0
80.00	379.0
80.90	1126.0
81.90	220.0
86.90	876.0
87.90	938.0
91.90	575.0
93.00	1125.0
94.00	2841.0
95.00	24208.0
96.00	1686.0
105.80	102.0
116.90	210.0
118.90	357.0
129.90	157.0
140.90	288.0
142.90	494.0
144.90	338.0
170.90	116.0
171.90	276.0
173.90	20512.0
175.00	1652.0
175.90	20488.0
176.90	1370.0

Scan 2889 (10.629 min): VU052871.D\data.ms
BFB155

m/z	Abundance
36.00	798.0
36.90	1151.0
37.90	1105.0
39.00	446.0
39.90	220.0
43.90	303.0
45.00	162.0
47.00	252.0
47.90	225.0
49.00	974.0
50.10	4260.0
51.00	1375.0
52.80	114.0
56.10	440.0
56.90	540.0
60.00	257.0
61.00	1243.0
62.00	1222.0
62.90	1394.0
64.00	332.0
65.00	313.0
68.00	2579.0
69.00	2262.0
70.00	154.0
71.90	233.0
73.00	1099.0
74.00	4418.0
75.00	12417.0
76.00	943.0
76.80	178.0
78.90	1164.0
80.10	445.0
80.90	1266.0
81.90	222.0
86.90	891.0
87.90	1210.0
91.90	614.0
93.00	1090.0
94.00	3052.0
95.00	26432.0
96.00	1910.0
105.80	105.0
116.90	285.0
118.90	337.0
127.80	123.0
129.80	177.0
140.90	294.0
142.90	596.0
145.00	348.0
170.90	156.0
171.90	314.0
173.00	322.0
173.90	23072.0
175.00	1834.0
175.90	22568.0
176.90	1653.0

Instrument :
MSVOA_U
ClientSampleId :
BFB155

Scan 2890 (10.632 min): VU052871.D\data.ms
BFB155

m/z	Abundance
35.90	770.0
37.00	1014.0
38.00	1030.0
39.00	411.0
39.80	167.0
43.90	299.0
45.00	126.0
47.10	176.0
47.90	236.0
49.00	984.0
50.10	4199.0
51.00	1318.0
52.80	110.0
56.10	458.0
56.90	582.0
60.00	235.0
61.00	1250.0
62.00	1215.0
63.00	1358.0
64.00	330.0
65.00	338.0
68.00	2627.0
69.00	2307.0
70.00	159.0
71.90	211.0
73.00	1141.0
74.00	4266.0
75.00	12222.0
76.00	872.0
76.80	227.0
78.90	1274.0
80.00	400.0
80.90	1245.0
81.80	225.0
86.90	951.0
87.90	1252.0
91.90	673.0
93.00	913.0
94.00	3149.0
95.00	26408.0
96.00	1788.0
116.90	346.0
118.80	275.0
127.90	136.0
129.80	129.0
140.90	274.0
142.90	568.0
145.00	345.0
170.90	161.0
171.90	381.0
172.70	378.0
173.90	23576.0
175.00	1810.0
176.00	22880.0
176.90	1807.0

Instrument :
MSVOA_U
ClientSampleId :
BFB155