Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA V\Data\VV080820\
Data File : VV017845.D
Acq On : 08 Aug 2020 10:16
Operator : SY/MD
Sample : BFB69
Misc : 5.0mL/MSVOA V/WATER
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
BFB69

Integration File: LSCINT.P

Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_V\METHOD\SOMVLM080820WMA.M
Title : VOC Analysis
Last Update : Mon Aug 10 05:09:16 2020

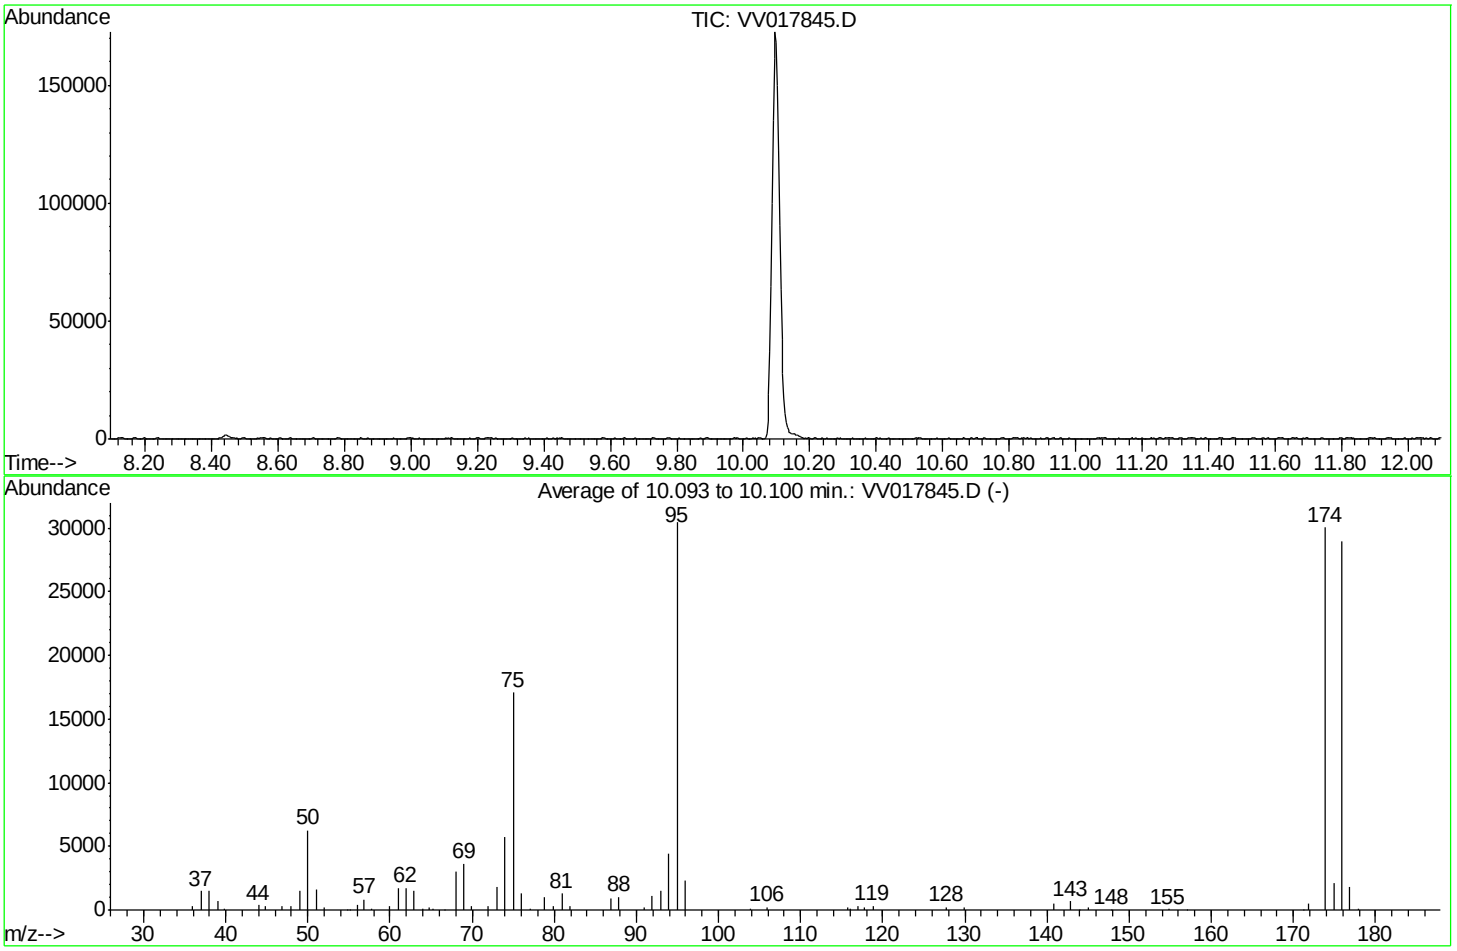

AutoFind: Scans 2800, 2801, 2802; Background Corrected with Scan 2790

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
50	95	15	40	20.5	6235	PASS
75	95	30	80	56.0	17049	PASS
95	95	100	100	100.0	30453	PASS
96	95	5	9	7.5	2271	PASS
173	174	0.00	2	0.0	0	PASS
174	95	50	120	98.8	30098	PASS
175	174	5	9	7.2	2161	PASS
176	174	95	101	96.1	28928	PASS
177	176	5	9	6.4	1857	PASS

Scan 2800 (10.093 min): VV017845.D
BFB69

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
BFB69

m/z	Abundance
36.00	319.0
37.00	1467.0
38.00	1326.0
39.00	674.0
39.90	124.0
44.00	359.0
44.80	234.0
46.90	264.0
47.90	316.0
49.00	1499.0
50.00	6215.0
51.00	1445.0
52.00	211.0
54.80	131.0
56.00	431.0
56.90	825.0
57.80	205.0
59.80	322.0
61.00	1622.0
61.90	1700.0
62.90	1426.0
64.10	180.0
64.80	173.0
65.20	132.0
66.60	118.0
68.00	3159.0
69.00	3716.0
69.90	348.0
72.00	342.0
73.00	1773.0
74.00	5630.0
75.00	16267.0
76.00	1497.0
77.10	125.0
78.80	1017.0
79.90	350.0
80.90	1156.0
81.80	248.0
86.90	833.0
87.80	1028.0
90.90	191.0
91.90	1153.0
93.00	1439.0
94.00	4051.0
95.00	29480.0
96.00	2018.0
103.80	153.0
105.90	178.0
115.70	169.0
116.90	244.0
117.80	177.0
118.80	198.0
127.70	178.0
129.90	119.0
140.90	472.0
142.90	631.0
144.00	126.0
145.00	190.0
157.00	104.0
171.20	141.0
171.90	430.0
173.90	28760.0
174.90	1940.0
175.90	27616.0
176.90	1976.0

Scan 2801 (10.096 min): VV017845.D
BFB69

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
BFB69

m/z	Abundance
36.00	309.0
37.00	1579.0
38.00	1584.0
39.00	759.0
39.90	135.0
44.00	400.0
44.80	266.0
46.90	327.0
47.90	321.0
49.00	1602.0
50.00	6491.0
51.00	1669.0
52.00	210.0
56.00	372.0
56.80	895.0
57.70	176.0
59.90	287.0
61.00	1743.0
61.90	1763.0
62.90	1590.0
64.00	117.0
64.80	206.0
65.30	132.0
68.00	3189.0
69.00	3816.0
70.00	297.0
72.00	311.0
73.00	1872.0
74.00	5944.0
75.00	17728.0
76.00	1288.0
77.10	105.0
78.80	974.0
79.80	335.0
80.90	1328.0
81.90	292.0
86.90	927.0
87.90	994.0
90.90	194.0
92.00	1200.0
93.00	1600.0
94.00	4602.0
95.00	31368.0
96.00	2362.0
103.90	126.0
105.90	212.0
115.70	167.0
116.10	165.0
116.90	297.0
117.80	200.0
118.80	335.0
127.80	218.0
129.90	165.0
140.90	491.0
142.90	719.0
145.00	247.0
154.80	126.0
171.90	487.0
173.90	31168.0
175.00	2144.0
175.90	29704.0
176.90	1971.0
177.90	103.0

Scan 2802 (10.100 min): VV017845.D
BFB69

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
BFB69

m/z	Abundance
35.90	311.0
37.00	1433.0
38.00	1502.0
39.00	694.0
39.80	112.0
44.00	422.0
44.90	322.0
46.90	297.0
48.00	238.0
49.00	1511.0
50.00	6000.0
51.00	1704.0
52.00	149.0
55.10	113.0
56.00	380.0
56.90	808.0
59.90	322.0
61.00	1651.0
61.90	1700.0
62.90	1640.0
64.00	100.0
64.80	212.0
65.20	146.0
68.00	2826.0
69.00	3484.0
70.00	225.0
72.00	186.0
73.00	1891.0
74.00	5744.0
75.00	17152.0
76.00	1153.0
77.00	115.0
78.80	966.0
79.80	368.0
80.90	1414.0
81.90	292.0
86.80	983.0
87.90	1047.0
91.00	194.0
92.00	1126.0
93.00	1637.0
93.90	4714.0
95.00	30512.0
96.00	2435.0
103.90	119.0
106.00	221.0
115.80	144.0
116.10	151.0
116.90	303.0
117.80	188.0
118.80	395.0
127.80	272.0
129.90	221.0
140.80	567.0
142.90	678.0
145.00	226.0
147.90	109.0
154.80	147.0
171.90	518.0
173.90	30368.0
175.00	2401.0
175.90	29464.0
176.90	1624.0
177.90	105.0

Scan 2790 (10.061 min): VV017845.D
BFB69

m/z	Abundance
45.30	115.0

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
BFB69