Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV033122\
Data File : VV025329.D
Acq On : 31 Mar 2022 13:38
Operator : SY/MD
Sample : N2174-15
Misc : 25mL/MSVOA_V/WATER
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Apr 01 01:32:40 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR032622WMA.M
Quant Title : TRACE VOA SFAM1.0
QLast Update : Fri Apr 01 01:30:42 2022
Response via : Initial Calibration

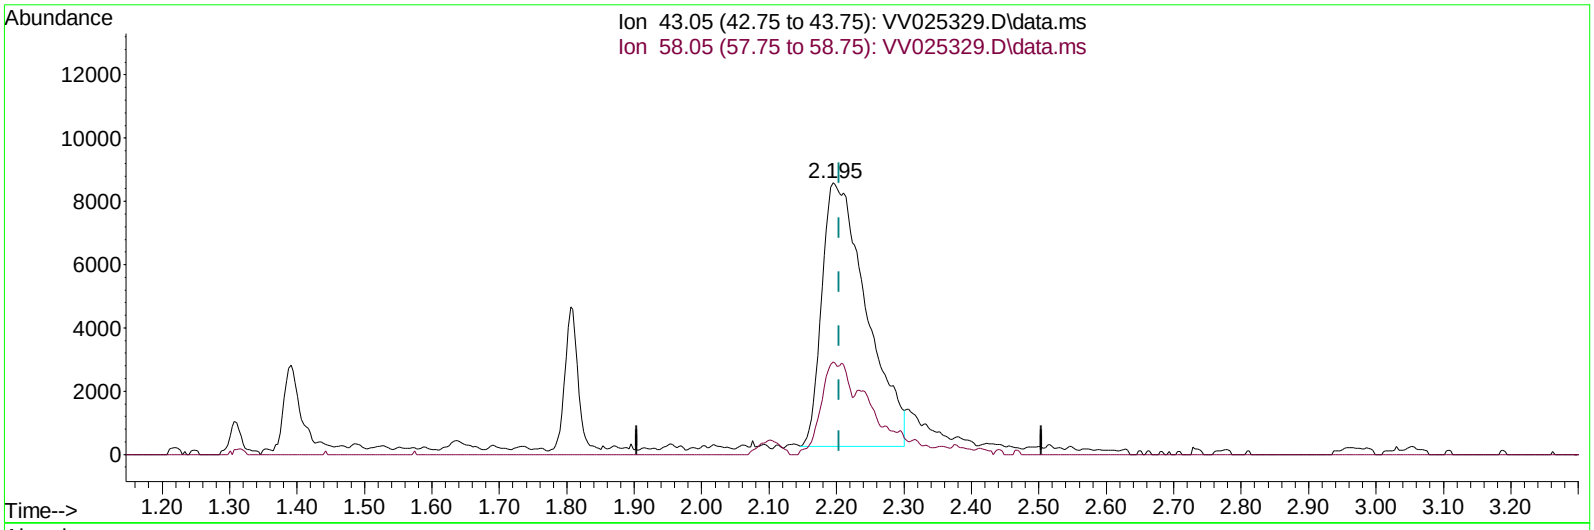

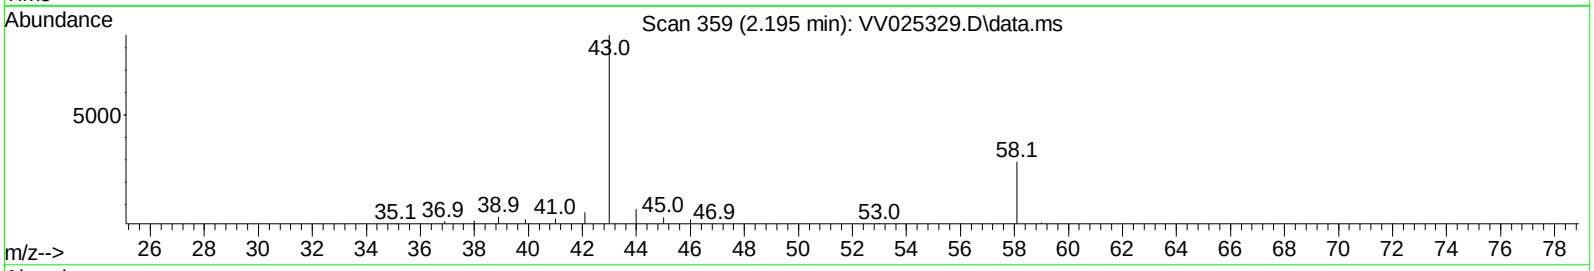

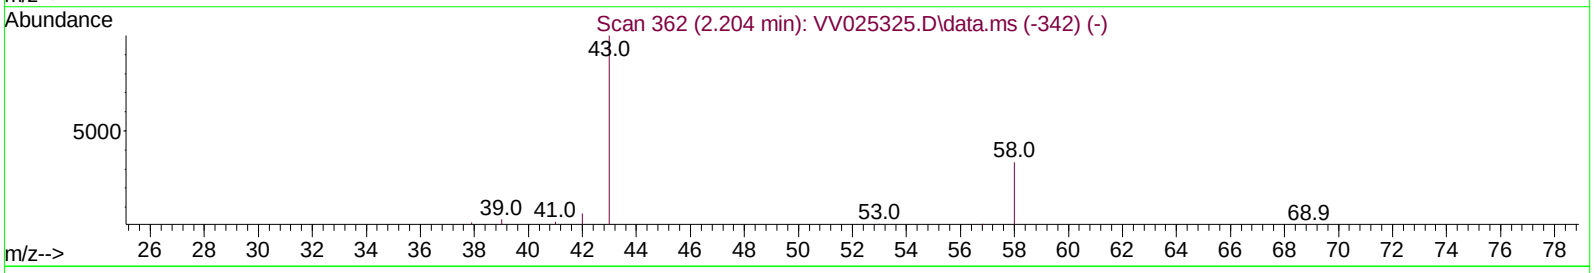

TIC: VV025329.D\data.ms

(13) Acetone (T)

2.195min (-0.010) 41.23 ug/L

response 38193

Ion	Exp%	Act%
43.05	100.00	100.00
58.05	25.60	12.99
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV033122\
Data File : VV025329.D
Acq On : 31 Mar 2022 13:38
Operator : SY/MD
Sample : N2174-15
Misc : 25mL/MSVOA_V/WATER
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Apr 01 01:32:40 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR032622WMA.M
Quant Title : TRACE VOA SFAM1.0
QLast Update : Fri Apr 01 01:30:42 2022
Response via : Initial Calibration

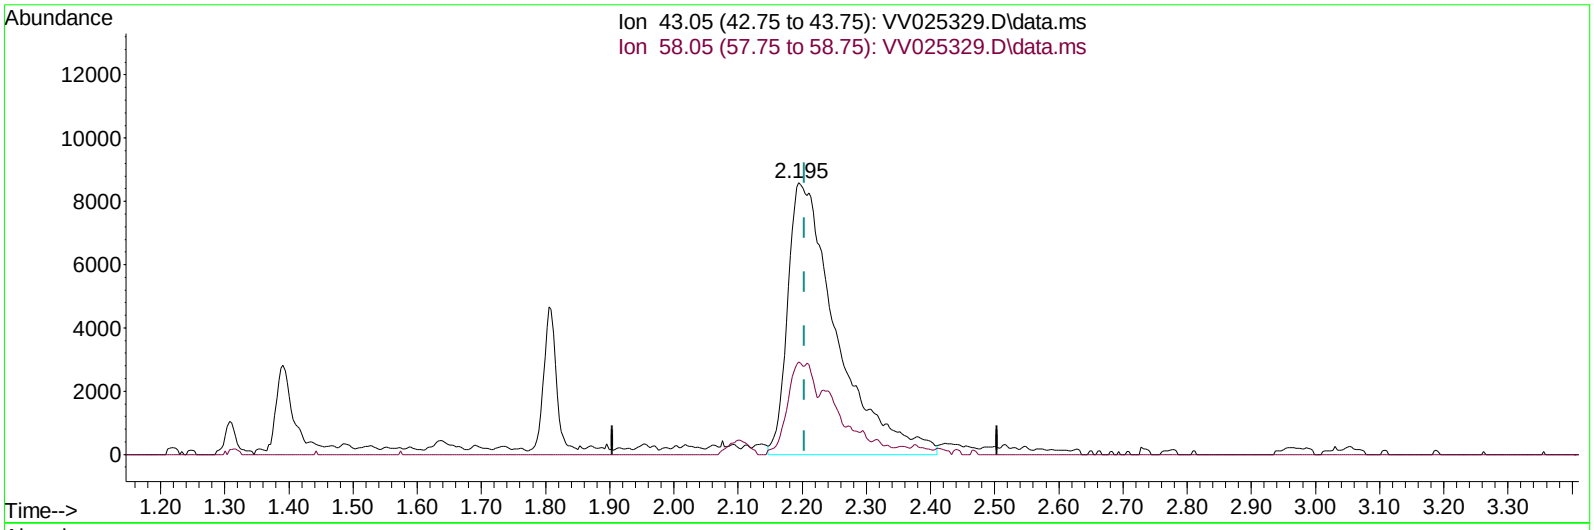

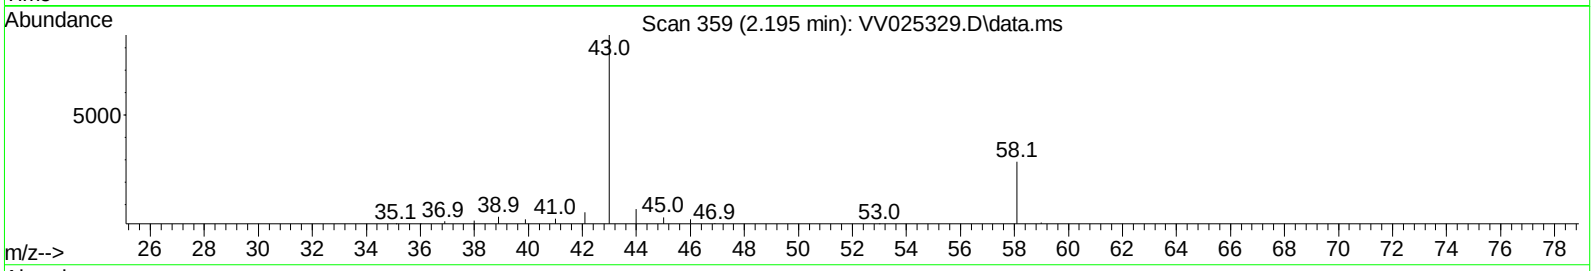

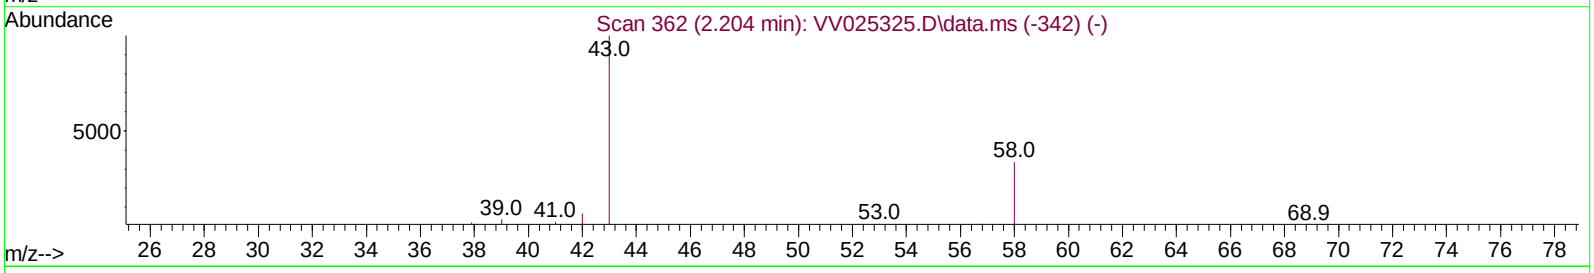

TIC: VV025329.D\data.ms

(13) Acetone (T)

2.195min (-0.010) 49.03 ug/L m

response 45420

Ion	Exp%	Act%
43.05	100.00	100.00
58.05	25.60	10.92
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV033122\
Data File : VV025329.D
Acq On : 31 Mar 2022 13:38
Operator : SY/MD
Sample : N2174-15
Misc : 25mL/MSVOA_V/WATER
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Apr 01 01:32:40 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR032622WMA.M
Quant Title : TRACE VOA SFAM1.0
QLast Update : Fri Apr 01 01:30:42 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) 1,4-Difluorobenzene	5.619	114	130468	5.000	ug/L	0.00
28) Chlorobenzene-d5	8.854	117	126984	5.000	ug/L	0.00
58) 1,4-Dichlorobenzene-d4	11.249	152	52882	5.000	ug/L	0.00
System Monitoring Compounds						
4) Vinyl Chloride-d3	1.307	65	63152	5.182	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 40 - 130		Recovery = 103.600%			
7) Chloroethane-d5	1.568	69	54704	5.348	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 65 - 130		Recovery = 107.000%			
11) 1,1-Dichloroethene-d2	2.108	63	98184	3.719	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 60 - 125		Recovery = 74.400%			
20) 2-Butanone-d5	3.915	46	52766	43.466	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 40 - 130		Recovery = 86.940%			
24) Chloroform-d	4.352	84	80223	5.044	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 70 - 125		Recovery = 100.800%			
26) 1,2-Dichloroethane-d4	5.034	65	37891	5.390	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 70 - 130		Recovery = 107.800%			
32) Benzene-d6	5.050	84	162953	5.072	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 70 - 125		Recovery = 101.400%			
36) 1,2-Dichloropropane-d6	6.072	67	46162	5.127	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 60 - 140		Recovery = 102.600%			
41) Toluene-d8	7.317	98	136054	4.617	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 70 - 130		Recovery = 92.400%			
43) trans-1,3-Dichloroprop...	7.625	79	13503	4.597	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 55 - 130		Recovery = 92.000%			
46) 2-Hexanone-d5	8.091	63	53958	50.866	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 45 - 130		Recovery = 101.740%			
56) 1,1,2,2-Tetrachloroeth...	10.217	84	30022	5.001	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 65 - 120		Recovery = 100.000%			
66) 1,2-Dichlorobenzene-d4	11.622	152	47221	5.560	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 80 - 120		Recovery = 111.200%			
Target Compounds						Qvalue
3) Chloromethane	1.243	50	11552	0.752	ug/L	100
13) Acetone	2.195	43	45420m	49.032	ug/L	

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV033122\
Data File : VV025329.D
Acq On : 31 Mar 2022 13:38
Operator : SY/MD
Sample : N2174-15
Misc : 25mL/MSVOA_V/WATER
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Apr 01 01:32:40 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR032622WMA.M
Quant Title : TRACE VOA SFAM1.0
QLast Update : Fri Apr 01 01:30:42 2022
Response via : Initial Calibration