BFB

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_L\Data\VL022820\
Data File : VL034731.D
Acq On : 28 Feb 2020 8:38
Operator : SY/AP
Sample : BFB
Misc : 400ml/MSVOA_L
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_L
ClientSampleId : BFB

Integration File: RTEINT.P

Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_L\METHODS\VL022620AIR.M
Title : AIR ANALYSIS BY METHOD TO-15 Instrument: MSVOA_LFri Feb 28 01:15:02 2020
Last Update : Fri Feb 28 01:15:02 2020

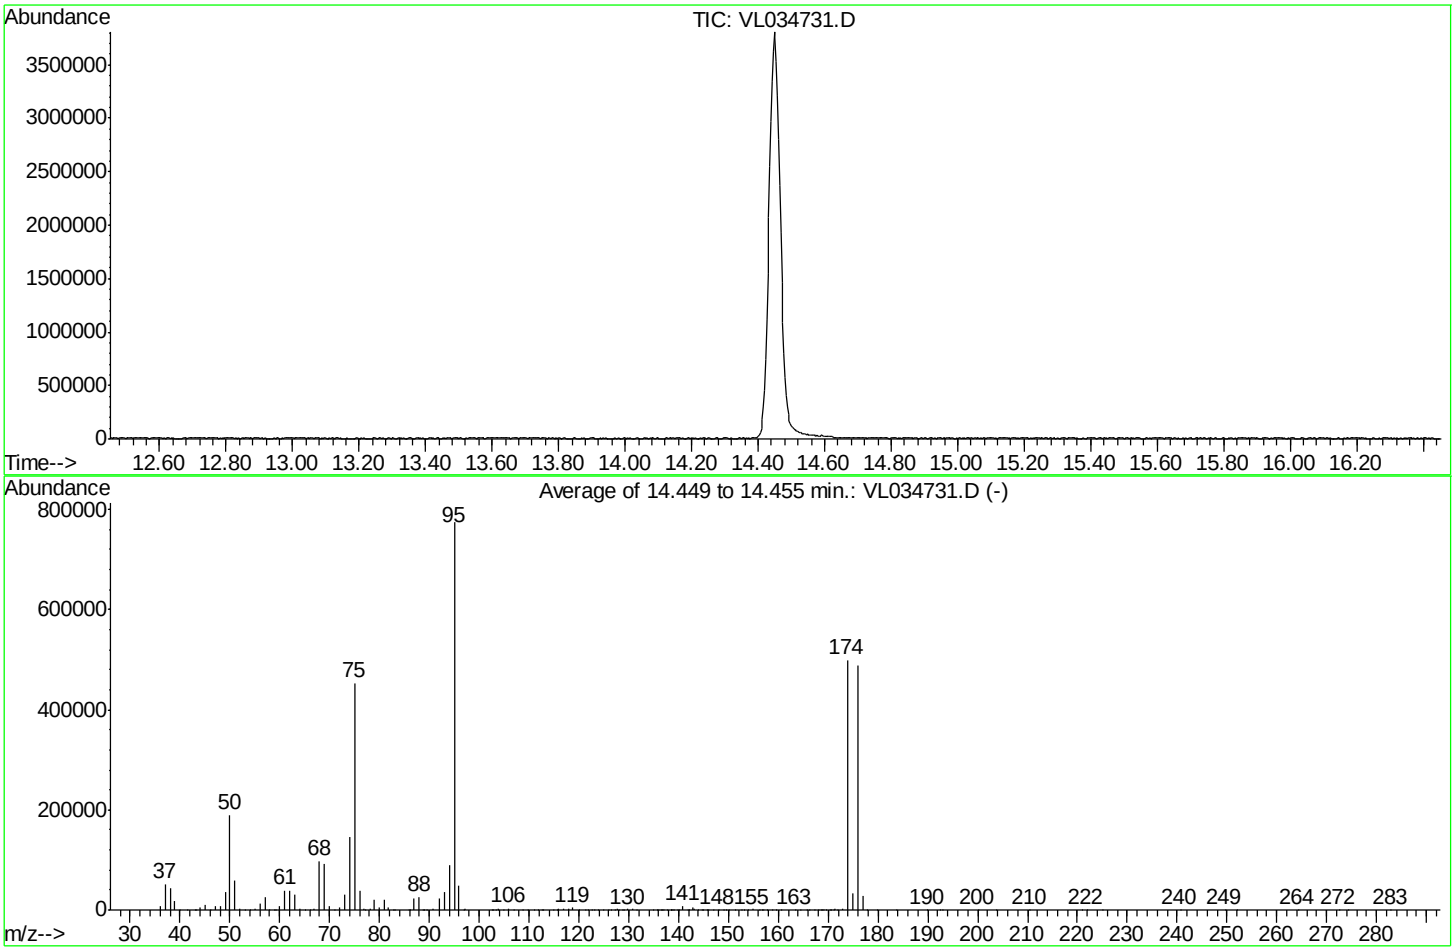

AutoFind: Scans 3627, 3628, 3629; Background Corrected with Scan 3600

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
50	95	8	40	24.5	190122	PASS
75	95	30	66	58.5	452928	PASS
95	95	100	100	100.0	774442	PASS
96	95	5	9	6.4	49600	PASS
173	174	0.00	2	0.8	3775	PASS
174	95	50	120	64.5	499392	PASS
175	174	4	9	6.7	33408	PASS
176	174	93	101	97.7	487722	PASS
177	176	5	9	6.0	29085	PASS