BFB

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX010723\
Data File : VX033646.D
Acq On : 06 Jan 2023 21:49
Operator : JC/MD
Sample : BFB
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 30 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BFB

Integration File: RTEINT3.P

Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\624X010723W.M
Title : METHOD 624 VOLATILE ORGANIC ANALYSIS
Last Update : Sat Jan 07 06:16:21 2023

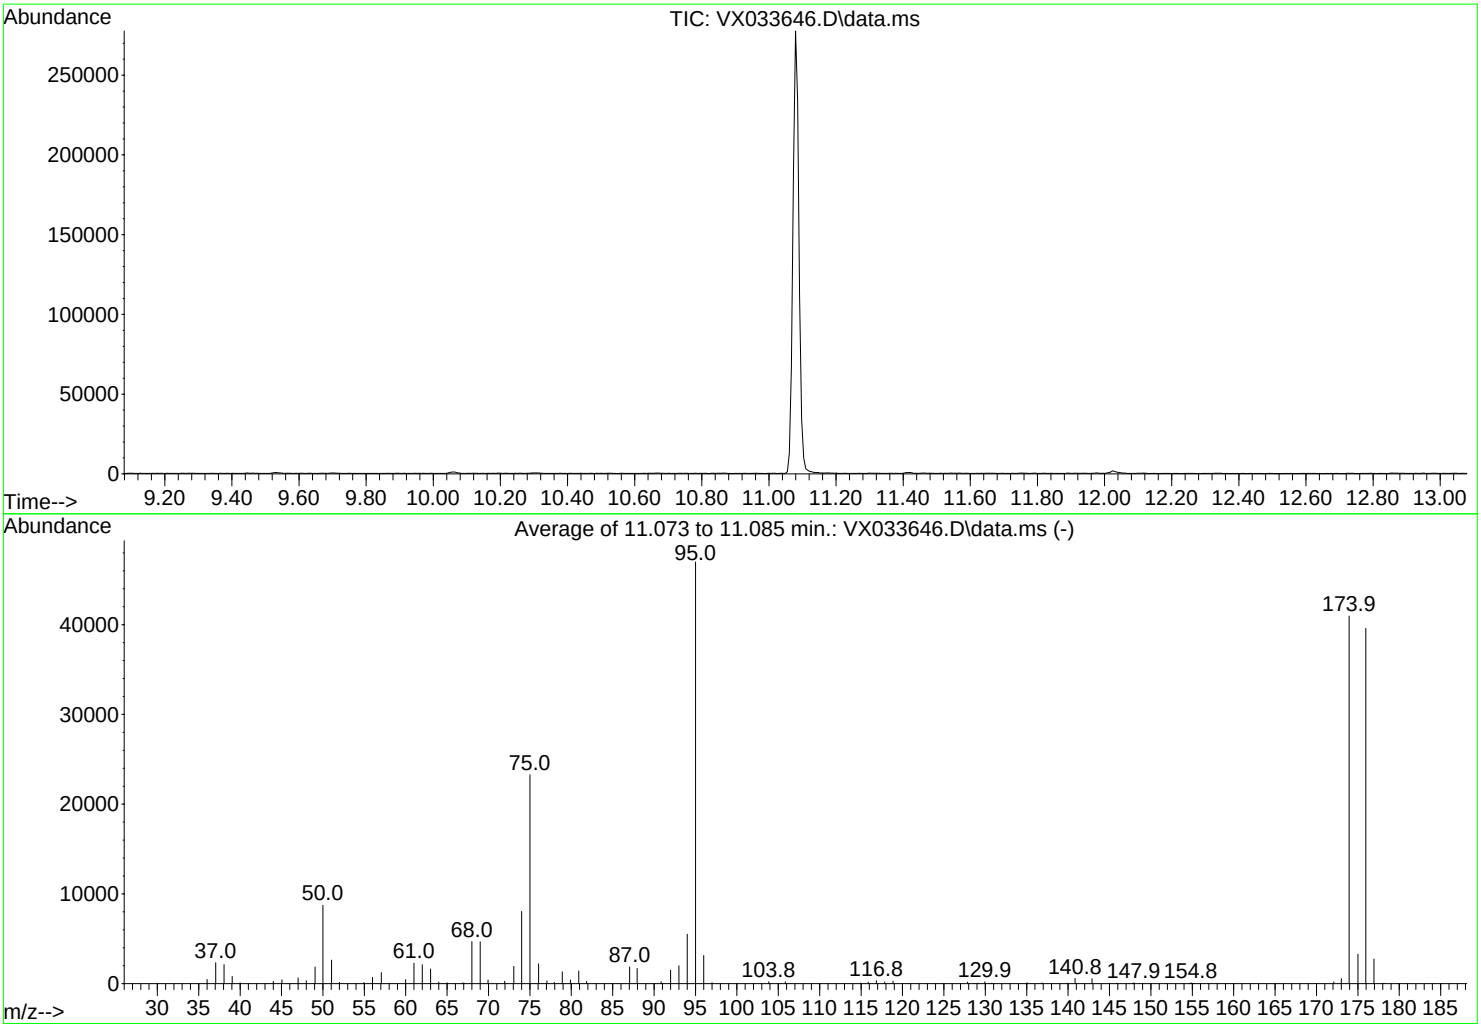

AutoFind: Scans 1638, 1639, 1640; Background Corrected with Scan 1633

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
50	95	15	40	18.6	8743	PASS
75	95	30	60	49.6	23291	PASS
95	95	100	100	100.0	47003	PASS
96	95	5	9	6.7	3130	PASS
173	174	0.00	2	1.3	550	PASS
174	95	50	100	87.1	40963	PASS
175	174	5	9	8.0	3277	PASS
176	174	95	101	96.6	39579	PASS
177	176	5	9	7.0	2753	PASS