BFB

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX111324\
Data File : VX043827.D
Acq On : 13 Nov 2024 09:03
Operator : JC/MD
Sample : BFB698
Misc : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BFB698

Integration File: LSCINT.P

Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\SFAMXLM110424WMA.M
Title : VOC Analysis
Last Update : Wed Nov 13 02:04:29 2024

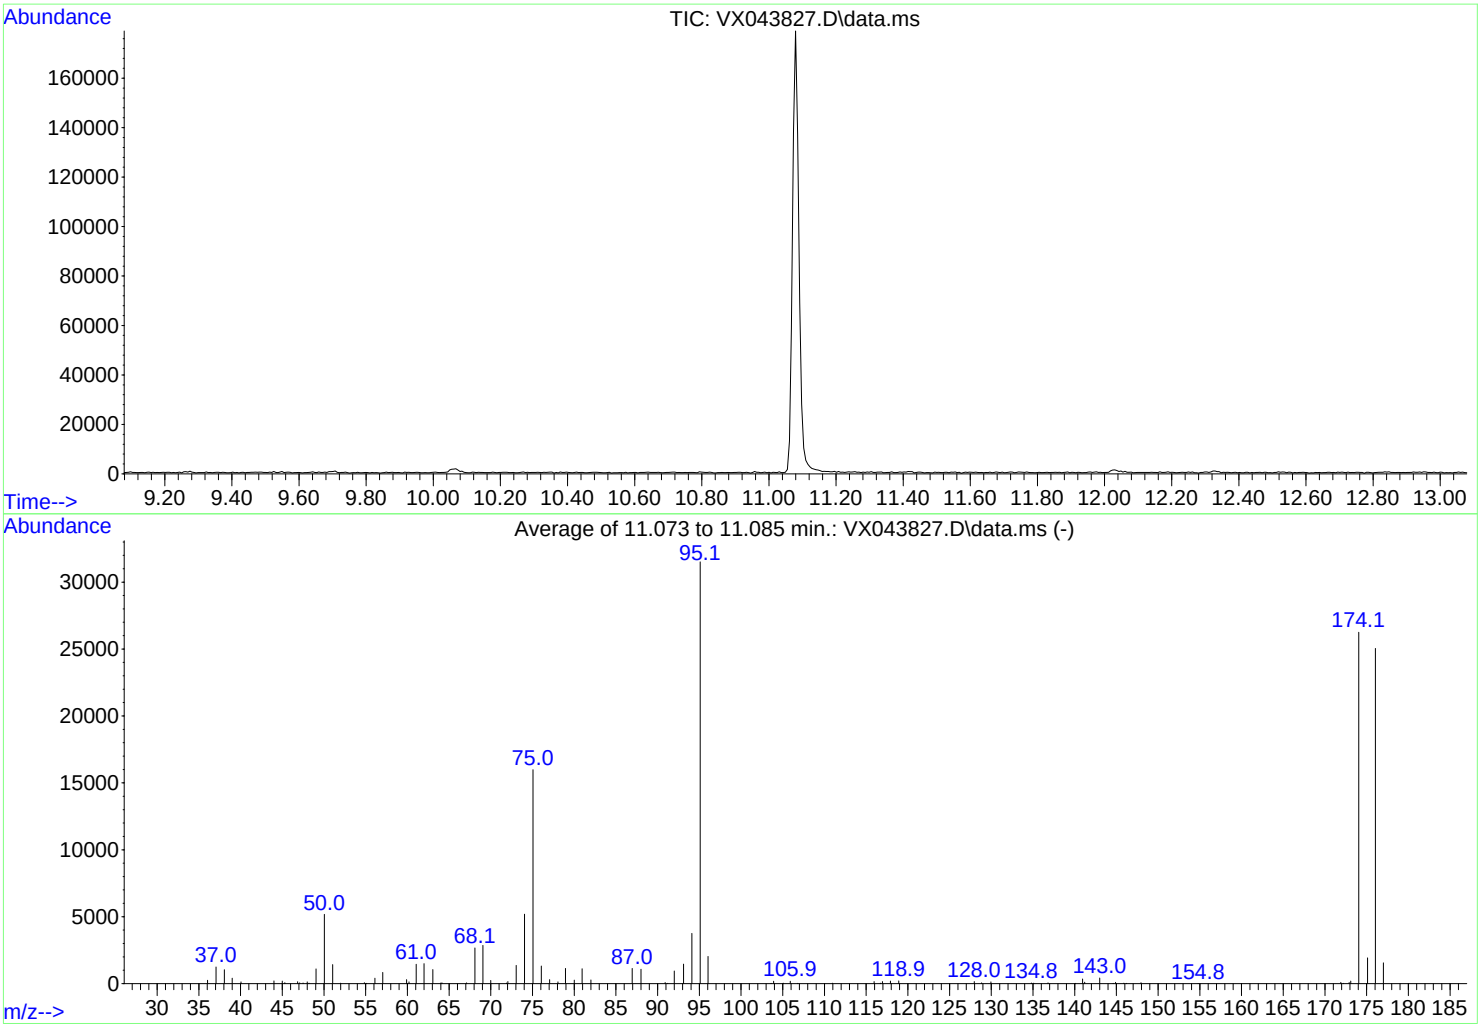

AutoFind: Scans 1638, 1639, 1640; Background Corrected with Scan 1633

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
50	95	15	40	16.4	5176	PASS
75	95	30	80	50.7	15989	PASS
95	95	100	100	100.0	31515	PASS
96	95	5	9	6.4	2029	PASS
173	174	0.00	2	0.7	196	PASS
174	95	50	120	83.3	26253	PASS
175	174	5	9	7.3	1921	PASS
176	174	95	101	95.4	25048	PASS
177	176	5	9	6.2	1551	PASS

Scan 1633 (11.043 min): VX043827.D\data.ms
BFB698

m/z	Abundance
39.00	79.0
40.10	261.0
44.00	165.0

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BFB698

Scan 1638 (11.073 min): VX043827.D\data.ms
BFB698

m/z	Abundance
36.10	257.0
37.10	1432.0
38.00	1016.0
39.00	544.0
40.10	427.0
44.10	364.0
45.30	228.0
47.10	180.0
48.00	186.0
49.10	1167.0
50.10	5035.0
51.00	1469.0
55.10	94.0
56.10	456.0
57.00	762.0
60.00	397.0
61.00	1697.0
62.00	1373.0
63.00	1209.0
64.00	136.0
68.10	2673.0
69.10	2801.0
70.00	364.0
71.90	162.0
73.10	1223.0
74.00	5182.0
75.00	15516.0
76.00	1249.0
77.10	217.0
78.10	144.0
78.90	1041.0
80.00	204.0
81.00	1157.0
82.00	184.0
87.00	1158.0
88.00	1123.0
90.90	102.0
92.00	954.0
93.10	1207.0
94.10	3429.0
95.10	29920.0
96.10	2172.0
103.90	208.0
105.00	63.0
105.90	152.0
106.80	76.0
110.90	59.0
115.90	153.0
116.70	96.0
117.90	234.0
119.00	187.0
128.00	263.0
128.90	132.0
130.00	206.0
135.10	98.0
136.80	108.0
141.00	279.0
143.00	322.0
144.60	60.0
146.20	65.0
171.90	104.0
172.90	239.0
174.00	21712.0
175.10	1480.0
176.00	19800.0
177.00	1266.0

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BFB698

Scan 1639 (11.079 min): VX043827.D\data.ms
BFB698

m/z	Abundance
36.00	290.0
37.00	1422.0
38.00	1200.0
39.10	560.0
40.10	385.0
43.90	520.0
45.00	276.0
46.80	228.0
47.50	159.0
48.00	196.0
49.00	1230.0
50.00	6324.0
51.10	1666.0
54.80	104.0
56.10	600.0
57.10	970.0
59.80	305.0
60.20	386.0
61.00	1435.0
62.00	1752.0
63.00	1134.0
64.20	69.0
67.10	130.0
68.10	3175.0
69.00	3198.0
70.00	195.0
72.10	237.0
73.10	1519.0
74.00	6030.0
75.10	19104.0
76.10	1672.0
77.10	449.0
78.00	132.0
79.00	1288.0
80.00	426.0
80.90	1196.0
82.00	314.0
87.00	1260.0
88.00	1406.0
90.90	146.0
92.00	1056.0
93.10	1843.0
94.10	4497.0
95.10	35720.0
96.00	2393.0
103.90	227.0
105.10	55.0
105.80	183.0
111.00	70.0
116.00	208.0
117.00	309.0
117.90	192.0
118.90	288.0
127.90	133.0
128.80	58.0
129.90	173.0
134.80	100.0
136.80	71.0
140.10	66.0
141.00	478.0
143.00	548.0
144.90	183.0
145.90	51.0
147.90	108.0
171.90	79.0
172.20	60.0
173.10	315.0
174.00	31112.0
175.10	2383.0
176.10	31264.0
177.00	1764.0

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BFB698

Scan 1640 (11.085 min): VX043827.D\data.ms
BFB698

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
BFB698

m/z	Abundance
36.00	215.0
37.00	893.0
38.10	925.0
39.10	372.0
40.00	356.0
43.90	237.0
45.00	290.0
46.90	204.0
48.20	128.0
49.00	906.0
50.10	4170.0
51.00	1145.0
52.00	110.0
54.90	127.0
56.00	180.0
57.00	785.0
60.00	190.0
61.10	1218.0
62.00	1365.0
63.10	802.0
64.10	108.0
67.10	58.0
68.10	2144.0
69.10	2558.0
69.90	176.0
72.00	245.0
73.00	1363.0
74.10	4355.0
75.10	13346.0
76.10	1011.0
77.00	249.0
78.00	110.0
79.00	1075.0
79.90	170.0
80.90	971.0
82.00	316.0
86.80	977.0
87.90	718.0
91.20	94.0
92.00	813.0
93.10	1322.0
94.10	3353.0
95.10	28904.0
96.10	1522.0
103.60	76.0
104.00	88.0
106.00	211.0
115.90	119.0
116.90	157.0
117.90	158.0
118.80	148.0
128.10	72.0
134.80	64.0
140.80	300.0
141.20	337.0
143.00	401.0
144.90	94.0
145.90	67.0
148.00	100.0
154.80	56.0
171.90	110.0
173.10	274.0
174.10	25936.0
175.10	1899.0
176.00	24080.0
177.00	1623.0